

DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-052/2015
REFERENTE A LA ADQUISICION DE LINEAS DE INFUSION
PARA EL OPD SALUD DE TLAXCALA

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAX., SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2015 HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO, TLAXCALA, LOS CC. **JORGE CAPIZ JASSO**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA LIC. **ALEJANDRA FLORES MONTALVO** DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, MEDIANTE OFICIO DRMSYA/215/2015 DE FECHA 19 DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, COMO REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE; LA C.P. **MICAELA TANIA DEGALES MORALES** COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE; LA LIC. **MARÍA DEL ROCÍO LIMA GONZÁLEZ**, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA; LA L.E. **LUCERO SALOME DÍAZ ARROLLO**, ÁREA DE SUPERVISIÓN DE ENFERMERÍA DE HOSPITALES DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA; LA L.E.O. **CONSUELO RAMÍREZ HERNÁNDEZ**, COORDINACIÓN DE INSUMOS TERAPEÚTICOS DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA; EL LIC. **ADÁN RAMÍREZ CANTE** COMO REPRESENTANTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y O.P.D. SALUD DE TLAXCALA; EL LIC. **ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA**, COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO, ASÍ MISMO, EL LIC. **OSWALDO AQUIAHUATL JIMÉNEZ** COMO REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO. A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-052/2015, EL PRESENTE EVENTO SE LLEVA A CABO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, ASÍ COMO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

HECHOS: SE DIO INICIO CON LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS QUE LOS LICITANTES REALIZARON CON ANTERIORIDAD, DE ACUERDO AL PUNTO 7 DE LAS BASES, SIENDO LAS SIGUIENTES: -----

HI TEC MEDICAL DEL SUR, S.A. DE C.V.

1	REFERENCIA	2.3. ESTA LICITACIÓN ES: NACIONAL Y PRESENCIAL
	PREGUNTA	POR SER UNA LICITACIÓN NACIONAL COMO SE MENCIONA EN LA INFORMACIÓN GENERAL DE LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SE LE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, ESTABLECER QUE LOS BIENES (EQUIPOS DE VENOCLISIS) PROPUESTOS EN LAS PARTIDAS 1,2, Y 3 DEBEN DE SER DE ORIGEN NACIONAL.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
2	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 1
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, DADO QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE SON ESPECÍFICOS PARA UN INSUMO Y UN MODELO DE BOMBA EXISTENTE EN EL MERCADO, SE PERMITA OFERTA POR PARTE DE MI REPRESENTADA ASÍ COMO SOLICITAR ENTREGAR MUESTRA PARA EVALUACIÓN DEL SIGUIENTE PRODUCTO: PARTIDA 1: EQUIPO DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSION DE PLASTICO GRADO MEDICO , ESTERIL, DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA DE GOTEIO FLEXIBLE CON MACROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO , CON DOS O MAS DISPOSITIVOS EN "Y" PARA INYECCION, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR. 20 GOTAS POR MILILITRO BAYONETA CON FILTRO

		CONECTOR LUER LOCK (ROSCA) LONGITUD 2.80 M 2 SITIOS DE INYECCIÓN O SISTEMA CLEARLINK SISTEMA LIBRE DE ACCESOS SIN AGUJA ESTE EQUIPO ES COMPATIBLE CON LAS BOMBAS DE INFUSIÓN MARCA BAXTER, LAS CUALES EN CASO DE UNA RESPUESTA POSITIVA A NUESTRA SOLICITUD DE EVALUACIÓN DEL INSUMO ANTERIORMENTE DESCRITO Y EN CASO DE ASIGNACIÓN EN LA PRESENTE LICITACIÓN, SE ESTARAN ENTREGANDO AL INSTITUTO EN COMODATO PERMANENTE DURANTE TODO LA VIGENCIA DEL CONTRATO PARA SU USO EN LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR CADA UNO DE LOS HOSPITALES.
	RESPUESTA	SE ACEPTA PARA SER EVALUADAS POR EL ÁREA EXPERTA.
3	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 2
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, DADO QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE SON ESPECÍFICOS PARA UN INSUMO Y UN MODELO DE BOMBA EXISTENTE EN EL MERCADO, SE PERMITA OFERTA POR PARTE DE MI REPRESENTADA ASÍ COMO SOLICITAR ENTREGAR MUESTRA PARA EVALUACIÓN DEL SIGUIENTE PRODUCTO: PARTIDA 2: EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE VOLUMENES MEDIDOS PARA USARSE CON BOMBADE INFUSION, DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA,FILTRO DE AIRE, CAMARA BURETA FLEXIBLE CON CAPACIDAD DE 100 ML MINIMO Y ESCALA GRADUADA EN ML, CAMARA DE GOTEIO FLEXIBLE CON MACROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO CON DOS O MAS DISPOSITIVOS EN "Y" PARA INYECCION, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR. 20 GOTAS POR MILILITRO BAYONETA CON FILTRO LONGITUD 2.40 M CONECTOR LUER SLIP CÁMARA BURETRA DE100 ML. ESTE EQUIPO ES COMPATIBLE CON LAS BOMBAS DE INFUSIÓN MARCA BAXTER, LAS CUALES EN CASO DE UNA RESPUESTA POSITIVA A NUESTRA SOLICITUD DE EVALUACIÓN DEL INSUMO ANTERIORMENTE DESCRITO Y EN CASO DE ASIGNACIÓN EN LA PRESENTE LICITACIÓN, SE ESTARAN ENTREGANDO AL INSTITUTO EN COMODATO PERMANENTE DURANTE TODO LA VIGENCIA DEL CONTRATO PARA SU USO EN LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR CADA UNO DE LOS HOSPITALES.
	RESPUESTA	SE ACEPTA PARA SER EVALUADA POR EL ÁREA EXPERTA.
4	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 3
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, DADO QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE SON ESPECÍFICOS PARA UN INSUMO Y UN MODELO DE BOMBA EXISTENTE EN EL MERCADO, SE PERMITA OFERTA POR PARTE DE MI REPRESENTADA ASÍ COMO SOLICITAR ENTREGAR MUESTRA PARA EVALUACIÓN DEL SIGUIENTE PRODUCTO:

		PARTIDA 3: EQUIPO DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSION, DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESECHABLE, CONSTA DE BAYONETA, CARTUCHO DE INFUSION, TUBO TRANSPORTADOR ANTIACTINICO DE BAJA ABSORCION PARA MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA Y BAYONETA PARA BOLSA Y PROTECTOR. 20 GOTAS POR MILILITRO BAYONETA CON FILTRO CONECTOR LUER LOCK (ROSCA) LONGITUD 2.80 M 1 SITIO DE INYECCIÓN COLOR AMBAR ESTE EQUIPO ES COMPATIBLE CON LAS BOMBAS DE INFUSIÓN MARCA BAXTER, LAS CUALES EN CASO DE UNA RESPUESTA POSITIVA A NUESTRA SOLICITUD DE EVALUACIÓN DEL INSUMO ANTERIORMENTE DESCRITO Y EN CASO DE ASIGNACIÓN EN LA PRESENTE LICITACIÓN, SE ESTARAN ENTREGANDO AL INSTITUTO EN COMODATO PERMANENTE DURANTE TODO LA VIGENCIA DEL CONTRATO PARA SU USO EN LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR CADA UNO DE LOS HOSPITALES.
	RESPUESTA	SE ACEPTA PARA SER EVALUADA POR EL ÁREA EXPERTA.
5	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDAS 1,2 Y 3
	PREGUNTA	EN CASO DE LA QUE LA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS 1, 2 Y 3 SEA NEGATIVA O SE NOS DELIMITE APEGARNOS A BASES, LES SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE LICITAR CON LAS DESCRIPCIONES DE CUADRO BÁSICO NACIONAL LOS EQUIPOS DE VENOCLISIS PARA BOMBAS DE INFUSIÓN. DEBIDO A QUE LAS DESCRIPCIONES DE LAS PARTIDAS 1, 2, Y 3 DE LAS PRESENTES BASES ESTÁN DIRIGIDAS A UNA MARCA ESPECÍFICA DE INSUMOS, ASI COMO DE BOMBAS DE INFUSIÓN EN LA PARTIDA 7 Y 9. CON ESTO SE INFRINGE EL ARTICULO 23 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE TLAXCALA DONDE SE MENCIONA QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN SE SUJETARÁN INVARIABLEMENTE AL PRINCIPIO DE IGUALDAD PARA LOS PARTICIPANTES, PARA TAL EFECTO SE DARÁ LA MISMA OPORTUNIDAD PARA OBTENER LA INFORMACIÓN RELACIONADA Y SE ESTABLECERÁN IGUALES REQUISITOS Y CONDICIONES DE TIEMPO, LUGAR DE ENTREGA, FORMA Y PLAZO DE PAGO, PENAS CONVENCIONALES, ANTICIPOS Y GARANTÍAS. SERÁ MOTIVO DE RESPONSABILIDAD CUALQUIER ACTO QUE TIENDA A FAVORECER A ALGÚN PARTICIPANTE EN ESTOS PROCEDIMIENTOS.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LAS PREGUNTAS 2, 3 Y 4
6	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 4,5 Y 9
	PREGUNTA	LAS BOMBAS DE INFUSIÓN MARCA BAXTER QUE OFRECEMOS TIENEN LA MODALIDAD DE PERFUSOR Y CUENTAN CON LA CAPACIDAD PARA REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE MICRODOSIS, COLOCANDO UN SOPORTE QUE SE FIJA A LA REGIÓN LATERAL DE LA BOMBA Y SE PUEDEN COLOCAR 3 JERINGAS DE 10, 20 O 60 ML. EN DONDE SE CONECTA EL SET DE JERINGA QUE SE PURGA CON SOLO 6 ML, DE ESTA FORMA SE REALIZA LA PROGRAMACIÓN EN DECIMAS DE ML. YA QUE LA BOMBA TIENE RANGOS DE VELOCIDAD EN ESTA MODALIDAD QUE VAN A PARTIR DE 0.1 Y HASTA 250 ML/H. RESUMIENDO CON LAS SIGUIENTES DESTACADAS CARACTERÍSTICAS:

		A) CAPACIDAD PARA POGRAMAR EN MICRODOSIS DE INFUSIÓN, GENERALMENTE ESTAS DOSIS SE UTILIZAN A PARTIR DE 0.1 ML/HORA. B) SE REQUIERE UN SET ESPECIAL QUE SE CONECTA A UNA JERINGA, LA CUAL ES DE DIFERENTE CAPACIDAD DE ACUERDO AL TRATAMIENTO DEL PACIENTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE OFRECER UNA MEJOR TECNOLOGÍA, QUE BENEFICIE A LAS UNIDADES MEDICAS Y SUS USUARIAS, PERMITIR QUE MI REPRESENTADA PARTICIPE EN LA PRESENTE CONVOCATORIA CON LAS BOMBAS DE INFUSIÓN MARCA BAXTER COMO PERFUSOR TAMBIEN. ASI COMO CONTEMPLAR LA ADQUISICIÓN DEL SETS DE JERINGA EN DONDE MI REPRESENTADA SOLICITA CONSIDERAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN DE INSUMOS PARA EL USO DE PERFUSORES: SIN CLAVE, EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN CON ADAPTADOR DE JERINGA, ABIERTO (CON FILTRO DE AIRE) TUBO DE PEQUEÑO CALIBRE, LUER LOCK ROTATORIO, ACCESORIO PARA USARSE CON LAS BOMBAS DE INFUSIÓN VOLUMETRICAS.
	RESPUESTA	SE ACEPTA PARA SU VALIDACIÓN TÉCNICA POR EL ÁREA EXPERTA.
7	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 7 BOMBAS DE INFUSIÓN (EQUIPOS EN COMODATO).
	PREGUNTA	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR EN COMODATO BOMBAS DE INFUSIÓN DE 1 Y 3 CANALES, Y EN EL CASO DE LA BOMBA DE 3 CANALES ESTOS SE ENCUENTREN INTEGRADOS EN EL MISMO CHASIS. ESTO DEBIDO A LA NECESIDAD DE TERAPIAS CRITICAS EN LOS HOSPITALES DONDE LA BOMBA TRIPLE BRINDA BENEFICIOS SUSTANCIOSOS EN LOS SERVICIOS.
	RESPUESTA	SE ACEPTA PARA SER EVALUADA POR EL ÁREA EXPERTA.
8	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 7 BOMBAS DE INFUSIÓN (EQUIPOS EN COMODATO).
	PREGUNTA	SOLICITAMOS DE MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, QUE LA DESCRIPCIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN EN COMODATO SEA BASADA EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (CENETEC) LA CUAL SE AGREGA COMO RESPALDO PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES. DEBIDO A QUE LA CENETEC DETERMINA LAS CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LAS BOMBAS DE INFUSIÓN, ASÍ COMO LA DESCRIPCIÓN DE LAS MISMAS.
	RESPUESTA	FAVOR DE APEGARSE A BASES.
9	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 7 BOMBAS DE INFUSIÓN (EQUIPOS EN COMODATO).
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, DADO QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE SON ESPECÍFICOS PARA UN MODELO DE BOMBA EXISTENTE EN EL MERCADO, SE PERMITA OFERTA POR PARTE DE MI REPRESENTADA EN COMODATO LA SIGUIENTES BOMBAS DE INFUSIÓN: APARATO ELECTROMECAÁNICO DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA DE ALTA PRECISIÓN ESTÁNDAR DE UN CANAL, PORTÁTIL QUE CON EXACTITUD Y SEGURIDAD QUE PERMITE ADMINISTRAR EN FORMA CONSTANTE O INTERMITENTE, EN TIEMPO DETERMINADO, FLUIDOS PARENTERALES, MEDICAMENTOS, ELECTROLITOS, NUTRICIÓN

PARENTERAL, SANGRE ENTERA Y HEMODERIVADOS A PACIENTES NEONATALES, PEDIÁTRICOS Y ADULTOS POR LAS VÍAS INTRAVENOSA, INTRARTERIAL, EPIDURAL Y SUBCUTÁNEA CUMPLIENDO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- TAMAÑO: 259 X 197 X 203 MM
- PARÁMETROS DE INFUSIÓN
- RANGO DE VELOCIDAD DE FLUJO (PRIMARIO)
0.1-99.9 ML/HR (INCREMENTOS DE 0.1 ML.)
1-1,200 ML/HR (INCREMENTOS DE 1 ML.)
- RANGO DE VELOCIDAD DE FLUJO (SECUNDARIA)
0.1-99.9 ML/HR (INCREMENTOS) DE 1 ML.)
1-500 ML/HR (INCREMENTOS DE 1 ML.)
- VOLUMEN PARA SER INFUNDIDO
0.1-99.9 ML/HR (INCREMENTOS DE 0.1 ML.)
1-9,999 ML/HR (INCREMENTOS DE 1 ML.)
- RANGO DE PESO DEL PACIENTE (PARA MODOS DE DOSIS BASADA EN EL PESO DEL PACIENTE)
0,2 KG - 99,9 KG (INCREMENTOS DE 0,1 KG.)
100 KG - 600 KG (INCREMENTOS DE 1 KG)
- VELOCIDAD DE FLUJO KVO (KEEP VEIN OPEN O MANTENER VÍA ABIERTA)
0.1-5 ML/HR (INCREMENTOS DE 0.1 ML.)
- MECANISMO DE BOMBEO BAXTER SHUTTLE, TECNOLOGÍA QUE ASEGURA LOS MÁS ALTOS NIVELES DE EXACTITUD PARA UN AMPLIO RANGO DE PROPORCIONES DE FLUJO.
- CALCULADORA DE DOSIS AUTOMÁTICA QUE ADEMÁS DE LOS MODOS TRADICIONALES DE INFUSIÓN POR VOL/TIEMPO Y VOL/VELOCIDAD, PROPORCIONA 12 FORMAS DIFERENTES DE SUMINISTRO.
- BASADA EN PESO DEL PACIENTE
MG/KG/HR
MG/KG/MIN
MCG/KG/HR
MCG/KG/MIN
UD/KG/HR
MEQ/KG/HR
- INDEPENDIENTE AL PESO DEL PACIENTE
MG/HR
MG/MIN
MCG/HR
MCG/MIN
UD/HR
MEQ/HR
- COLOCACIÓN AUTOMÁTICA DEL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN CON DETECCIÓN DE COLOCACIÓN INCORRECTA
- PINZA DE APERTURA Y CIERRE ESPECIAL PARA MINIMIZAR LOS ERRORES QUE SE PUEDEN ATRIBUIR A LAS INSTALACIONES O LA EXTRACCIÓN DEL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.
- FUNCIÓN DE BLOQUEO DEL PANEL PARA MINIMIZAR LA POSIBILIDAD DE MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS O DE EXTRACCIÓN EQUIVOCADA DEL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.
- CENSOR DE AIRE PROGRAMABLE CON UN RANGO DE SENSIBILIDAD DE 25 A 150 MICROLITOS.
- PANTALLA PRINCIPAL CON 10 COLORES DIFERENTES Y LUZ DE FONDO QUE MUESTRE CLARAMENTE LA VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE INFUSIÓN, VELOCIDAD DE FLUJO, MEDICAMENTO INFUNDIDO, TIEMPO REMANENTE Y ALERTAS O ALARMAS.

- PANTALLA DE MÓDULO DE 8 CARACTERES QUE MUESTRA VELOCIDAD, TIEMPO, VOLUMEN, ETIQUETA, MENSAJES DE ALARMA Y ALERTA.
- HISTORIAL DE VOLUMEN QUE PROPORCIONA EL VOLUMEN DE LA SOLUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y EL VOLUMEN TOTAL SUMINISTRADO, FECHA Y TIEMPO REAL, ASÍ COMO LA FECHA Y HORA EN QUE SE ELIMINÓ EL ÚLTIMO HISTORIAL DE VOLUMEN.
- ALARMAS Y ALERTAS VISUALES Y AUDITIVAS QUE PERMITEN DETECTAR OCLUSIONES DE FLUJO. AIRE EN EL SISTEMA, FIN DE LA INFUSIÓN, FALLA DEL EQUIPO, CARGA DE LA BATERÍA, ETC.
- FUNCIONES DE ARRANQUE AUTOMÁTICO SI SE CORRIJEN LAS OCLUSIONES DENTRO DE LOS 60 SEGUNDOS DE DETECTADAS.
- GRÁFICO DE CONTROL DE FLUJO QUE MUESTRA LA RESISTENCIA EN LÍNEA AL FLUJO.
- SOFTWARE Y TECLADO EN IDIOMA ESPAÑOL.
- BIBLIOTECA DE ETIQUETAS QUE MUESTRA EL NOMBRE DEL MEDICAMENTO O FLUIDO A INFUNDIRSE. CUENTA CON 64 ETIQUETAS PRECONFIGURADAS Y 436 MÁS PARA CONFIGURARSE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL USUARIO.
- PROGRAMACIÓN DE MEDICAMENTOS CONFIGURABLE PARA PREDEFINIR LOS LÍMITES PARA LAS ETIQUETAS EN LA BIBLIOTECA DE ETIQUETAS DE LA BOMBA Y REDUCIR LA POSIBILIDAD DE ERRORES
- BATERÍA DE RESPALDO 4 HORAS DE FUNCIONAMIENTO APROXIMADAMENTE A 100 ML/HR...
- PINZA Y TUERCA DE MONTAJE PARA CABECERA O PORTASUERO
- SOFTWARE DE COLLEAGUE GUARDIAN, ES UNA HERRAMIENTA CONSTITUIDA POR UN CONJUNTO DE MEDICAMENTOS A LOS QUE SE ESTABLECEN LÍMITES DE CONCENTRACIÓN O DOSIS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PARA ADVERTIR AL USUARIO QUE LA DOSIS O LA VELOCIDAD DE INFUSIÓN PUEDE NO SER LA ADECUADA PARA UN DETERMINADO PACIENTE Y SE ELABORA SEGÚN LAS NECESIDADES DE LAS TERAPIAS CRÍTICAS EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SUS PACIENTES Y DEL TIPO DE MEDICAMENTOS QUE EN ELLAS SE MANEJAN.

APARATO ELECTROMECAÁNICO DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA DE ALTA PRECISIÓN ESTÁNDAR DE TRES CANALES, PORTÁTIL QUE CON EXACTITUD Y SEGURIDAD QUE PERMITE ADMINISTRAR EN FORMA CONSTANTE O INTERMITENTE, EN TIEMPO DETERMINADO, FLUIDOS PARENTERALES, MEDICAMENTOS, ELECTROLITOS, NUTRICIÓN PARENTERAL, SOLUCIONES PARA PROCEDIMIENTOS DE IRRIGACIÓN, SANGRE ENTERA Y HEMODERIVADOS A PACIENTES NEONATALES, PEDIÁTRICOS Y ADULTOS POR LAS VÍAS INTRAVENOSA, INTRARTERIAL, EPIDURAL Y SUBCUTÁNEA CUMPLIENDO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

TAMAÑO: 353 X 197 X 203 MM

PARÁMETROS DE INFUSIÓN

- RANGO DE VELOCIDAD DE FLUJO (PRIMARIO)
- 0.1-99.9 ML/HR (INCREMENTOS DE 0.1 ML.)
- 1-1,200 ML/HR (INCREMENTOS DE 1 ML.)
- RANGO DE VELOCIDAD DE FLUJO (SECUNDARIA)
- 0.1-99.9 ML/HR (INCREMENTOS) DE 1 ML.)
- 1-500 ML/HR (INCREMENTOS DE 1 ML.)
- VOLUMEN PARA SER INFUNDIDO
- 0.1-99.9 ML/HR (INCREMENTOS DE 0.1 ML.)

	• 1-9,999 ML/HR (INCREMENTOS DE 1 ML.) • RANGO DE PESO DEL PACIENTE (PARA MODOS DE DOSIS BASADA EN EL PESO DEL PACIENTE) 0,2 KG - 99,9 KG (INCREMENTOS DE 0,1 KG.) 100 KG - 600 KG (INCREMENTOS DE 1 KG) • VELOCIDAD DE FLUJO KVO (KEEP VEIN OPEN O MANTENER VÍA ABIERTA) • 0.1-5 ML/HR (INCREMENTOS DE 0.1 ML.) • MECANISMO DE BOMBEO BAXTER SHUTTLE, TECNOLOGÍA QUE ASEGURA LOS MÁS ALTOS NIVELES DE EXACTITUD PARA UN AMPLIO RANGO DE PROPORCIONES DE FLUJO. • CALCULADORA DE DOSIS AUTOMÁTICA QUE ADEMÁS DE LOS MODOS TRADICIONALES DE INFUSIÓN POR VOL/TIEMPO Y VOL/VELOCIDAD, PROPORCIONA 9 FORMAS DIFERENTES DE SUMINISTRO. • BASADA EN PESO DEL PACIENTE MG/KG/HR MG/KG/MIN MCG/KG/HR MCG/KG/MIN UD/KG/HR MEQ/KG/HR • INDEPENDIENTE AL PESO DEL PACIENTE MG/HR MG/MIN MCG/HR MCG/MIN UD/HR MEQ/HR • COLOCACIÓN AUTOMÁTICA DEL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN CON DETECCIÓN DE COLOCACIÓN INCORRECTA • PINZA DE APERTURA Y CIERRE ESPECIAL PARA MINIMIZAR LOS ERRORES QUE SE PUEDEN ATRIBUIR A LAS INSTALACIONES O LA EXTRACCIÓN DEL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. • FUNCIÓN DE BLOQUEO DEL PANEL PARA MINIMIZAR LA POSIBILIDAD DE MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS O DE EXTRACCIÓN EQUIVOCADA DEL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. • CENSOR DE AIRE PROGRAMABLE CON UN RANGO DE SENSIBILIDAD DE 25 A 150 MICROLITOS. • PANTALLA CON LUZ DE FONDO QUE MUESTRE CLARAMENTE LA VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE INFUSIÓN, VELOCIDAD DE FLUJO, MEDICAMENTO INFUNDIDO, TIEMPO REMANENTE Y ALERTAS O ALARMAS. • PANTALLA PRINCIPAL DE LA BOMBA QUE DESPLIEGA 10 COLORES DIFERENTES E INCLUYE INFORMACIÓN PARA LOS 3 CANALES DE UNA BOMBA DE TRIPLE CANAL. • HISTORIAL DE VOLUMEN QUE PROPORCIONA EL VOLUMEN DE LA SOLUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y EL VOLUMEN TOTAL SUMINISTRADO, FECHA Y TIEMPO REAL, ASÍ COMO LAS FECHAS Y HORA EN QUE SE ELIMINÓ EL ÚLTIMO HISTORIAL DE VOLUMEN. • ALARMAS Y ALERTAS VISUALES Y AUDITIVAS QUE PERMITEN DETECTAR OCLUSIONES DE FLUJO. AIRE EN EL SISTEMA, FIN DE LA INFUSIÓN, FALLA DEL EQUIPO, CARGA DE LA BATERÍA, ETC. • FUNCIONES DE ARRANQUE AUTOMÁTICO SI SE CORRIJEN LAS OCLUSIONES DENTRO DE LOS 60 SEGUNDOS DE DETECTADAS. • GRÁFICO DE CONTROL DE FLUJO QUE MUESTRA LA RESISTENCIA EN LÍNEA AL FLUJO.
--	---

		- SOTWARE Y TECLADO EN IDIOMA ESPAÑOL. - BLIBLIOTECA DE ETIQUETAS QUE MUESTRA EL NOMBRE DEL MEDICAMENTO O FLUIDO A INFUNDIRSE. CUENTA CON 64 ETIQUETAS PRECONFIGURADAS Y 436 MÁS PARA CONFIGURARSE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL USUARIO. - BATERÍA DE RESPALDO CON DURACIÓN DE 2 HORAS DE FUNCIONAMIENTO CON LOS TRES CANALES ACTIVOS A 100 ML/HR. - PINZA Y TUERCA DE MONTAJE PARA PORTA SUERO
	REPUESTA	SE ACEPTA PARA SER EVALUADA POR EL ÁREA EXPERTA.
10	REFERENCIA	2.- INFORMACIÓN GENERAL
	PREGUNTA	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, CONSIDERAR SI SE PUEDEN OFERTAR BIENES POR PARTIDA INDEPENDIENTE, ES DECIR, UNA PARTIDA DE CONSUMIBLES DE BOMBAS DE INFUSIÓN Y OTRA PARTIDA DE PERFUSORES.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA. FAVOR DE APEGARSE A BASES.
11	REFERENCIA	4.5.- REQUISITOS TÉCNICOS QUE COMPLEMENTAN Y CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA:
	PREGUNTA	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, DETERMINAR SI LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS BIENES OFERTADOS SE REQUIEREN SIMPLES O CON MARBETES.
	RESPUESTA	SIMPLES. LOS REGISTRO SANITARIOS DEBERÁN DE SER COMPLETOS, LEGIBLES Y VIGENTES.

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.

12	REFERENCIA	NUMERAL 4.5.4
	PREGUNTA	FAVOR DE INDICAR LA FECHA, HORARIO Y LUGAR DE ENTREGA DE LAS MUESTRAS FÍSICAS, ASÍ COMO FACILITAR EL FORMATO PARA ENTREGA DE DICHOS BIENES.
	RESPUESTA	LA ENTREGA DE LAS MUESTRAS SERÁ EL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS, LOS CUALES SERÁN EVALUADOS ESE MISMO DÍA DESPUÉS DE DICHA APERTURA EN EL HOSPITAL REGIONAL LIC. EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS, UBICADO EN CARRETERA A SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC S/N, POR LO QUE SE LE SOLICITA A TODOS LOS PROVEEDORES TRASLADARSE A DICHO HOSPITAL CON SUS MUESTRAS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS MISMOS. EL ORDEN EN EL QUE IRÁN PARTICIPANDO LOS PROVEEDORES SERÁ DE ACUERDO A COMO SE HAYAN REGISTRADO EN LA ENTRADA DEL HOSPITAL Y TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 30 MINUTOS LA PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS, CABE SEÑALAR QUE TODAS LAS MUESTRAS ESTARÁN RELACIONAS EN UN FORMATO QUE INCLUIRÁN EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y DOS COPIAS INDEPENDIENTES A LA PROPUESTA, PARA QUE SEA COTEJADA CON LAS MUESTRAS PRESENTADAS. DICHO FORMATO DEBERÁ VENIR EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE Y DIRIGIDA A LA CONVOCANTE, ADEMÁS DEBERÁ DE CONTENER LO SIGUIENTE: NOMBRE DEL PROVEEDOR NUM. DE PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA Y AL FINAL: FECHA, NOMBRE DE QUIEN RECIBE Y FIRMA.

13	REFERENCIA	NUMERAL 4.5.4
	PREGUNTA	EN CADA UNO DE LOS HOSPITALES DESTINO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA EXISTEN FÍSICAMENTE LOS EQUIPOS DESCRITOS EN LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 7, 8 Y 9, QUE AÚN ESTÁN EN USO. SOLICITAMOS SE NOS ACEPTE COPIA DEL PEDIDO O CONTRATO EMITIDO POR SALUD DE TLAXCALA AMPARANDO LAS MUESTRAS FÍSICAS DE LOS EQUIPOS DESCRITOS EN LAS PARTIDAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS. ¿SE NOS ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA. DEBERÁ DE PRESENTAR MUESTRA POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS SOLICITADAS.
14	REFERENCIA	NUMERAL 4.5.6
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ESTE DOCUMENTO A NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO EN MÉXICO (FILIAL DEL FABRICANTE), QUIEN ESTÁ FACULTADO PARA IMPORTAR Y DISTRIBUIR ESOS PRODUCTOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
15	REFERENCIA	ANEXO 1. PARTIDAS 8 Y 9.
	PREGUNTA	PUESTO QUE EN ESTAS PARTIDAS SON ACCESORIOS PARA LA BOMBA DE INFUSIÓN DESCRITA EN LA PARTIDA 7, ENTENDEMOS QUE NO DEBEMOS PRESENTAR REGISTRO SANITARIO PARA LAS PARTIDAS 8 Y 9, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	CONFORME AL PUNTO 4.5.2 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN INDICA QUE EN CASO DE QUE ALGUNA PARTIDA NO MANEJE REGISTRO SANITARIO, SE DEBERÁ DE PRESENTAR ESCRITO DE LA COFEPRIS DONDE SE INDIQUE QUE DICHO PRODUCTO NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO.
16	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDAS 4,5,6
	PREGUNTA	DEBIDO A LA TECNOLOGIA QUE OFERTARA MI REPRESENTADA EN PERFUSORES DPS CUYO AMPLIO RANGO DE CAPACIDADES Y DIFERENTES TIPOS DE JERINGA, ASEGURA LA ADAPTACIÓN PARA CUALQUIER PROTOCOLO DE INFUSIÓN EN ADULTOS Y PEDIÁTRICOS. NO SE PRECISA DE UNA MARCA ESPECIAL EN JERINGAS Y/O EXTENSIONES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE DICHO PERFUSOR DPS, TRADUCIENDOSE EN AHORROS IMPORTANTES PARA LA CONVOCANTE. POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE EL QUE SEA OPCIONAL EL OFERTAR LAS PARTIDAS PREVIAMENTE SEÑALADAS EN CONJUNTO CON LOS SETS DE INFUSION.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE DE DICHAS PARTIDAS, CONSIDERANDO QUE ES UN SERVICIO INTEGRAL COMO SE MENCIONA EN LAS BASES.

GRUPO AM TECNOLOGÍA MEDICA, S.A. DE C.V.

17	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 1
	PREGUNTA	SIN QUE ESTO CAUSE NINGÚN DAÑO AL PACIENTE, CON TODO RESPETO SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA NOS PERMITA COTIZAR EL EQUIPO CON LOS SIGUIENTES RANGOS LONGITUD Y EL PURGADO DEL EQUIPO DICE: 1.2.1.10. LONGITUD APROXIMADA 270 CM FAVOR DE AMPLIAR A 279 CM DICE:

		1.2.1.11. VOLUMEN DE PURGADO APROXIMADO DE 26 ML" FAVOR DE AMPLIAR A 49 ML
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
18	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 2
	PREGUNTA	SIN QUE ESTO CAUSE NINGÚN DAÑO AL PACIENTE, CON TODO RESPETO SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, NOS PERMITA COTIZAR EL EQUIPO CON LOS SIGUIENTES RANGOS LONGITUD Y EL PURGADO DEL EQUIPO. DICE: 1.2.3.10. LONGITUD APROXIMADA 270 CM FAVOR DE AMPLIAR A 315CM DICE: 1.2.3.11. VOLUMEN DE PURGADO APROXIMADO DE 25 ML (SIN BURETA)" FAVOR DE ACEPTAR A 12ML
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
19	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 7 BOMBAS DE INFUSIÓN (EQUIPOS EN COMODATO) Y LÍNEAS DE INFUSIÓN PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN Y PARA DIVERSAS APLICACIONES.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA NOS CONFIRME QUE LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS EN COMODATO QUE DEBERÁ DE CUBRIR LOS LICITANTES SON LAS SOLICITAS EN EL ANEXO 1, DEBIDO A QUE HAY BOMBAS DE INFUSIÓN CON TECNOLOGÍA REZAGADA DE MÁS DE 10 AÑOS EN EL PAÍS, ASÍ COMO QUE EXISTEN EQUIPOS MÉDICOS (BOMBAS DE INFUSIÓN CON TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA EN LA INFUSIÓN INTRAVENOSA EN EL MERCADO MUNDIAL) ASÍ MISMO SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA CONTRATANTE SALUD DE TLAXCALA EVALUARA Y TOMARA EN CUENTA LOS EQUIPOS QUE PUEDAN BRINDAR Y OFRECER A LOS PACIENTES MAYOR COMODIDAD, SEGURIDAD Y PRECISIÓN ASÍ COMO QUE LOS EQUIPOS EN COMODATO PUEDEN SER USADAS EN ÁREAS CRÍTICAS Y NO CRÍTICAS QUE NO SEAN VOLUMINOSAS Y AYUDEN A TENER UNA REDUCCIÓN DE ESPACIO CONSIDERABLE, MUCHO MÁS LIGERA AL UTILIZAR MENOS BOMBAS EN UN PACIENTE Y NO CAUSAR RIESGOS A UTILIZAR TORRES DE BOMBAS ENSAMBLADAS ASÍ COMO UTILIZAR MÁS ADITAMENTOS PARA LLEVAR A CABO UNA TERAPIA DE INFUSIÓN MAYOR A UNA O HASTA DIEZ INFUSIONES SIMULTANEAS
	RESPUESTA	CONFIRMAMOS QUE SE REALIZARA LA EVALUACIÓN MINUCIOSA Y ESTRUCTA A FIN QUE LOS EQUIPOS SEAN LOS QUE BRINDEN MAYOR BENEFICIO AL PACIENTE Y AL ÁREA USUARIA, EN TÉRMINOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA.
20	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 7 DICE: CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA DE UN CANAL PARA SERVICIOS HOSPITALARIOS NO CRÍTICOS.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA NOS PERMITA OFERTAR A MI REPRESENTADA UNA BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA INTELIGENTE CON MÁS DE UN CANAL SIN QUE ESTO CAUSE DAÑO AL PACIENTE Y SI GARANTICE UNA MAYOR SEGURIDAD AYUDANDO AL ÁREA USUARIA A UTILIZAR EN UNA MISMA BOMBA UNA, DOS O MÁS VIAS EN CASO DE SER NECESARIO GARANTIZANDO SEGURIDAD, PRECISIÓN, Y UNA EXACTITUD EN LA

		INFUSIÓN DE MEDICAMENTOS AL PACIENTE BRINDANDO UNA TECNOLOGÍA AVANZADA EN LA INFUSIÓN INTRAVENOSA ESTAS PUEDEN SER UTILIZADAS EN SERVICIOS NO CRÍTICOS Y CRÍTICOS COMO • PISO GENERAL • ÁREA MÉDICA QUIRÚRGICA • UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) UNIDAD CORONARIA • PEDIATRÍA • NEONATOLOGÍA • TRABAJO DE PARTO/POSPARTO • SALA DE OPERACIONES/ANESTESIA • POSTOPERATORIO/RECUPERACIÓN • URGENCIA • UNIDAD DE QUEMADOS • HEMODIÁLISIS • ONCOLOGÍA • NUTRICIONAL • UNIDAD MÓVIL DE CUIDADOS INTENSIVOS CONTANDO CON UNA AMPLIA GAMA DE PROGRAMAS COMO: CÁLCULO DE DOSIS (MCG/KG/MIN EN A) CÁLCULO DE DOSIS (MG/MIN EN B) DOSIS DE CARGA PROGRAMACIÓN DE PASOS MÚLTIPLES (BOLUS)
	RESPUESTA	SE ACEPTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA POR EL ÁREA EXPERTA.
21	REFERENCIA	ANEXO 1 1.2.2 EQUIPO PARA APLICACIÓN DE COMPONENTES SANGUÍNEOS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, CONSTA DE
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PRECISE LA CANTIDAD QUE ADQUIRIRÁ PARA ESTE EQUIPO. NO OMITIMOS INFORMAR A LA CONVOCANTE QUE EN LAS BOMBAS DE INFUSIÓN QUE OFRECE MI REPRESENTADA POR SU MECANISMO VOLUMÉTRICO NO PULSÁTIL (DE PISTÓN) PUEDE INFUNDIR HEMODERIVADOS COMO SANGRE, PLAQUETAS ETC. CON LA SEGURIDAD QUE ESTÁ INFUNDIENDO AL PACIENTE UN HEMODERIVADO TOTAL
	RESPUESTA	NO SE REQUIERE ESTE CONSUMIBLE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD ACTUAL EMITIDA POR EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN.
22	REFERENCIA	ANEXO 1 1.2.4. EQUIPO LIBRE DE PVC PARA APLICACIÓN NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL O FLUIDOS INCOMPATIBLES CON MATERIALES A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, CONSTA DE:
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PRECISE LA CANTIDAD QUE ADQUIRIRÁ PARA ESTE EQUIPO.
	RESPUESTA	NO SE REQUIERE ESTE CONSUMIBLE DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON SERVICIO SUBROGADO DE ALIMENTACIONES PARENTERALES.
23	REFERENCIA	ANEXO 1 CONDICIONES DEL SERVICIO VIII. TECNOLOGÍA Y CALIDAD DE LAS LÍNEAS EN COMODATO. LAS LÍNEAS DE INFUSIÓN QUE EL LICITANTE ADJUDICADO ENTREGUE DEBERÁN SER DE TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA. ESTOS EQUIPOS DEBERÁN ESTAR ENSAMBLADOS DE MANERA INTEGRAL EN EL PAÍS DE ORIGEN; DEBERÁN

		SER NUEVOS, ENTENDIÉNDOSE POR NUEVOS COMO EQUIPOS CON NO MÁS DE TRES AÑOS DE HABER SIDO FABRICADOS E INTRODUCIDOS AL PAÍS PARA SU COMERCIALIZACIÓN, NO SE ACEPTARÁN EQUIPOS DESCONTINUADOS EN EL PAÍS DE ORIGEN, NI RECONSTRUIDOS (REFURBISHED), NI CORRESPONDIENTES A BIENES DE SALDOS O REMANENTES QUE OSTENTEN LAS LEYENDAS "ONLYEXPORT" NI DE "ONLYINVESTIGATION", O CUALQUIER OTRA LEYENDA QUE IMPIDAN SU USO O COMERCIALIZACIÓN EN EL PAÍS DE ORIGEN, DEBIENDO PRESENTAR COPIA DEL CERTIFICADO DE LIBRE VENTA, EL PEDIMENTO Y COPIA DE CERTIFICADO DE CALIDAD, COMO PUEDE SER FDA, CE, ISO Y/O TUV, (SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTARLO). DE IGUAL FORMA, A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA INFUSIÓN Y DEL PACIENTE, LOS EQUIPOS OFERTADOS NO DEBERÁN ESTAR BOLETINADAS NI CONTAR CON ALARMAS SANITARIAS O RECALLS EMITIDAS POR ALGUNA AUTORIDAD SANITARIA LOCAL O INTERNACIONAL COMO LA COFEPRIS, FDA, O LA CE.
	PREGUNTA	EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE LICITACIÓN, SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA CONFIRME A MI REPRESENTADA QUE ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS EQUIPOS EN COMODATO QUE SE ENTREGUE A LA INSTITUCIÓN DEBERÁN DE SER NUEVOS Y DE RECIÉN FABRICACIÓN DEBIÉNDOSE COMPROBAR CON LOS PEDIMENTOS DE IMPORTACIÓN CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A 6 MESES Y NO HABER SIDO USADOS. DADO QUE UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A ESTA EXISTE LA PROBABILIDAD QUE ESTOS HAYAN SIDO USADOS O RECONSTRUIDOS Y/O TENGAN ALERTAS SANITARIAS POR LA COFEPRIS, FDA O ALGUNA ENTIDAD SANITARIA
	RESPUESTA	DEBERÁ DE SER UNA BOMBA NUEVA Y CON TECNOLOGÍA ACTUALIZADA, CON NO MÁS DE TRES AÑOS DE HABER SIDO FABRICADA. DEBIÉNDOSE COMPROBAR CON COPIAS DEL CERTIFICADO DE LIBRE VENTA, PEDIMENTOS DE IMPORTACIÓN CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A 6 MESES. Y CERTIFICADOS DE CALIDAD, COMO PUEDE SER FDA, CE, ISO, Y/O TUV.
24	REFERENCIA	ANEXO 1 CONDICIONES DEL SERVICIO LOS INSTRUCTORES DEBERÁN PRESENTAR CONSTANCIA CON VALOR CURRICULAR CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A TRES AÑOS AVALADO POR LA FACULTAD O ESCUELA DE ENFERMERÍA DE CUALQUIER INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA O PRIVADA DEBIDAMENTE INSTITUIDA EN MÉXICO
	PREGUNTA	DEBIDO A QUE NO ES UN REQUISITO OFICIAL PARA MI REPRESENTADA QUE UNA FACULTAD O ESCUELA DE ENFERMERÍA DE CUALQUIER INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA O PRIVADA DEBIDAMENTE INSTITUIDA EN MÉXICO, RESPALDE COMO PERSONAL ESPECIALIZADO EN TERAPIA DE INFUSIÓN A LOS TÉCNICOS O CAPACITADORES EN TERAPIA DE INFUSIÓN DE MI REPRESENTA. SIN QUE ESTO CAUSE NINGÚN DAÑO AL PACIENTE, CON TODO RESPECTO SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA NOS PERMITA ENTREGAR LAS CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR EL FABRICANTE O SU FILIAL EN TERRITORIO MEXICANO, QUE ESTÁN DEBIDAMENTE ENTRENADOS Y CAPACITADOS PARA IMPARTIR INSTRUCCIÓN SOBRE EL ADECUADO MANEJO Y USO DE LAS LÍNEAS DE INFUSIÓN, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES
	RESPUESTA	SE ACEPTA.
25	REFERENCIA	PUNTO 4.5.6 LICENCIA SANITARIA DE LICITANTE EN COPIA Y ORIGINAL PARA SU COTEJO
	PREGUNTA	EN CONSIDERACIÓN CON LA LEY DE SALUD VIGENTE Y A QUE ESTA

		LICITACIÓN NO SE REFIERE A MEDICAMENTOS CONTROLADOS, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ME PERMITE PRESENTAR AVISO DE FUNCIONAMIENTO O LICENCIA SANITARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO.
		AGRADECERÉ POR LO ANTES EXPUESTO SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA O BIEN SE SUSTENTE SU NEGATIVA
		SE ACEPTA

FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.

26	REFERENCIA	PUNTO 3.8
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI PARA EL CASO DE MI REPRESENTADA QUE PRESENTA LOS PAGOS PROVISIONALES VIA ELECTRONICA, BASTARA CON PRESENTAR LA IMPRESIÓN QUE CONTENGA LA LIGA DIGITAL DEL SAT CORRESPONDIENTE EN EL FOLDER DE COPIAS, DE LO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y ESPECIFICAR.
	RESPUESTA	DEBERÁ PRESENTAR RECIBO BANCARIO DE PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2015, CON EL ACUSE DEL RECIBO DEL SAT Y CON LA LIGA DIGITAL, EN ORIGINAL Y COPIA. SE ENTIENDEN POR ORIGINAL EL DOCUMENTO IMPRESO DIRECTAMENTE DE LA PÁGINA DEL SAT.
27	REFERENCIA	PUNTO 4.5.4
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI TAMBIEN SE DEBERA PRESENTAR MUESTRA DE LA BOMBA DE INFUSION
	RESPUESTA	ES CORRECTO, DEBERÁ PRESENTARSE MUESTRA FÍSICA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS.
28	REFERENCIA	PUNTO 4.5.6
	PREGUNTA	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE EL QUE SE ACEPTE PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO DE LA LICENCIA SANITARIA.
	RESPUESTA	SE ACEPTA PRESENTAR COPIA CERTIFICADA, SIN EMBARGO DEBERÁN ESTAR A NOMBRE DEL LICITANTE.
29	REFERENCIA	PUNTO 5.1.9
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES OPCIONAL PROTEGER CON CINTA ADHESIVA LOS PRECIOS UNITARIOS.
	RESPUESTA	ES OPCIONAL.
30	REFERENCIA	PUNTO 6.1
	PREGUNTA	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA GARANTIA DE SOSTENIMIENTO PODRA PRESENTARSE POR UN MONTO IGUAL O MAYOR AL 10% DEL VALOR DE NUESTRA PROPUESTA SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO.
	RESPUESTA	ES CORRECTO.
31	REFERENCIA	PUNTO 22.1
	PREGUNTA	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA ENTREGA A LA QUE HACE REFERENCIA EL CITADO PUNTO ES POR EL 100% DE LOS BIENES ASIGNADOS. EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR Y ESPECIFICAR.

	RESPUESTA	LA ENTREGA TANTO DE LOS CONSUMIBLES COMO DE LOS EQUIPOS EN COMODATO SERÁ CONFORME A LOS CUADROS DE DISTRIBUCIÓN QUE SE ENTREGARÁN ANEXO AL PEDIDO AL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO, CABE SEÑALAR QUE SOLO SERA UN PROVEEDOR DEBIDO A QUE SE SOLICITO FUERA DE MANERA GLOBAL DICHA ADQUISICIÓN, PUESTO QUE LOS CONSUMIBLES DEBERÁN DE SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS EN COMODATO. LA PRIMERA ENTREGA SERA A LOS 10 DÍAS HÁBILES DE LA EMISIÓN DEL FALLO (CONSUMIBLES Y EQUIPOS EN COMODATO) Y POSTERIORMENTE LOS CONSUMIBLES SERÁN ENTREGADOS LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES DE CADA MES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN CADA CENTRO HOSPITALARIO.
32	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDAS 4,5,6
	PREGUNTA	DEBIDO A LA TECNOLOGIA QUE OFERTARA MI REPRESENTADA EN PERFUSORES DPS CUYO AMPLIO RANGO DE CAPACIDADES Y DIFERENTES TIPOS DE JERINGA, ASEGURA LA ADAPTACIÓN PARA CUALQUIER PROTOCOLO DE INFUSIÓN EN ADULTOS Y PEDIÁTRICOS. NO SE PRECISA DE UNA MARCA ESPECIAL EN JERINGAS Y/O EXTENSIONES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE DICHO PERFUSOR DPS, TRADUCIENDOSE EN AHORROS IMPORTANTES PARA LA CONVOCANTE. POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE EL QUE SEA OPCIONAL EL OFERTAR LAS PARTIDAS PREVIAMENTE SEÑALADAS EN CONJUNTO CON LOS SETS DE INFUSION.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA PREGUNTA N°16
33	REFERENCIA	ANEXO 1, PARTIDAS 8 SOPORTE PARA BOMBA DE INFUSION Y 9 PERFUSOR PARA BOMBA DE INFUSION
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI SERA CORRECTO PLASMAR COMO PARTE DE NUESTRA PROPUESTA TECNICA LA DESCRIPCION DE AMBAS PARTIDAS.
	RESPUESTA	ES CORRECTO.
34	REFERENCIA	ANEXO 1, PARTIDA 7 BOMBAS DE INFUSION (EQUIPOS EN COMODATO)
	PREGUNTA	COMO PARTE DE LA DESCRIPCION DE LA BOMBA DE INFUSION SOLICITAN EN EL PUNTO 1.2.2 LA SIGUIENTE DESCRIPCION: 1.2.2. EQUIPO PARA APLICACIÓN DE COMPONENTES SANGUÍNEOS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, CONSTA DE: 1.2.2.1. BAYONETA, 1.2.2.2. FILTRO PARA MICRO COÁGULOS DE 170 A 200 MICRAS, 1.2.2.3. CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON FILTRO DE 15 MICRAS, 1.2.2.4. TUBO TRANSPORTADOR, 1.2.2.5. MECANISMO REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO, 1.2.2.6. CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE, 1.2.2.7. CONECTORES LUERLOCK, 1.2.2.8. PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR, 1.2.2.9. LONGITUD APROXIMADA 270 CM, 1.2.2.10. VOLUMEN DE PURGADO APROXIMADO DE 27 ML. DEBIDO A QUE ESTA DESCRIPCION CORRESPONDE A UN CONSUMIBLE PARA SER USADO CON LA BOMBA DE INFUSION, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE ESTA ES SOLO ENUNCIATIVA Y QUE NO SERA OFERTADO.
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, YA QUE NO SE REQUIERE ESTE CONSUMIBLE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD ACTUAL EMITIDA POR EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN.
35	REFERENCIA	ANEXO 1, PARTIDA 7 BOMBAS DE INFUSION (EQUIPOS EN COMODATO)
	PREGUNTA	COMO PARTE DE LA DESCRIPCION DE LA BOMBA DE INFUSION SOLICITAN EN EL PUNTO 1.2.4 LA SIGUIENTE DESCRIPCION:

		1.2.4. EQUIPO LIBRE DE PVC PARA APLICACIÓN NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL O FLUIDOS INCOMPATIBLES CON MATERIALES A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, CONSTA DE: 1.2.4.1 BAYONETA, 1.2.4.2. FILTRO DE AIRE CON TAPÓN, 1.2.4.3. CÁMARA DE GOTEÓ FLEXIBLE CON FILTRO DE 15 MICRAS, 1.2.4.4. TUBO TRANSPORTADOR, 1.2.4.5. MECANISMO REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO, 1.2.4.6. CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE, 1.2.4.7. CON UNO O MÁS DISPOSITIVOS EN "Y" PARA INYECCIÓN, 1.2.4.8. CONECTORES LUERLOCK, 1.2.4.9. PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR, 1.2.4.10. LONGITUD APROXIMADA 270 CM, 1.2.4.11. VOLUMEN DE PURGADO APROXIMADO DE 25 ML. DEBIDO A QUE ESTA DESCRIPCION CORRESPONDE A UN CONSUMIBLE PARA SER USADO CON LA BOMBA DE INFUSION, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE ESTA ES SOLO ENUNCIATIVA Y QUE NO SERA OFERTADO.
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBIDO A QUE SE CUENTA CON SERVICIO SUBROGADO DE ALIMENTACIÓN PARENTERAL.
36	REFERENCIA	ANEXO 1, PARTIDA 7 BOMBAS DE INFUSION (EQUIPOS EN COMODATO), CONDICIONES DEL SERVICIO, ANEXOS B Y C
	PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LO CORRECTO SERA PLASMAR EN DICHS ANEXOS LO ASENTADO EN EL APARTADO DE CONDICIONES DEL SERVICIO Y QUE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTE PUNTO SERAN ENTREGADOS EN SU MOMENTO POR EL PROVEEDOR ASIGNADO, YA QUE MENCIONA DOCUMENTOS TALES COMO: PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y CALENDARIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTINIMIENTOS CORRECTIVOS, FAVOR DE ACLARAR Y ESPECIFICAR.
	RESPUESTA	ES CORRECTO LAS CONDICIONES DEL SERVICIO CONTEMPLA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CALENDARIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS.

NOTAS GENERALES:

1.- MEDIANTE NO. OFICIO OF/RM/797/06/2015, DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2015 Y RECIBIDO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCIÓN CON FECHA 04 DE JUNIO DE 2015, LA CONTRATANTE EL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA, SOLICITA HACER LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES A LAS BASES:

✓ SE HACE UNA CORRECCIÓN A LAS PARTIDAS 4 Y 5 DEL ANEXO 1, YA QUE DEBE DECIR LO SIGUIENTE:

PARTIDA 4. EXTENSIÓN PARA USO EN JERINGAS Y PERFUSORES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, FÁRMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS, ESTÉRIL, DESECHABLE, LIBRE DE LÁTEX, CONEXIÓN MACHO HEMBRA, CONEXIÓN LUER LOCK DE SEGURIDAD. EXTENSIÓN DE 75 A 150 CMS; VOLUMEN DE PURGADO HASTA 3 ML.

PARTIDA 5. EXTENSIÓN PARA USO EN JERINGAS Y PERFUSORES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, FÁRMACOS Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS, OPACA, ESTÉRIL, DESECHABLE, LIBRE DE LÁTEX, CONEXIÓN MACHO HEMBRA, CONEXIÓN LUER LOCK DE SEGURIDAD. EXTENSIÓN DE 75 A 150 CMS; VOLUMEN DE PURGADO HASTA 3 ML.

✓ SE HACE LA OBSERVACIÓN EN EL PUNTO 4.5.2 INCISO B), YA QUE EN CASO DE PRESENTAR PRORROGA, DEBERÁ DE SER MÍNIMO DEL AÑO 2014 Y CON EL FORMATO COMPLETO.

✓ DE ACUERDO AL PUNTO 4.5.3 DE LAS BASES, DEBERÁ DE PRESENTAR FICHAS, CATÁLOGOS O MANUALES DE TODAS LAS PARTIDAS OFERTADAS.

✓ COPIA FOTOSTÁTICA DE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA VIGENTE.

✓ LA ADJUDICACIÓN DE ESTA LICITACIÓN SERÁ DE MANERA GLOBAL, NO POR PARTIDA.

SE LE RECUERDA AL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO QUE DEBERÁ DE ACUDIR A LAS INSTALACIONES DE ESTE O.P.D. PARA RECOGER SU PEDIDO Y CUADRO DE DISTRIBUCIÓN A LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO.

POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES EN SUS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 8.5 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.

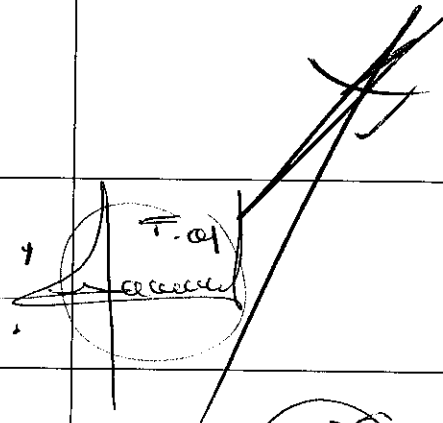




2.- SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL CANJE DE SU COPIA DE LA FICHA BANCARIA POR EL RECIBO OFICIAL ES ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (CAJA) PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NÚM. 3 PLANTA BAJA TLAXCALA, TLAX., Y LO PODRÁN REALIZAR LOS DÍAS 17 Y 18 DE JUNIO DE 2015, EN UN HORARIO DE ATENCIÓN DE 9:00 A 14:00 HORAS.

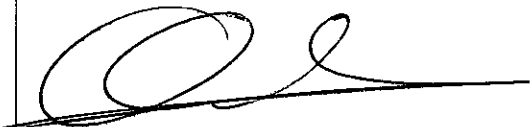
3.- EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y REVISIÓN LEGAL, SE LLEVARA ACABO EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2015 A LAS 10:00 HRS.

-----LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:-----



LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 12:00 HORAS. DEL DÍA DE SU INICIO LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

REPRESENTANTES

DIR. JORGE CAPIZ JASSO		
LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO		
C.P. MICAELA TANIA DEGALES MORALES		
LIC. MARÍA DEL ROCÍO LIMA GONZÁLEZ		
L.E. LUCERO SALOME DÍAZ ARROLLO		

L.E.O. CONSUELO RAMÍREZ HERNÁNDEZ	
LIC. ADÁN RAMÍREZ CANTE	NO SE PRESENTO
LIC. ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA	
LIC. OSWALDO AQUIAHUATL JIMÉNEZ	

LICITANTES

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.	
IMPORTADORA DE EQUIPO MÉXICO, S.A. DE C.V.	
FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.	
GRUPO AM TECNOLOGÍA MÉDICA, S.A. DE C.V.	

HI TEC MEDICAL DEL SUR, S.A. DE C.V.

-----FIN DE TEXTO-----