

**DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES  
 JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-061/2015  
 REFERENTE A LA ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS CON EQUIPO EN COMODATO  
 PARA EL OPD SALUD DE TLAXCALA**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAX., SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2015, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO, TLAXCALA, LOS CC. **JORGE CAPIZ JASSO**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA LIC. **ALEJANDRA FLORES MONTALVO** DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO DRMSYA/215/2015 DE FECHA 19 DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE, LA C.P. **MICAELA TANIA DEGALES MORALES** COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE; EL C.P. **JOSÉ EMILIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA; EL DR. **ARMANDO GARCÍA TEPIXTLE**, DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUINEA; LA Q.F.B. **ROSA AURORA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ**, ANALISTA CLÍNICO; EL Q.F.B. **ISRAEL OJEDA AZUREZ**, RESPONSBLE LABORATORIO HOSPITAL INFANTIL DE TLAXCALA; EL LIC. **HÉCTOR JÚAREZ BERISTAIN**, AUXILIAR DEL ÁREA DE LICITACIONES; EL LIC. **ADÁN RAMÍREZ CANTE** COMO REPRESENTANTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y O.P.D. SALUD DE TLAXCALA; EL LIC. **ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA** COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO, ASÍ MISMO EL LIC. **OSWALDO AQUIAHUATL JIMÉNEZ** COMO REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO. A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-061/2015, EL PRESENTE EVENTO SE LLEVA A CABO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, ASÍ COMO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

**HECHOS:** SE DIO INICIO CON LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS QUE LOS LICITANTES REALIZARON CON ANTERIORIDAD, DE ACUERDO AL PUNTO 7 DE LAS BASES, SIENDO LAS SIGUIENTES:

**SOLUCIONES Y EQUIPOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.**

<b>1</b>	<b>REFERENCIA</b>	NUMERAL BASES 3.14 NOTA
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI PODEMOS PRESENTAR EXCLUSIVAMENTE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES Ó COPIAS CERTIFICADAS EN MICAS TRANSPARENTES YA QUE ESTO PERMITE LA RÁPIDA IDENTIFICACIÓN DE CADA DOCUMENTO. SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.</b>
<b>2</b>	<b>REFERENCIA</b>	NUMERAL BASES 4.5.10
	<b>PREGUNTA</b>	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, QUE PARA CUBRIR ESTE PUNTO, SE PUEDA PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL MAYORISTA AUTORIZADO EN MÉXICO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS Y/O CONSUMIBLES CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS ANEXANDO LA CARTA ORIGINAL EMITIDA POR EL DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUIEN ES EL TITULAR DE LOS REGISTROS SANITARIOS EN MÉXICO Y AUTORIZA A ÉSTE ÚLTIMO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LA LÍNEA, SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE SOLICITA CARTA EN ORIGINAL DEL FABRICANTE DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE RESPALDA LA PROPUESTA DEL DISTRIBUIDOR Y GARANTIZA EL ABASTO SUFICIENTE DE INSUMOS Y EQUIPOS.</b>
<b>3</b>	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO 1. CONDICIONES DE SERVICIO DESCRIPCIÓN DE LAS BOLSAS DE SANGRE Y PRUEBAS SEROLOGICAS PARA SERVICIO INTEGRAL DEL BANCO DE SANGRE: BOLSA CUADRUPLE TOP AND BOTTOM CPD/ ADSOL BOLSA PARA FRACCIONAR SANGRE CUADRUPLE TIPO TOP AND BOTTOM: CONTIENE UNA BOLSA PRIMARIA DE 450 - 500 ML PL- 146

		<p>CON 63 A 70 ML DE SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE CPD, CONECTADA A UN TUBO COLECTOR INTEGRAL Y A UN SISTEMA SECUNDARIO FORMADO POR TRES BOLSAS UNA BOLSA VACÍA DE 350 - 400 ML PL146, OTRA VACÍA DE 400-450 ML PL-1240 PARA ALMACENAR PLAQUETAS POR 5 DÍAS Y UNA MAS DE 450 ML PL-146 CONTENIDO 100 ML DE SOLUCION ADITIVA ADSOL QUE PROPORCIONA COMO MINIMO 42 DÍAS DE VIGENCIA AL CONCENTRADO ERITROCITARIO; CON AGUJA CALIBRE 16 G CON INDICADOR DE BISEL TACTIL Y VISUAL. COMPATIBLE CON SISTEMA DE REDUCCION DE LEUCOCITOS EN 1 O MAS LOGARITMOS</p>
	<p><b>PREGUNTA</b></p>	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON BOLSA CUADRUPLE QUE CUMPLE PERFECTAMENTE CON LOS REQUERIMIENTOS QUE SOLICITAN Y QUE TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: BOLSA CUÁDRUPLE PARA FRACCIONAR SANGRE TIPO TOP AND BOTOM QUE CONTIENE UNA BOLSA PRIMARIA DE 600 ML PARA CAPTAR 450 ML ± 10 % DE SANGRE TOTAL CON 63 ML DE SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE CPD, CONECTADA A UN TUBO COLECTOR INTEGRAL EL CUAL CUENTA CON UNA PINZA REVERSIBLE (PINZA AZUL), CON AGUJA RETRÁCTIL CALIBRE 16 G TRIFACIAL, CON TAPÓN QUE ABRE FÁCILMENTE Y PROTECTOR DE AGUJA IRREVERSIBLE. CONTIENE SITIO CON TOMA DE MUESTRA CON CAPACIDAD DE 40 ML CON PINZA DE SEGURIDAD IRREVERSIBLE (PINZA BLANCA) Y CONECTADA A UN SISTEMA SECUNDARIO FORMADO POR 3 BOLSAS CON CAPACIDAD DE 600 ML CADA UNA; DOS DE ELLAS POR LA PARTE SUPERIOR PARA ALMACENAR PLASMA Y/O PLAQUETAS POR 5 DÍAS INDISTINTAMENTE Y UNA POR LA PARTE INFERIOR QUE CONTIENE 100 ML DE SOLUCIÓN ADITIVA SAG-MANITOL QUE PROPORCIONA COMO MÍNIMO 42 DÍAS DE VIGENCIA AL CONCENTRADO ERITROCITARIO LA CUAL CUENTA CON UNA TUBERÍA CON IDENTIFICACIÓN SERIAL. BOLSA COMPATIBLE CON SISTEMA DE LEUCORREDUCCIÓN EN 1 O MÁS LOGARITMOS Y QUE CUENTA CON SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL DESECHO DE LA AGUJA EN EL MISMO SOPORTE DEL SITIO DE TOMA DE MUESTRA DISMINUYENDO RIESGOS PARA EL USUARIO.</p>
	<p><b>RESPUESTA</b></p>	<p><b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.</b></p>
<p>4</p>	<p><b>REFERENCIA</b></p>	<p>ANEXO 1. CONDICIONES DE SERVICIO BOLSA TRIPLE TOP AND BOTTOM CPD / ADSOL BOLSA PARA FRACCIONAR SANGRE TRIPLE TIPO TOP AND BOTTOM: CONTIENE UNA BOLSA PRIMARIA DE 450-500 ML PL- 146 CON 63 A 70 ML DE SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE CPD, CONECTADA A UN TUBO COLECTOR INTEGRAL Y A UN SISTEMA SECUNDARIO FORMADO POR TRES BOLSAS UNA BOLSA VACÍA DE 350 - 400 ML PL-146, Y OTRA DE 450 ML PL-146 CONTENIDO 100 ML DE SOLUCION ADITIVA ADSOL QUE PROPORCIONA COMO MINIMO 42 DIAS DE VIGENCIA AL CONCENTRADO ERITROCITARIO; CON AGUJA CALIBRE 16 G CON INDICADOR DE BISEL TACTIL Y VISUAL. COMPATIBLE CON SISTEMA DE REDUCCION DE LEUCOCITOS EN 1 O MAS LOGARITMOS.</p>
	<p><b>PREGUNTA</b></p>	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON BOLSA TRIPLE QUE CUMPLE PERFECTAMENTE CON LOS REQUERIMIENTOS QUE SOLICITAN Y QUE TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: BOLSA TRIPLE PARA FRACCIONAR SANGRE TIPO TOP AND BOTOM QUE CONTIENE UNA BOLSA PRIMARIA DE DE 600 ML PARA CAPTAR 450 ML ± 10 % DE SANGRE TOTAL CON 63 ML DE SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE CPD, CONECTADA A UN TUBO COLECTOR INTEGRAL EL CUAL CUENTA CON UNA PINZA REVERSIBLE (PINZA AZUL), CON AGUJA RETRÁCTIL CALIBRE 16 G TRIFACIAL, CON TAPÓN QUE ABRE FÁCILMENTE Y PROTECTOR DE AGUJA IRREVERSIBLE. CONTIENE</p>

		SITIO CON TOMA DE MUESTRA CON CAPACIDAD DE 40 ML CON PINZA DE SEGURIDAD IRREVERSIBLE (PINZA BLANCA) Y CONECTADA A UN SISTEMA SECUNDARIO FORMADO POR 2 BOLSAS CON CAPACIDAD DE 600 ML CADA UNA; UNA DE ELLAS POR LA PARTE SUPERIOR PARA ALMACENAR PLASMA Y UNA POR LA PARTE INFERIOR QUE CONTIENE 100 ML DE SOLUCIÓN ADITIVA SAG-MANITOL QUE PROPORCIONA COMO MÍNIMO 42 DÍAS DE VIGENCIA AL CONCENTRADO ERITROCITARIO LA CUAL CUENTA CON UNA TUBERÍA CON IDENTIFICACIÓN SERIAL. BOLSA COMPATIBLE CON SISTEMA DE LEUCORREDUCCIÓN EN 1 O MÁS LOGARITMOS Y QUE CUENTA CON SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL DESECHO DE LA AGUJA EN EL MISMO SOPORTE DEL SITIO DE TOMA DE MUESTRA DISMINUYENDO RIESGOS PARA EL USUARIO.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES.</b>
<b>5</b>	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO 1. CONDICIONES DE SERVICIO BOLSA SIMPLE BOLSA SENCILLA CON CAPACIDAD DE 450ML PARA OBTENCIÓN DE SANGRE TOTAL DE DONACIÓN Y/O SANGRÍAS TERAPÉUTICAS. PLASTICO PL 146 Y SOLUCION ADENINA. AGUJA CON CAPUCHON NO REPOSICIONABLE Y BISEL PARA FACILITAR SU USO, DE UNA SOLA PIEZA. PAQUETE CON 12 UNIDADES
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON BOLSA SENCILLA QUE CUMPLE PERFECTAMENTE CON LOS REQUERIMIENTOS QUE SOLICITAN Y QUE TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; BOLSA PARA OBTENCIÓN DE SANGRE SENCILLA QUE CONTIENE UNA BOLSA PRIMARIA DE 450 ± 10% ML CON 63 ML DE SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE CPDA (CPD-ADENINA), CON AGUJA CALIBRE 16 G TRIFACIAL, CON TAPÓN QUE ABRE FÁCILMENTE Y PROTECTOR DE AGUJA IRREVERSIBLE.SITIO CON TOMA DE MUESTRA SISTEMA CON PINZA DE SEGURIDAD IRREVERSIBLE.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES.</b>

**IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.**

<b>6</b>	<b>REFERENCIA</b>	PUNTO 4.5.10
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAN, EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA DISTRIBUIDOR DEBERÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE. SOLICITAMOS NOS PERMITAN PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE Ó TITULAR DE LOS REGISTROS SANITARIOS Ó DISTRIBUIDOR PRIMARIO O MAYORISTA EN MÉXICO, POR MEDIO DE LA CUAL MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE RESPALDA LA PROPOSICIÓN DEL DISTRIBUIDOR (LICITANTE) Y LE GARANTIZA EL ABASTO SUFICIENTE PARA QUE A SU VEZ PUEDA CUMPLIR CON LO ADJUDICADO QUE SE DERIVE DE ESTA LICITACIÓN, ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>REFERIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NO. 2</b>
<b>7</b>	<b>REFERENCIA</b>	PUNTO 4.5.11
	<b>PREGUNTA</b>	SEÑALAN QUE LA ANTIGÜEDAD DE LOS EQUIPOS PRESENTADOS DEBE ESTAR SUSTENTADO CON EL CERTIFICADO DE MANUFACTURA, NO SE ACEPTAN DECLARACIONES JURADAS. ENTENDEMOS QUE LOS CERTIFICADOS DE MANUFACTURA DEBERÁN SER PRESENTADOS POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

	<b>RESPUESTA</b>	<b>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b>
<b>8</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>DETALLE ANEXO 1 PAGINA 25 DE BASES</b>
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAN PRESENTAR CARTA COMPROMISO EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE COMPROMETE A REALIZAR LOS ANÁLISIS DE CRETIB. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, PODEMOS PRESENTAR LOS ANÁLISIS CRETIB Y/O HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIAL (MSDS), ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA.</b>
<b>9</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EN EL ANEXO 1 PAGINA 24 PARRAFO 6 DE BASES</b>
	<b>PREGUNTA</b>	SEÑALAN QUE LA FECHA DE CADUCIDAD DEL REACTIVO DEBERÁ SER DE 12 MESES MÍNIMO CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE INDIQUEN UNA CADUCIDAD MENOR POR LA INESTABILIDAD DEL REACTIVO. ENTENDEMOS QUE LOS REACTIVOS QUE SE ENTREGUEN CON UNA CADUCIDAD MENOR A 12 MESES POR LA INESTABILIDAD DEL REACTIVO, EL PROVEEDOR ADJUDICADO PRESENTARÁ CARTA COMPROMISO DE CANJE EN LA CUAL SE COMPROMETE A CAMBIAR LOS BIENES QUE NO SE HAYAN CONSUMIDO EN SU VIDA ÚTIL, SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO, ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA.</b>
<b>10</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>ANEXO 1 PARTIDAS Y CANTIDADES SOLICITADAS</b>
	<b>PREGUNTA</b>	PODRÍA LA CONVOCANTE PROPORCIONAR EL NÚMERO DE PRUEBAS DE CADA PRUEBA POR UNIDAD, ESTO CON EL OBJETIVO DE FACILITAR EL DESGLOSE DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES EN NUESTRA PROPUESTA, FAVOR DE ACLARAR
	<b>RESPUESTA</b>	<b>ESTA INFORMACIÓN SE ENTREGARÀ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.</b>
<b>11</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>ANEXO 1 – PARTIDA 52,53,54 - ELECTROLITOS PAQ DE SOLUCIONES CLORO, SODIO Y POTASIO</b>
	<b>PREGUNTA</b>	LES PEDIMOS DE FAVOR NOS INDIQUEN DEL TOTAL DE PRUEBAS DE ELECTROLITOS PARTIDA 52, 53, 54, CUÁNTOS SE PROCESARÁN EN LOS EQUIPOS DE QUÍMICA CLÍNICA DE ALTO RENDIMIENTO Y EL DESGLOSE PARA LOS HOSPITALES, FAVOR DE ACLARAR.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>ESTA INFORMACIÓN SE ENTREGARA AL PROVEEDOR ADJUDICADO.</b>
<b>12</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>ANEXO 1 CONTROL DE CALIDAD PAG 26</b>
	<b>PREGUNTA</b>	INSCRIBIR A LOS LABORATORIOS A UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO (PACAL), ES POSIBLE PODER ENTREGAR UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DISTINTO AL DE PACAL, EL CUAL CUBRE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NOM-007-SSA3-2001 DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS, CON EL FIN DE QUE LOS LABORATORIOS DEL PRESENTE CONTRATO ESTÉN SIENDO CALIFICADOS CON EL GRUPO DE LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA MARCA Y MODELO DE EQUIPO A OFERTAR LA PRESENTE LICITACIÓN, SIN COSTO ALGUNO PARA EL CONTRATANTE, ¿SE ACEPTA? .
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SI SE ACEPTA.</b>
<b>13</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>ANEXO 1 – PARTIDA 45 – EQUIPO NO. 2</b>
	<b>PREGUNTA</b>	NOS PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE PRUEBAS QUE SE CORRERÁN EN LOS EQUIPOS NO. 2 PARA HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA LOS HOSPITALES DONDE NO PROCESAN LA PRUEBA DE HEMOGLOBINA EN EL EQUIPO DE QUÍMICA CLÍNICA, FAVOR DE ACLARAR
	<b>RESPUESTA</b>	<b>ESTA INFORMACIÓN SE ENTREGARÀ AL PROVEEDOR ADJUDICADO.</b>
<b>14</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>ANEXO 1 PAGINA 26 PARRAFO 8</b>
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAN CUANDO EL PROVEEDOR, NO PROPORCIONE LOS CONTROLES

		DE TERCERA OPINION. SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN CONTROL DE CALIDAD EXTERNO AVALADO POR LA EMA DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO PARA CADA UNO DE LOS PAQUETES SOLICITADOS (QUIMICA CLINICA, HEMATOLOGIA, URO ANALISIS, BACTERIOLOGIA, HORMONAS, BANCO DE SANGRE), LO QUE NOS PERMITIRÁ PROPORCIONAR UN PRECIO MÁS BAJO EN COMPARACIÓN A UN CONTROL DE TERCERA OPINION ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA.</b>
<b>15</b>	<b>REFERENCIA PREGUNTA</b>	ANEXO B1 EQUIPO QUIMICA CLINICA ALTO RENDIMIENTO SOLICITAN ELECTROLITOS SERICOS PAQ DE SOLUCIONES CLORO, SODIO Y POTASIO. PODEMOS OFRECER UN ANALIZADOR AUTOMATIZADO QUE REALICE LA DETERMINACIÓN POR ISE PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ELECTROLITOS EN SANGRE TOTAL, SUERO EN 60 SEG, CON VOLUMEN DE 100UL Y EN ORINA EN 90 SEG. CON 400UL, CON PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO, ALMACENAMIENTO DE 100 RESULTADOS, INTERFAZABLE, LAS SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN Y EL CONTENEDOR DE DESECHOS SE ENCUENTREN DENTRO PAQUETE DESECHABLE ÚNICO, ELECTRODOS LIBRES DE MANTENIMIENTO, CICLOS DE LAVADO Y LIMPIEZA AUTOMÁTICO, MONITOR E IMPRESORA INTEGRADOS, ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA.</b>
<b>16</b>	<b>REFERENCIA PREGUNTA</b>	EN EL ANEXO B1, EQUIPO NO. 9 DE UROANÁLISIS ALTO RENDIMIENTO, DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS, TIPO SOLICITAN ANALIZADOR DE UROANÁLISIS (TIRAS PARA EXAMEN GENERAL DE ORINA) ANALIZADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO. SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCATORIA NOS PERMITA OFERTAR UN ANALIZADOR SEMIAUTOMATIZADO EL CUAL TENGA LA CAPACIDAD DE PROCESAR 500 PRUEBAS POR HORA, SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES, LO QUE A SU VEZ NOS PERMITIRÁ PROPORCIONAR UN PRECIO MÁS ADECUADO ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA.</b>
<b>17</b>	<b>REFERENCIA PREGUNTA</b>	EN EL ANEXO B1, EQUIPO NO. 9 DE UROANÁLISIS ALTO RENDIMIENTO, DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS, METODOLOGÍA SOLICITAN MÉTODO DE LECTURA FOTOMETRICA CON LUZ MONOCROMÁTICA CON LONGITUD DE ONDA 525 Y 635 NM DETERMINACION DE METODO FOTOELECTRICO (COMPARACIÓN DE COLOR); SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO PARA EL ANÁLISIS DE TIRAS REACTIVAS QUE ANALICE LA INTENSIDAD Y EL COLOR DE LA LUZ REFLEJADA DESDE LA TIRAS REACTIVAS A 2 LONGITUDES DE ONDA (525 Y 635NM) NECESARIAS PARA LEER TODOS LOS PARÁMETROS SOLICITADOS EN LA TIRA REACTIVA ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA.</b>
<b>18</b>	<b>REFERENCIA PREGUNTA</b>	EN EL ANEXO B1, EQUIPO NO. 9 DE UROANÁLISIS ALTO RENDIMIENTO DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS, METODOLOGÍA SOLICITAN MÉTODO DE LECTURA FOTOMETRICA CON LUZ MONOCROMÁTICA CON LONGITUD DE ONDA 525 Y 635 NM DETERMINACION DE METODO FOTOELECTRICO (COMPARACIÓN DE COLOR). SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO COMO METODOLOGÍA UN FOTÓMETRO DE REFLECTANCIA A 2 LONGITUDES DE ONDA: 525 Y 635NM, NECESARIAS PARA LEER TODOS LOS PARÁMETROS SOLICITADOS EN LA TIRA REACTIVA ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA.</b>
<b>19</b>	<b>REFERENCIA</b>	EN EL ANEXO B1 EQUIPO NO.11 GASOMETRÍA,

	<b>PREGUNTA</b>	DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS, , RENDIMIENTO SOLICITAN TIEMPO DE PROCESO DE MUESTRA: MENOS DE 2 MINUTOS. SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA ANALIZADOR EL CUAL TENGA UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 2 MINUTOS DEBIDO A QUE EL ANALIZADOR REALIZA SU CONTROL DE CALIDAD DE MANERA AUTOMÁTICA CON 3 SOLUCIONES ESTÁNDARES EN TIEMPO REAL DESPUÉS DE CADA MUESTRA, LO QUE NOS PERMITE VALIDAR CADA RESULTADO ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA.</b>
20	<b>REFERENCIA</b>	EN EL ANEXO B1 EQUIPO NO.11 GASOMETRÍA
	<b>PREGUNTA</b>	DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS, CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO PUNTO 10 SOLICITAN TIEMPO DE PROCESO DE MUESTRA: MENOS DE 2 MINUTOS. SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA ANALIZADOR EL CUAL TENGA UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 2 MINUTOS DEBIDO A QUE EL ANALIZADOR REALIZA SU CONTROL DE CALIDAD DE MANERA AUTOMÁTICA CON 3 SOLUCIONES ESTÁNDARES EN TIEMPO REAL DESPUÉS DE CADA MUESTRA, LO QUE NOS PERMITE VALIDAR CADA RESULTADO ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA</b>
21	<b>REFERENCIA</b>	EN EL ANEXO B1 EQUIPO NO.11 GASOMETRÍA
	<b>PREGUNTA</b>	EN EL ANEXO B1, DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS, EQUIPO NO.11 GASOMETRÍA, CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO PUNTO 19 SOLICITAN TARJETA CON MICROSENSOR DE MEMBRANAS. SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA UN ANALIZADOR EL CUAL REQUIERA DE UN CARTUCHO MULTIPRUEBAS EL CUAL INCLUYA LAS MEMBRANAS, LIBRE DE MANTENIMIENTO SIN LA NECESIDAD DE CAMBIO DE MEMBRANAS ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA.</b>
22	<b>REFERENCIA</b>	EN EL ANEXO B1 EQUIPO NO.11 GASOMETRÍA
	<b>PREGUNTA</b>	EN EL ANEXO B1, DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS, EQUIPO NO.11 GASOMETRÍA, PROCESAMIENTO DE DATOS PUNTO 4 SOLICITAN CON SISTEMA DE INTERFACE BIDIRECCIONAL. DEBEMOS ENTENDER QUE SE NECESITA DE UNA INTERFAZ LIS/DMS PARA LA TRANSMISIÓN DE LOS DATOS DEL PACIENTE, QC Y CALIBRACIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LABORATORIO O DE MANEJO DE DATOS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b>
23	<b>REFERENCIA</b>	EN EL ANEXO B1 EQUIPO NO.13 PARA HEMOGLOBINA GLICOSILADA
	<b>PREGUNTA</b>	DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS, CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO PUNTO 5 SOLICITAN RESULTADOS CUANTITATIVOS SEAN EN TRES MINUTOS DE CUALQUIERA DE LAS PRUEBAS, SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ANALIZADOR QUE EMITA RESULTADOS CUANTITATIVOS DE 3 A 5 MINUTOS DEPENDIENDO DE LA MANIPULACIÓN DEL USUARIO PARA CUALQUIERA DE LAS PRUEBAS ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA.</b>
24	<b>REFERENCIA</b>	EN EL ANEXO B1 EQUIPO NO. 16 PARA MARCADORES CARDIOPULMONARES
	<b>PREGUNTA</b>	DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS, CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO PUNTO 5 SOLICITAN TEMPERATURA CONTROLADA. DEBEMOS ENTENDER QUE EL ANALIZADOR PROPUESTO DEBE TRABAJAR A TEMPERATURA AMBIENTE EN UN RANGO DE ENTRE 15 Y 30 °C Y QUE AL SER SOMETIDO A TEMPERATURAS EXTREMAS SE INHABILITE EL SISTEMA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>ES CORRECTO.</b>
25	<b>REFERENCIA</b>	EN EL ANEXO B1 EQUIPO NO. 16 PARA MARCADORES CARDIOPULMONARES

	<b>PREGUNTA</b>	DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS, CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO PUNTO 8 SOLICITAN CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA ELECTRÓNICA, SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA UN ANALIZADOR EL CUAL REALICE SU AUTOCOMPROBACIÓN DE MANERA AUTOMÁTICA CADA VEZ QUE SE ENCIENDE Y QUE A SU VEZ DEBE DE CONTAR CON UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PARA COMPROBAR CON MÁS DETALLE LA INTEGRIDAD DEL ANALIZADOR Y QUE EN CASO DE RESULTAR DAÑADO O INSATISFACTORIO SE DEBE DE SUSPENDER ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA.</b>
26	<b>REFERENCIA</b>	EN EL ANEXO B1 EQUIPO NO. 16 PARA MARCADORES CARDIOPULMONARES
	<b>PREGUNTA</b>	DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS, CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO PUNTO 5 SOLICITAN TEMPERATURA CONTROLADA. SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR REACTIVO EL CUAL SE ALMACENE A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN ENTRE 2 Y 8 °C, PERO QUE A LA VEZ SEA ESTABLE 14 DÍAS DESPUÉS DE SER EXTRAÍDO DEL REFRIGERADOR SIMPRE Y CUANDO NO SUPERE LA FECHA DE CADUCIDAD ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.</b>
27	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO I – EQUIPO NO. 5 BIOMETRÍA HEMÁTICA MEDIANO RENDIMIENTO
	<b>PREGUNTA</b>	METODOLOGIA: IMPEDANCIA Y CITOQUIMICA. SE PUEDE OFERTAR EQUIPO QUE, TRABAJA CON IMPEDANCIA, FOTOMETRIA PARA LA HEMOGLOBINA, PERO EN LUGAR DE CITOQUIMICA, UTILICE FUENTE DE LECTURA OPTICA (LASER), LO QUE HACE MAS PRECISA LA LECTURA DE LA DIFERENCIAL, ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.</b>
28	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO I – EQUIPO NO.6 COAGULOMETRO ALTO RENDIMIENTO
	<b>PREGUNTA</b>	PUEDEN SER MÁS ESPECÍFICOS A QUE SE REFIERE EN CARACTERISTICAS DEL EQUIPO, PUNTO 1 QUE SEA SISTEMA ABIERTO, FAVOR DE ACLARAR
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE REFIERE HA QUE EL EQUIPO PUEDE PROCESAR DIFERENTES REACTIVOS.</b>
29	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO 1 CONTROLES DE CALIDAD PAGINA 26
	<b>PREGUNTA</b>	CUANDO EL PROVEEDOR, NO PROPORCIONE LOS CONTROLES DE TERCERA OPINION, CONTROLES DE PRIMERA OPINION CUANDO NO EXISTAN EN EL MERCADO DE TERCERA OPINION, CONTROLES EXTERNOS CON RECONOCIMIENTO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL. EN EL CASO DEL PAQUETE DE QUÍMICA CLÍNICA SE PUEDE ENTREGAR CONTROLES DE LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO QUE YA HAYAN SIDO RESPALDADOS POR EL FABRICANTE APARTE DE UN CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE RECONOCIMIENTO NACIONAL, SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA.</b>
30	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO 1 CONTROLES DE CALIDAD PAGINA 26
	<b>PREGUNTA</b>	CUANDO EL SISTEMA DE CALIDAD NO CUENTE CON UN SOFTWARE ADMINISTRADOR DE DATOS QUE MUESTRE GRAFICAS DE LEVEY JENNINGS, YAUDEN, HISTOGRAMAS Y REGLAS DE WESTGARD, QUE APLIQUEN VARIABILIDAD BIOLÓGICA, ERROR TOTAL E INCERTIDUMBRE, O CUANDO NO PROPORCIONE INFORMES MENSUALES DE COMPARACION INTERLABORATORIO CON INFORMES EN LINEA QUE PERMITA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE CADA UNA DE LAS PRUEBAS PARTICIPANTES HASTA LA TERMINACION DEL CONTRATO, ESTOS DATOS SOLICITADOS SON REFERENTES AL CONTROL DE CALIDAD EXTERNO. FAVOR DE ACLARAR.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE REFIERE AL CONTROL DE CALIDAD EXTERNO.</b>
31	<b>REFERENCIA</b>	EQUIPO NO.1 QUÍMICA CLÍNICA ALTO RENDIMIENTO

	<b>PREGUNTA</b>	METODOLOGIA. CON AREA REFRIGERADA PARA LA COLOCACION DE CONTROLES Y CALIBRADORES, SE PUEDE OFERTAR UN EQUIPO EN DONDE LAS ÁREAS ESTÉN TOTALMENTE PROTEGIDAS DE LA LUZ PARA EVITAR OXIDACIÓN DE LOS CONTROLES Y/O CALIBRADORES DURANTE EL TIEMPO QUE SE USAN PARA DICHO FIN Y POR LO CUAL NO REQUIERE DE REFRIGERACIÓN, SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA.</b>
32	<b>REFERENCIA</b>	EQUIPO NO.1 QUÍMICA CLÍNICA ALTO RENDIMIENTO
	<b>PREGUNTA</b>	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO USO DE TUBO PRIMARIO DE DIFERENTE TAMAÑO MICROCPAS DE DIFERENTE TAMAÑO. CON GRADILLA QUE ACEPTE TODO TIPO DE TUBO, INCLUYENDO MICROCPAS. SE PUEDE OFERTAR UN EQUIPO QUE PUEDA CENSAR VOLÚMENES PEQUEÑOS DE MUESTRA Y QUE TAMBIÉN INCLUYA VÍA SOFTWARE LA OPCIÓN DE VOLUMEN REDUCIDO DE MUESTRA Y QUE POR LO TANTO NO REQUIERA DE MICROCPAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.</b>
33	<b>REFERENCIA</b>	EQUIPO NO.1 QUÍMICA CLÍNICA ALTO RENDIMIENTO PUNTO 15
	<b>PREGUNTA</b>	DICE: QUE LOS REACTIVOS, CONTROLES Y CONSUMIBLES QUE SE ENTREGUEN SEAN DEL MISMO LOTE, POR LO MENOS DURANTE 1 AÑO, LOS CONTROLES DEBEN SER A TRES NIVELES DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO. SE PUEDE OFRECER UN EQUIPO QUE CUENTE CON UN NIVEL DE CONTROL PATOLOGICO Y OTRO NIVEL NORMAL SUFICIENTE PARA CUBRIR LA VALORACION DE LAS MUESTRAS DEL LABORATORIO ADEMÁS DE QUE ESTOS SON VALORADOS POR EL FABRICANTE Y SON DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO A OFERTAR, SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.</b>
34	<b>REFERENCIA</b>	EQUIPO NO.1 QUÍMICA CLÍNICA ALTO RENDIMIENTO PUNTO 15
	<b>PREGUNTA</b>	DICE QUE LOS REACTIVOS, CONTROLES Y CONSUMIBLES QUE SE ENTREGUEN SEAN DEL MISMO LOTE, POR LO MENOS DURANTE 1 AÑO, LOS CONTROLES DEBEN SER A TRES NIVELES DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO. SE PUEDE OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON DOS NIVELES DE CONTROLES DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO Y EN CASO DE REQUERIR UN TERCER NIVEL PODERLO TRABAJARLO CON OTRA MARCA, SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.</b>
35	<b>REFERENCIA</b>	EQUIPO NO.2 QUÍMICA CLÍNICA MEDIANO RENDIMIENTO
	<b>PREGUNTA</b>	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO.3.- CON 98 REACTIVOS A BORDDO REFRIGERADOS, SE PUEDE OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON 96 POSICIONES DE REACTIVO REFRIGERADAS, SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS PRUEBAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.</b>
36	<b>REFERENCIA</b>	EQUIPO NO.2 QUÍMICA CLÍNICA MEDIANO RENDIMIENTO PUNTO 16
	<b>PREGUNTA</b>	CELDAS DE REACCIÓN PYREX SEMIDESECHABLES, SE PUEDE OFRECER UN EQUIPO DONDE LAS CELDAS DE REACCIÓN SEAN DE VIDRIO PYREX Y QUE SOLO AL SER VALORADAS POR EL INGENIERO SE REALIZARA EL CAMBIO DE LAS MISMAS, ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE.</b>
37	<b>REFERENCIA</b>	EQUIPO NO.2 QUÍMICA CLÍNICA MEDIANO RENDIMIENTO PUNTO 17
	<b>PREGUNTA</b>	SE PUEDE TRABAJAR DE FORMA ENTREMEZCLADA MUESTRAS EN TUBO PRIMARIO, COPA Y COPILLA. SE PUEDE OFRECER UN EQUIPO QUE TRABAJA DE FORMA ENTREMEZCLADA MUESTRAS EN COPAS Y TUBO PRIMARIO YA QUE NO REQUIERE DE OTRO TIPO DE COPA POR EL SENSOR DE VOLUMEN EN MUESTRAS, ¿SE ACEPTA?

	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE.</b>
<b>38</b>	<b>REFERENCIA PREGUNTA</b>	EQUIPO NO.2 QUÍMICA CLÍNICA MEDIANO RENDIMIENTO PUNTO 18 CUENTA CON SISTEMA PARA DESIONIZAR AGUA.EL EQUIPO CUENTA CON UN SISTEMA, SE PUEDE OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE DE MANERA ADICIONAL UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA SIN COSTO PARA EL LICITANTE?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA. EL EQUIPO DEBE CONTAR CON UN SISTEMA INTEGRADO PARA DESIONIZAR EL AGUA.</b>
<b>39</b>	<b>REFERENCIA PREGUNTA</b>	EQUIPO NO.2 QUÍMICA CLÍNICA MEDIANO RENDIMIENTO PUNTO 19 EN POSICIÓN DE REPOSO (STANDBY) NO CONSUME REACTIVOS NI AGUA U OTRAS SUBSTANCIAS. SE PUEDE OFERTAR UN EQUIPO EL CUAL PUEDA CONFIGURARSE PARA QUE DE FORMA AUTOMÁTICA PUEDA HACER LA CALIBRACIÓN DE ISE Y POR LO TANTO HAGA USO DE SUS SOLUCIONES PARA REALIZAR ESTE FIN, ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.</b>
<b>40</b>	<b>REFERENCIA PREGUNTA</b>	EQUIPO NO.2 QUÍMICA CLÍNICA MEDIANO RENDIMIENTO PUNTO 20 CON PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO Y PROGRAMABLE. SE PUEDE OFERTAR UN EQUIPO CON MANTENIMIENTO DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO Y QUE EL USUARIO AVISE VÍA SOFTWARE EL INICIO DEL MANTENIMIENTO DE APAGADO ¿ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA. EL ENCENDIO Y APAGADO DEL EQUIPO DEBE SER PROGRAMABLE POR EL USUARIO.</b>
<b>41</b>	<b>REFERENCIA PREGUNTA</b>	ANEXO TÉCNICO NO.1 DE LA PARTIDA 93 SOLICITAMOS A LA OFERTANTE NOS PERMITA OFERTAR LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES PARA PRUEBA RÁPIDA CON PRINCIPIO DE INMUNOCROMATOGRAFIA PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VHI 1 Y 2 LA CUAL OBTENGA SU RESULTADO EN 15 MINUTOS, CONTIENE UNA MEZCLA DE SELENIO Y ANTÍGENOS, REQUIERE UNA ALÍCUOTA DE 50 µL DE SANGRE TOTAL, SUERO O PLASMA. PRESENTACIÓN DE 100 PRUEBAS. SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DEL 100%. CUENTA CON VALIDACIÓN DE INDRE INCLUYE: LANCETAS, PIPETAS DESECHABLES Y UN BUFFER POR CADA 100 PRUEBAS EN CASO QUE SE DESEE TRABAJAR CON SANGRE TOTAL. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>LA PARTIDA 93 SE REFIERE A CULTIVOS DE MICROBIOLOGIA</b>
<b>42</b>	<b>REFERENCIA PREGUNTA</b>	ANEXO TÉCNICO NO.1 DE LA PARTIDA 123 SOLICITAMOS A LA OFERTANTE NOS PERMITA OFERTAR LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES PARA PRUEBA RÁPIDA CON PRINCIPIO DE INMUNOCROMATOGRAFIA PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VHI 1 Y 2 LA CUAL OBTENGA SU RESULTADO EN 15 MINUTOS, CONTIENE UNA MEZCLA DE SELENIO Y ANTÍGENOS, REQUIERE UNA ALÍCUOTA DE 50 µL DE SANGRE TOTAL, SUERO O PLASMA. PRESENTACIÓN DE 100 PRUEBAS. SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DEL 100%. CUENTA CON VALIDACIÓN DE INDRE INCLUYE: LANCETAS, PIPETAS DESECHABLES Y UN BUFFER POR CADA 100 PRUEBAS EN CASO QUE SE DESEE TRABAJAR CON SANGRE TOTAL. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA.</b>
<b>43</b>	<b>REFERENCIA PREGUNTA</b>	ANEXO TÉCNICO 1 DE LA PARTIDA 124 SOLICITAMOS A LA OFERTANTE NOS PERMITA OFERTAR LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES PARA PRUEBA RÁPIDA CON PRINCIPIO DE INMUNOCROMATOGRAFIA PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPO CONTRA SÍFILIS LA CUAL OBTENGA SU RESULTADO EN 15 MINUTOS, CONTIENE UNA MEZCLA DE SELENIO Y ANTÍGENOS, REQUIERE UNA ALÍCUOTA DE 50 µL DE SANGRE TOTAL, SUERO O PLASMA. PRESENTACIÓN DE 100 PRUEBAS.

		SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DEL 100%. CUENTA CON VALIDACIÓN DE INDRE INCLUYE: LANCETAS, PIPETAS DESECHABLES Y UN BUFFER POR CADA 100 PRUEBAS EN CASO QUE SE DESEE TRABAJAR CON SANGRE TOTAL. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA.</b>
<b>44</b>	<b>REFERENCIA PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS AL OFERTANTE NOS PERMITA OFERTAR PRUEBAS MENORES A DOCE MESES DE CADUCIDAD O EN SU DEFECTO REALIZAR ENTREGAR PROGRAMADAS PARA EVITAR QUE SE CADUQUEN LOS REACTIVOS. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>REFERIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NO. 9</b>
<b>45</b>	<b>REFERENCIA PREGUNTA</b>	ANEXO 1, PÁRRAFO 7 PAGINA 24 "LUGAR Y FORMA DE ENTREGA. PARA LOS PRODUCTOS, SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL DE LABORATORIO SE REQUIERE LA ENTREGA DE MISMOS, EN LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES MEDICAS DETALLADAS EN LOS ANEXOS RESPECTIVOS DE ESTAS BASES; CONFORME A LOS INVENTARIOS EN CADA UNIDAD MEDICA, CON UN HORARIO DE 9:00 A 13:00 HORAS EN DIAS HABILES, NO SERA ACEPTADA CONDICION ALGUNA EN CUANTO A CARGOS ADICIONALES POR CONCEPTO DE FLETES O MANIOBRA DE CARGA O DESCARGA, SEGUROS U OTROS. EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SERA NO MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS HABILES A PARTIR DEL CORTE MENSUAL DE PRUEBAS QUE REALICE EL PROVEEDOR EN CADA UNIDAD MEDICA; PARA REACTIVOS DE IMPORTACION CONTARAN CON CUARENTA Y CINCO DIAS" POR LO QUE SE ENTIENDE QUE LOS REACTIVOS IMPORTADOS TENDRÁN HASTA 45 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE PARA SUMINISTRO DEL MATERIAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>EL PLAZO DE ENTREGA DE TODOS LOS INSUMOS ES NO MAYOR A 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL CORTE MENSUAL REALIZADO POR EL PROVEEDOR.</b>
<b>46</b>	<b>REFERENCIA PREGUNTA</b>	ANEXO 1 LA RED DE DATOS QUE SOLICITAN PARA INTERCONECTAR LAS UNIDADES, PUEDE SER CUALQUIER TECNOLOGÍA (INTERNET EMPRESARIAL, MPLS, ETC)?, YA QUE DADO EL PERIODO LICITADO, HAY TECNOLOGÍAS QUE PUEDEN TORNAR UN PAR DE MESES EN INSTALARSE.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA.</b>
<b>47</b>	<b>REFERENCIA PREGUNTA</b>	ANEXO 1 PUEDEN POR FAVOR ANEXAR LA TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE HARDWARE SOLICITADA.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>ESTA INFORMACIÓN SE ENTREGARÁ AL LICITANTE ADJUDICADO.</b>
<b>48</b>	<b>REFERENCIA PREGUNTA</b>	ANEXO 1 SE ESTÁ CONTEMPLANDO QUE CADA UNIDAD OPERE CON SU PROPIO SERVIDOR DE DATOS, O BIEN QUE TODA LA RED HOSPITALARIA OPERE BAJO UN ÚNICO SERVIDOR DE DATOS?, LO CUAL SERÍA DE MUCHO VALOR AL PROYECTO.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE SOLICITA QUE CADA UNIDAD OPERE CON SU PROPIO SERVIDOR DE DATOS.</b>
<b>49</b>	<b>REFERENCIA PREGUNTA</b>	ANEXO 1 LOS NODOS DE RED DE CADA UNIDAD NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DEL LIS, SERA PROVISTOS POR SSA O POR EL PROVEEDOR GANADOR.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>POR EL PROVEEDOR GANADOR INSTALARÁ LOS NODOS EN CADA UNIDAD.</b>
<b>50</b>	<b>REFERENCIA PREGUNTA</b>	ANEXO 1 QUIEN SERÁ EL PROVEEDOR DE LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA LA

		OPERACIÓN DEL LIS (PAPEL, ETIQUETAS, TÓNER), SSA O EL PROVEEDOR GANADOR?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>EL PROVEEDOR GANADOR SERÁ EL RESPONSABLE DE ENTREGAR LO NECESARIO.</b>
<b>51</b>	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO 1 PARTIDA 47
	<b>PREGUNTA</b>	CONSIDERANDO LA CANTIDAD DE PRUEBAS SOLICITADAS EN LA PARTIDA NO. 47 DEL ANEXO 1, ¿SE PERMITIRIA REALIZAR LA PRUEBA DE RETICULOCITOS DE MANERA MANUAL CONSIDERANDO QUE EL TIEMPO DE REALIZACION DE LA MISMA ES MUY CORTO?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.</b>
<b>52</b>	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO 1 PARTIDA 84, 85,86 ,87, 88, 89, 90 Y 91
	<b>PREGUNTA</b>	CONSIDERANDO QUE LA CANTIDAD DE PRUEBAS SOLICITADAS EN LAS PARTIDAS 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 Y 91 ES BAJA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PUEDAN SUBROGAR ESTAS PARTIDAS ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA.</b>
<b>53</b>	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO B-1 EQUIPO NO. 12 INMUNOLOGIA Y MARCADORES TUMORALES
	<b>PREGUNTA</b>	DE ACUERDO A LA PRODUCTIVIDAD ¿PODEMOS OFERTAR UN INSTRUMENTO QUE REALIZA 100 PBAS/HR?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA.</b>
<b>54</b>	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO B-1 EQUIPO NO. 12 INMUNOLOGIA Y MARCADORES TUMORALES
	<b>PREGUNTA</b>	DE ACUERDO A LAS PRUEBAS QUE SOLICITA ¿PODEMOS OFERTAR EQUIPO QUE MANEJA 24 REACTIVOS A BORDO Y QUE NO CAUSARIA DIFERENCIA ALGUNA DURANTE EL PROCESO DE MUESTRAS?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA.</b>
<b>55</b>	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO B-1 EQUIPO NO. 12 INMUNOLOGIA Y MARCADORES TUMORALES
	<b>PREGUNTA</b>	¿PODEMOS OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD DE 60 MUESTRAS A BORDO?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA.</b>
<b>56</b>	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO B-1 EQUIPO NO. 12 INMUNOLOGIA Y MARCADORES TUMORALES
	<b>PREGUNTA</b>	¿PODEMOS OFERTAR EQUIPO QUE DURANTE 3HRS EL OPERARIO NO NECESITA REALIZAR CARGA DE INSUMOS Y CONSUMIBLES PARA SU OPERACIÓN?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA.</b>
<b>57</b>	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO B-1 EQUIPO NO. 12 INMUNOLOGIA Y MARCADORES TUMORALES
	<b>PREGUNTA</b>	DE ACUERDO A LO SOLICITADO ¿PODEMOS OFERTAR EQUIPO QUE NO REQUIERE SISTEMAS DE TANQUES Y CONEXIÓN COMPLETA DE PRE Y POST FILTRACION, QUE ADEMAS NO OCUPA MAYOR ESPACIO DEL CONTEMPLADO Y QUE EVITA PARAR EL PROCESO DE TRABAJO CUANDO EL AGUA SEA INSUFICIENTE?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.</b>
<b>58</b>	<b>REFERENCIA</b>	EQUIPO 1 SEROLOGÍA (LABORATORIO) PÁG. 31
	<b>PREGUNTA</b>	METODOLOGÍA ENSAYO INMUNOENZIMATICO O POR QUIMIOLUMINISCENCIA PARA LA DETECCION SIMULTANEA DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (ANTI-VIH 1/VIH 2 INCLUYENDO GRUPO O) Y EL ANTÍGENO P24 DEL HIV, EN SUERO O PLASMA HUMANO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UNA PRUEBA POR INMUNOENSAYO QUIMIOLUMINISCENTE PARA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS FRENTE A HIV-1 Y HIV-2 EN SUERO O PLASMA HUMANO QUE CUENTA CON EL 99.6% DE ESPECIFICIDAD Y 100% DE

A

		SENSIBILIDAD; SE ACEPTA
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA.</b>
<b>59</b>	<b>REFERENCIA</b>	EQUIPO 1 SEROLOGIA (LABORATORIO) PAG 31
	<b>PREGUNTA</b>	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO: CAPACIDAD DE 64 MUESTRAS ABORDO FUNCIÓN STAT SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTE EQUIPO CON CAPACIDAD DE HASTA 30 MUESTRAS A BORDO DE CARGA CONTINUA POR LOTES O ALEATORIO CON CAPACIDAD DE PRIORIZAR CUALQUIER MUESTRA COMO STAT (URGENTE), EN CUALQUIER MOMENTO
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA.</b>
<b>60</b>	<b>REFERENCIA</b>	EQUIPO II SEROLOGIA (BANCO DE SANGRE) PAG 62
	<b>PREGUNTA</b>	REFERENCIANDO LICITACIÓN PÚBLICA GET-LPN-061/2015 ANEXO 1/ANEXO A PARTIDA 9,10,11,12,13,14,15,16,17. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTE QUE SE PUEDAN SUBROGAR LAS PARTIDAS 9,10,11,12,13,14,15,16 Y 17, POR LA BAJA CANTIDAD DE PRUEBAS A REALIZAR ¿ SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA.</b>
<b>61</b>	<b>REFERENCIA</b>	
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS A LA OFERTANTE NOS PERMITA OFERTAR LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES PARA EL ANEXO TÉCNICO NO.1 DE LA PARTIDA 93: PRUEBA RÁPIDA CON PRINCIPIO DE INMUNOCROMATOGRFIA PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VHI 1 Y 2 LA CUAL OBTENGA SU RESULTADO EN 15 MINUTOS, CONTIENE UNA MEZCLA DE SELENIO Y ANTÍGENOS, REQUIERE UNA ALÍCUOTA DE 50 µL DE SANGRE TOTAL, SUERO O PLASMA. PRESENTACIÓN DE 100 PRUEBAS. SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DEL 100%. CUENTA CON VALIDACIÓN DE INDRE INCLUYE: LANCETAS, PIPETAS DESECHABLES Y UN BUFFER POR CADA 100 PRUEBAS EN CASO QUE SE DESEE TRABAJAR CON SANGRE TOTAL. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>LA PARTIDA 93 SE REFIERE A CULTIVOS DE MICROBIOLOGIA.</b>
<b>62</b>	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO TÉCNICO NO.1 DE LA PARTIDA 93
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS A LA OFERTANTE NOS PERMITA OFERTAR LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES PARA EL: PRUEBA RÁPIDA CON PRINCIPIO DE INMUNOCROMATOGRFIA PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VHI 1 Y 2 LA CUAL OBTENGA SU RESULTADO EN 15 MINUTOS, CONTIENE UNA MEZCLA DE SELENIO Y ANTÍGENOS, REQUIERE UNA ALÍCUOTA DE 50 µL DE SANGRE TOTAL, SUERO O PLASMA. PRESENTACIÓN DE 100 PRUEBAS. SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DEL 100%. CUENTA CON VALIDACIÓN DE INDRE INCLUYE: LANCETAS, PIPETAS DESECHABLES Y UN BUFFER POR CADA 100 PRUEBAS EN CASO QUE SE DESEE TRABAJAR CON SANGRE TOTAL. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>LA PARTIDA 93 SE REFIERE A CULTIVOS DE MICROBIOLOGIA.</b>

**DISTRIBUCIONES DAIS, S.A. DE C.V.**

<b>63</b>	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO B-1, ANEXO C REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA, CETS DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS SUS CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS ... PAGINA 28 SOLICITAN: BOLSA CUÁDRUPLE TOP AN BOTTOM CPD/ADSOL BOLSA PARA FRACCIONAR SANGRE CUÁDRUPLE TIPO TOP AND BOTTOM ...
	<b>PREGUNTA</b>	1.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA PARA FRACCIONAR SANGRE CUÁDRUPLE TIPO TOP AND BOTTOM: CONTIENE UNA BOLSA PRIMARIA DE 450 ML CON 63 ML DE

		SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE CPD CON SALIDA POR ARRIBA Y POR ABAJO CONECTADA A UN TUBO COLECTOR INTEGRAL CON AGUJA 16 G CON PUNTA DE TRIPLE BISELADO Y DISEÑO DE PARED ULTRA DELGADA Y CON PROTECTOR DE AGUJA, BOLSA DE DIVERSIFICACIÓN Y CON SISTEMA DE SEGURIDAD PARA TOMA DE MUESTRA, UNIDA A UN SISTEMA SECUNDARIO FORMADO POR DOS BOLSAS SATÉLITES VACÍA DE 400 ML AMBAS BOLSAS PARA ALMACENAR PLAQUETAS POR 5 DÍAS Y OTRA DE 450 ML CON 100 ML DE SOLUCIÓN ADITIVA (OPTISOL) QUE PROPORCIONE COMO MÍNIMO 42 DÍAS DE VIGENCIA AL CONCENTRADO ERITROCITARIO; COMPATIBLE CON SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE LEUCOCITOS EN 1 O MÁS LOGARITMOS. YA QUE LA BOLSA SOLICITADA DESCRIBE A UNA MARCA COMERCIAL Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES</b>
64	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO B-1, ANEXO C REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA, CETS DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS SUS CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS ... PAGINA 28 SOLICITAN: BOLSA TRIPLE TOP AN BOTTOM CPD/ADSOL BOLSA PARA FRACCIONAR SANGRE TRIPLE TIPO TOP AND BOTTOM ...  ANEXO B-1, ANEXO C REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA, CETS DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS SUS CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS ... PAGINA 28 SOLICITAN: BOLSA TRIPLE TOP AN BOTTOM CPD/ADSOL BOLSA PARA FRACCIONAR SANGRE TRIPLE TIPO TOP AND BOTTOM ...
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA PARA FRACCIONAR SANGRE TRIPLE TIPO TOP AND BOTTOM: CONTIENE UNA BOLSA PRIMARIA DE 450 ML CON 63 ML DE SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE CPD CON SALIDA POR ARRIBA Y POR ABAJO CONECTADA A UN TUBO COLECTOR INTEGRAL CON AGUJA 16 G CON PUNTA DE TRIPLE BISELADO Y DISEÑO DE PARED ULTRA DELGADA Y CON PROTECTOR DE AGUJA, BOLSA DE DIVERSIFICACIÓN Y CON SISTEMA DE SEGURIDAD PARA TOMA DE MUESTRA, UNIDA A UN SISTEMA SECUNDARIO FORMADO POR UNA BOLSA SATÉLITE VACÍA DE 400 ML Y OTRA DE 450 ML CON 100 ML DE SOLUCIÓN ADITIVA (OPTISOL) QUE PROPORCIONE COMO MÍNIMO 42 DÍAS DE VIGENCIA AL CONCENTRADO ERITROCITARIO; COMPATIBLE CON SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE LEUCOCITOS EN 1 O MÁS LOGARITMOS. YA QUE LA BOLSA SOLICITADA DESCRIBE A UNA MARCA COMERCIAL Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES.</b>
65	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO B-1, ANEXO C REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA, CETS DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS SUS CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS... PAGINA 28 SOLICITAN: BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA TRANSFERENCIA CON CAPACIDAD DE 150ML PAQUETE CON 12 UNIDADES.
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS AMABLEMENTE ALA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA DE TRANSFERENCIA DE 150 ML EN EMPAQUE INDIVIDUAL PARA GARANTIZAR LA ESTERILIDAD EN PRESENTACIÓN CAJA CON 25 PIEZAS
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO DEBIENDO HACER EL AJUSTE CORRESPONDIENTE A LAS CANTIDADES SOLICITADAS.</b>
66	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO B-1, ANEXO C REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO

		INTEGRAL DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA, CETS DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS SUS CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS... PAGINA 28 SOLICITAN: BOLSA SIMPLE BOLSA SENCILLA CON CAPACIDAD DE 450 ML PARA OBTENCIÓN DE SANGRE TOTAL Y / O SANGRE TERAPÉUTICA PLÁSTICO PL146...
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA SENCILLA PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE CPDA-1, DE USO ÚNICO, VOLUMEN DE RECOLECCIÓN DE 450ML CON 63 ML CPDA-1, CON AGUJA 16G CON PUNTA DE TRIPLE BISELADO Y DISEÑO DE PARED ULTRA DELGADA. YA QUE LA BOLSA SOLICITADA DESCRIBE A UNA MARCA COMERCIAL Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.</b>
67	<b>REFERENCIA</b>	EN ANEXO 1 PARTIDA NO. 112 PRUEBA REAL, CANTIDAD 7800 SANGRE TOTAL SEGURA PROCESADA...
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿CUÁNTAS BOLSAS PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE TRIPLE SE UTILIZARÁ EN ESTA PARTIDA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>APROXIMADAMENTE EL 30 %.</b>
68	<b>REFERENCIA</b>	EN ANEXO 1 PARTIDA NO. 112 PRUEBA REAL, CANTIDAD 7800 SANGRE TOTAL SEGURA PROCESADA...
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿CUÁNTAS BOLSAS PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CUÁDRUPLE SE UTILIZARÁ EN ESTA PARTIDA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>APROXIMADAMENTE EL 70 %.</b>
69	<b>REFERENCIA</b>	EN EL ANEXO C-1 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS EQUIPO NO.5 EQUIPO DE AFÉRESIS.
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: SISTEMA AUTOMATIZADO DE AFÉRESIS QUE PERMITE LA COLECCIÓN DE PLAQUETAS, PLASMA, CONCENTRADO ERITROCITARIO O DOBLE CONCENTRADO ERITROCITARIO LEUCODEPLETADO CON <1x106 LEUCOCITOS EN UNA SOLA PLATAFORMA, FLUJO CONTINUO UNIPUNCIÓN, SOFTWARE EN ESPAÑOL. CONSTA DE 5 BOMBAS (EXTRACCIÓN, RETORNO, ACD, PLAQUETAS Y PLASMA), SENSOR DE NIVEL DE RESERVORIO, DETECTOR DE ACD Y DETECTOR GLÓBULOS ROJOS, SENSOR DE PRESIÓN DE CENTRÍFUGA Y SENSOR DE HUMEDAD, UN PORTACASETE QUE INCORPORA DE MANERA INTEGRADA LOS CABEZALES DE LAS BOMBAS DE CARGA AUTOMÁTICA, FILTROS, DIAFRAGMAS DE PRESIÓN, SENSORES Y DEPÓSITO DE RETORNO; ADEMÁS ES LA INTERFASE DE HARDWARE PARA LOS SENSORES, VÁLVULAS Y DETECTOR DE GLÓBULOS ROJOS. CONTROL AUTOMATIZADO DE ANTICOAGULANTE. TIENE UNA PANTALLA TÁCTIL (TOUCH SCREEN) A COLOR EN IDIOMA ESPAÑOL Y PERMITE LA COLECCIÓN DE LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS FUERA DE LA CENTRÍFUGA DIRECTAMENTE EN LA BOLSA DE ALMACENAMIENTO SIN NECESIDAD DE TRASVASE MANUAL, SISTEMA DE FLUJO CONTINUO Y CERRADO, IDIOMA EN ESPAÑOL, SOFTWARE ESCALABLE, PESO LIGERO DE 84 KG. CON SELLADOR DIELECTRICO INTEGRADO MENSAJES DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ANTE SITUACIÓN DE ALERTA Y CUENTA CON SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL DONANTE. CON UN VOLUMEN EXTRACOPOREO BAJO DE 196 ML. YA QUE EL EQUIPO SOLICITADO DESCRIBE A UNA MARCA COMERCIAL Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES.</b>
70	<b>REFERENCIA</b>	EN EL ANEXO C-1 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS EQUIPO NO.6 SELLADOR

	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: SELLADOR DIELECTRICO PORTÁTIL DISEÑANDO PARA HACER SELLOS HERMÉTICOS CON PRECORTE PARA SEPARAR FÁCILMENTE LAS BOLSAS DE SANGRE SIN CONTAMINACIÓN ALGUNA, SELLA TUBOS DE 5 MM EN 1.5 SEGUNDOS CONTROLADO POR EL MICRO-CONTROLADOR, PRESENTA UNA PISTOLA SELLADORA ERGONÓMICAMENTE DISEÑADA QUE LE DA COMODIDAD AL USUARIO, CON INDICADOR DE SELLADO Y DISEÑADA DE TAL FORMA QUE MINIMIZA LA FUERZA REQUERIDA Y ASEGURA UN MEJORA AGARRE Y SELLOS CONSISTENTES. LA GUARDA ANTISALPICADURA FÁCIL DE QUITAR PROPORCIÓN SEGURIDAD; NO REQUIERE CALENTAMIENTO, LA BATERÍA NH NI QUEDA COMPLETAMENTE CARGADA EN UN MÁXIMO DE TRES HORAS PARA REALIZAR MÁS 1000 SELLOS DE ALTA CALIDAD (TOTALMENTE CARGADA 1500 SELLOS), PROTECCIÓN TÉRMICA ADICIONAL PARA LA BATERÍA CON INDICADOR DE CARGA, PESO: ALIMENTACIÓN BASE 2000 GMS, CABEZA SELLADORA 230 GMS, DIMENSIÓN DE FUENTE DE PODER: 160MMX250MMX40MM
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO.</b>
71	<b>REFERENCIA</b>	EN EL ANEXO C-1 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS EQUIPO NO.7 MEZCLADOR
	<b>PREGUNTA</b>	9.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: RECOLECTOR AUTOMÁTICO DE SANGRE CON MOVIMIENTO OSCILATORIO CONTINUO CON CHAROLA MAGNÉTICA PARA COLOCAR BOLSA DE SANGRE DE CUALQUIER CONFIGURACIÓN CON O SIN SOLUCIÓN ADITIVA, CLAMP OBTURADOR DE PASO EN POSICIÓN CENTRAL CON DETECTOR DE CORRECTA COLOCACIÓN DE LÍNEA, CON PANTALLA LCD ( TOUCH SCREEN) ILUMINADA A COLOR SENSIBLE AL TACTO EN IDIOMA ESPAÑOL PARA FACILITAR LA TRANSFERENCIA DE DATOS, TIEMPO DE DONACIÓN, FLUJO Y VOLUMEN RECOLECTADO, ALARMAS AUDIBLES Y LED INDICADOR, CON SISTEMA DE CONVERSIÓN DE PESO A VOLUMEN. CON AUTO-CHEQUEO ANTES DE CADA DONACIÓN, ALARMAS DE SEGURIDAD PROGRAMABLES DE FLUJO, RETRASO EN VENOPUNCIÓN Y AVISO AUDIBLE AL TÉRMINO DE LA FLEBOTOMÍA, CON BATERÍA INCLUIDA.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES.</b>
72	<b>REFERENCIA</b>	EN EL ANEXO C-1 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS EQUIPO NO.8 FRACCIONADOR
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: EXTRACTOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS ALTAMENTE FLEXIBLE PARA EL PROCESAMIENTO ESTANDARIZADO DE SANGRE. EL DISPOSITIVO ESTÁ DISEÑADO PARA UTILIZARSE CON TODOS LOS SISTEMAS COMUNES DE BOLSAS, TANTO EL TIPO TAB ("TOP-AND-BOTTOM, CON SALIDA SUPERIOR E INFERIOR) COMO EL TIPO CONVENCIONAL TAT (CON DOS SALIDAS SUPERIORES), CON O SIN FILTROS INCORPORADOS. PRESENTA PANTALLA GRÁFICA A COLOR NÍTIDA INDICADORA DE TÉCNICA DE FRACCIONAMIENTO PARA SEGUIR FÁCILMENTE CADA PASO DEL PROCESO DE SEPARACIÓN, CON SOFTWARE EN ESPAÑOL, CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS BALANZAS, LOS DETECTORES Y LA POSICIÓN DE Prensado, Prensa con ángulo superior para evitar contaminación por glóbulos rojos, EQUIPADA CON UN DETECTOR DE POSICIÓN PARA OFRECER ALTA ESTABILIDAD DURANTE LA EXTRACCIÓN, CON MICROPROCESADOR ELECTRÓNICO DE PROCESOS QUE SUPERVISA Y MIDE CONTINUAMENTE EL FLUJO Y PESO DE TODOS LOS HEMOCOMPONENTES, SOPORTE TELESCÓPICO PARA BOLSAS CON DISEÑO ERGONÓMICO, 5 SELLADORES DE ALTA FRECUENCIA AUTOMÁTICOS CON PRECORTE ( NO REQUIERE TIJERAS PARA SEPARAR LA TUBERÍA), 5 OBTURADORES DE PASO AUTOMÁTICO, 1 MOTOR REGULADOR DE FLUJO, AJUSTE AUTOMÁTICO EN EL DIÁMETRO DE LA

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*

		BOLSAS, 10 DETECTORES ÓPTICOS Y 2 DETECTORES DE PRESIÓN, 3 BALANZAS PARA LA MEDICIÓN DEL PESO DEL PLASMA, BUFFY COAT Y SOLUCIÓN ADITIVA, REGULACIÓN DEL AIRE COMPRIMIDO PARA PRESIÓN CONSTANTE, CON 11 PROGRAMAS PARA TODO TIPO DE FRACCIONAMIENTO Y TIPO DE BOLSA UTILIZADA, LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS, INTERFASABLE CON SISTEMA OPERATIVO DE GESTIÓN DE DATOS TOMES. YA QUE EL EQUIPO SOLICITADO DESCRIBE A UNA MARCA COMERCIAL Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES</b>
73	<b>REFERENCIA</b>	EN EL INCISO I. "ADEMÁS DEBERÁ INCLUIR EN LA PROPUESTA LOS SIGUIENTES COMPONENTES": PÁGINA 66 SOLICITAN LA CANTIDAD DE 4 FRACCIONADOR AUTOMATIZADO PARA HEMOCOMPONENTES
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA COLOCAR LA CANTIDAD NECESARIA DE SISTEMAS FRACCIONADORES DE ACUERDO AL RENDIMIENTO DE CADA EQUIPO Y A LAS NECESIDADES DEL CETS.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES</b>
74	<b>REFERENCIA</b>	EN EL INCISO I. "ADEMÁS DEBERÁ INCLUIR EN LA PROPUESTA LOS SIGUIENTES COMPONENTES": PÁGINA 66 SOLICITAN 1 CONECTOR DE TUBERÍA ESTÉRIL.
	<b>PREGUNTA</b>	12.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL CONECTOR DE TUBERÍA ESTÉRIL QUE SOLICITAN DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: EQUIPO PARA REALIZAR CONEXIONES DE TUBERÍA DE PVC EN CONDICIONES DE ESTERILIDAD DE SEGUNDA GENERACIÓN. CON PANTALLA LCD QUE PROPORCIONA INFORMACIÓN DEL EQUIPO Y SUGERENCIA DE OPERACIÓN COMO: CAMBIO DE LÁMINA O NAVAJA, TOTAL DE CONEXIONES, PRÓXIMO MANTENIMIENTO, SELLADO TERMINADO, ABRIR LA PINZA, CASETE VACIO, INSERTAR CASETE CON LÁMINAS. PANEL DE CONTROL AMIGABLE AL USUARIO, FÁCIL DE USAR, EL CAMBIO DE LÁMINA ES REEMPLAZADO AUTOMÁTICAMENTE DESPUÉS DE CADA UNIÓN. PARA SEGURIDAD Y COMODIDAD LAS LÁMINAS USADAS SON ELIMINADAS DE FORMA AUTOMÁTICA EN UNA CAJA INTEGRADA AL EQUIPO QUE TIENE UN MONITOR DE SENSOR INTEGRADO QUE MIDE LA OCUPACIÓN DE LA CAJA EN CADA MOMENTO Y DE ESTA MANERA SOLICITA VACIAR LA MISMA ANTES DE QUE SE LLENE, ACEPTA CUALQUIER TUBERÍA CON DIÁMETRO INTERNO DE 2.9 A 3.1 MM Y DIÁMETRO EXTERNO DE 3.9 A 4.5 MM COMPACTO Y LIVIANO (18.4CM X 13.9CM X 27.6CM) (5.5 KG) PORTÁTIL. CON ALARMAS AUDIBLE PARA AVISAR EN CASO DE UN PROBLEMA DEL CERRADO DEL CLAMP.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO</b>
75	<b>REFERENCIA</b>	EN EL INCISO I. "ADEMÁS DEBERÁ INCLUIR EN LA PROPUESTA LOS SIGUIENTES COMPONENTES": PÁGINA 66 SOLICITAN 1 CONECTOR DE TUBERÍA ESTÉRIL.
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME ¿CUANTAS CONEXIONES ESTÉRILES SE TIENE PROGRAMADO REALIZAR EN ESTA LICITACIÓN?
	<b>RESPUESTA</b>	2000

LABORATORIOS LICAN, S.A. DE C.V.

76	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO 1
	<b>PREGUNTA</b>	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTA NUESTRA

		<p>APRECIACIÓN QUE HACE FALTA INTEGRAR PARTIDAS DE PRODUCTOS PARA REALIZAR EN EQUIPO SEÑALADO EN EL ANEXO C-1 DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA (CETS). EQUIPO NO. 2. PARA TIPAJE SANGUINEO, PRUEBAS CRUZADAS, ANTICUERPOS IRREGULARES. COMO COMPLEMENTO DE LA PARTIDA 113. PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD EN TARJETAS DE GEL CANTIDAD MINIMA 900 CANTIDAD MAXIMA 1500. EN CASO DE SER CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN, NOS PUEDE INDICAR LAS PARTIDAS, DESCRIPCIONES Y CANTIDADES DE ESTOS PRODUCTOS.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SU PROPUESTA DEBE INCLUIR LO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE UNIDADES DE SANGRE SEGURA COMPATIBLE.</b>
77	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO 1
	<b>PREGUNTA</b>	<p>SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE SE DEBERÁ INSCRIBIR AL CETS A UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD LAS PRUEBAS DE SEROLOGÍA E INMUNOHEMATOLOGÍA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM-253-SSA1-2012.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>
	<b>RESPUESTA</b>	<b>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b>
78	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO 1
	<b>PREGUNTA</b>	<p>SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE SE DEBERÁ DOTAR DE CONTROLES POSITIVOS, NEGATIVOS Y DÉBIL POSITIVOS PARA LAS PRUEBAS DE SEROLOGÍA ADICIONALES A LOS CONTROLES DEL FABRICANTE DEL REACTIVO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM 253-SSA1-2012.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>
	<b>RESPUESTA</b>	<b>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b>
79	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO 1
	<b>PREGUNTA</b>	<p>SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LAS PARTIDA 113. PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD EN TARJETAS DE GEL CANTIDAD MINIMA 900 CANTIDAD MAXIMA 1500. NOS PERMITAN ENTREGAR UNA CADUCIDAD MÍNIMA DE 6 MESES JUNTO CON UNA CARTA COMPROMISO DE DECIR VERDAD DE HACER EL CAMBIO FÍSICO EN CASO DE CADUCAR EL PRODUCTO, YA QUE POR LA NATURALEZA DE ESTOS PRODUCTOS NO ES POSIBLE CUMPLIR LA CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA.</b>
80	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO A-1
	<b>PREGUNTA</b>	<p>SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE FAVOR DE OMITIR A EN EL ANEXO A-1 DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS. EQUIPO. NO. 7. COAGULOMETRO MEDIANO RENDIMIENTO. EN METODOLOGIA. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ANALIZADOR. PUNTO DONDE INDICA REALIZA 1100 PUNTOS DE LECTURA POR CADA DETERMINACION. PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APAGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.</b>
81	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO A-1

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*

	<b>PREGUNTA</b>	ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE EL ANEXO A-1 DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS. EQUIPO. NO. 6. COAGULOMETRO ALTO RENDIMIENTO Y EQUIPO. NO. 7. COAGULOMETRO MEDIANO RENDIMIENTO. EN DESCRIPCION TECNICA DEL ANALIZADOR. SE PUEDE COTIZAR EQUIPO CON DETECCIÓN DE COAGULO POR MÉTODO FOTO ÓPTICO/CROMOGÉNICO Y MECÁNICO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.</b>
82	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO A-1
	<b>PREGUNTA</b>	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA ANEXO A-1 DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS. EQUIPO. NO. 7. MEDIANO RENDIMIENTO. EN CARACTERISTICAS DEL EQUIPO. DESCRIPCION TECNICA DEL ANALIZADOR. 8. PRECALENTAMIENTO DE CELDAS DE REACCION QUE LE BRINDA MAYOR RAPIDEZ EN LA REALIZACION DE LAS DETERMINACIONES. SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON CUBETAS DE REACCIÓN QUE NO REQUIEREN PRECALENTAMIENTO SIN QUE ESTO SEA UNA LIMITANTE PARA PODER INCREMENTAR LA RAPIDEZ EN LA REALIZACIÓN DE LAS DETERMINACIONES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE</b>
83	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO A-1
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA ANEXO A-1 DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS. EQUIPO. NO. 8. COAGULOMETRO DE BAJO RENDIMIENTO. CARACTERISTICAS. DESCRIPCION TECNICA DEL ANALIZADOR. SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE COAGULACIÓN DE BAJO RENDIMIENTO CON PRINCIPIO DE MEDICIÓN: TECNOLOGÍA DE BALÍN PATENTADA PARA OBTENER RESULTADOS SEGUROS Y REPRODUCIBLES, SIN QUE EL RESULTADO SE VEA AFECTADO POR LA ICTERICIA, HEMOLISIS Y LIPEMIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA.</b>
84	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO A-1
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA ANEXO A-1 DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS. EQUIPO. NO. 8. COAGULOMETRO DE BAJO RENDIMIENTO. CARACTERISTICAS. DESCRIPCION TECNICA DEL ANALIZADOR. 4. REACTIVOS CON INDICE DE SENSIBILIDAD DE 0.98 A 1.02 DE ORIGEN HUMANO. SE NOS PERMITA OFERTAR REACTIVOS CON ÍNDICE DE SENSIBILIDAD MENOR A 1.25 COMO SE SOLICITA PARA EQUIPO. NO. 6. COAGULOMETRO ALTO RENDIMIENTO Y EQUIPO. NO. 7. COAGULOMETRO MEDIANO RENDIMIENTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA.</b>
85	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO-1
	<b>PREGUNTA</b>	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA EQUIPO PARA DIAGNÓSTICO DE BRUCELOSIS PRUEBA DE AGLUTINACION CON ANTIGENO ROSA DE BENGALA EQUIPO QUE CONTENGA: PLACA DE REACCION CONTROL POSITIVO Y CONTROL NEGATIVO. NOS PERMITA OFERTAR ROSA DE BENGALA, PRESENTACIÓN DE 50 PRUEBAS EL CUAL INCLUYE CONTROL POSITIVO, CONTROL NEGATIVO Y PLACA DE REACCIÓN. EN CASO DE ACEPTAR NUESTRA PROPUESTA NOS INDIQUEN PARTIDA Y CANTIDAD A SOLICITAR YA QUE NO VIENE INCLUIDA EN EL ANEXO 1 DE LAS PRESENTES

		BASES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES</b>

**DICIPA, S.A. DE C.V.**

<b>86</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO. 4 BIOMETRÍA HEMÁTICA ALTO RENDIMIENTO</b>
	<b>PREGUNTA</b>	/ METODOLOGÍA / ESTÁN SOLICITANDO OBLIGATORIAMENTE SOLO 2 PRINCIPIOS DE MEDICIÓN; SIN EMBARGO HOY EN DÍA LA BASE INSTALADA EN LA SS DE ALTO RENDIMIENTO PRESENTA NO SOLO 2 SINO 3 METODOLOGÍA, DISMINUYENDO LA CALIDAD DE LECTURA EN SUS DIFERENCIALES. RECOMENDAMOS SEAN 3 LAS METODOLOGÍAS OBLIGADAS PARA NO DISMINUIR LA CALIDAD EN LOS RESULTADOS.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE, PUEDE OFERTAR MÁS DE LO SOLICITADO.</b>
<b>87</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO. 4 BIOMETRÍA HEMÁTICA ALTO RENDIMIENTO</b>
	<b>PREGUNTA</b>	/ RENDIMIENTO / ESTÁN SOLICITANDO OBLIGATORIAMENTE AL MENOS 60 PRUEBAS POR HORA; SIN EMBARGO HOY EN DÍA LA BASE INSTALADA EN LA SS DE ALTO RENDIMIENTO PRESENTA 100 PRUEBAS POR HORA, DISMINUYENDO SU PRODUCTIVIDAD. RECOMENDAMOS SEAN 100 PRUEBAS POR HORA OBLIGADAS PARA NO DISMINUIR LA PRODUCTIVIDAD ACTUAL.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE , PUEDE OFERTAR MÁS DE LO SOLICITADO</b>
<b>88</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO. 4 BIOMETRÍA HEMÁTICA ALTO RENDIMIENTO CON VISUALIZACIÓN DE HISTOGRAMAS Y DISPERSOGRAMAS PARA WBC, RBC Y PLT.</b>
	<b>PREGUNTA</b>	/ PARÁMETROS A MEDIR / ESTÁN SOLICITANDO OBLIGATORIAMENTE AL MENOS 22 PARÁMETROS; SIN EMBARGO HOY EN DÍA LA BASE INSTALADA EN LA SS DE ALTO RENDIMIENTO PRESENTA 29 PARÁMETROS, DISMINUYENDO LA CALIDAD EN SUS RESULTADOS. RECOMENDAMOS SEAN MÍNIMO 29 PARÁMETROS OBLIGADOS PARA NO DISMINUIR LA CALIDAD DE SUS RESULTADOS.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE , PUEDE OFERTAR MÁS DE LO SOLICITADO</b>
<b>89</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO. 4 BIOMETRÍA HEMÁTICA ALTO RENDIMIENTO</b>
	<b>PREGUNTA</b>	/CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO/ESTÁN SOLICITANDO OBLIGATORIAMENTE AUTOMUESTREADOR SIN UN LÍMITE DE LA CAPACIDAD DE CARGA INICIAL, LO CUAL PERMITE OFERTAR UN CARGADOR PEQUEÑÍSIMO DE UNA MUESTRA POR UNA MUESTRA; SIN EMBARGO HOY EN DÍA LA BASE INSTALADA EN LA SS DE ALTO RENDIMIENTO PRESENTA EQUIPOS COM AUTOCARGARDOR DE HASTA 140 MUESTRAS INICIALES, DISMINUYENDO SU PRODUCTIVIDAD. RECOMENDAMOS SEA CARGA INICIAL DE 140 MUESTRAS OBLIGADAS PARA NO DISMINUIR LA PRODUCTIVIDAD ACTUAL.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.</b>
<b>90</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO. 5 BIOMETRÍA HEMÁTICA MEDIANO RENDIMIENTO</b>
	<b>PREGUNTA</b>	/TIPO/ESTÁN SOLICITANDO OBLIGATORIAMENTE DIFERENCIAL EN 3 PARTES; SIN EMBARGO HOY EN DÍA LA BASE INSTALADA EN LA SS DE MEDIANO RENDIMIENTO PRESENTA DIFERENCIAL EN 5 POBLACIONES, DISMINUYENDO LA CALIDAD EN SUS RESULTADOS. RECOMENDAMOS SEAN

		MÍNIMO 5 POBLACIONES OBLIGADAS PARA NO DISMINUIR LA CALIDAD DE SUS RESULTADOS.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.</b>
91	<b>REFERENCIA</b>	EQUIPO NO. 5 BIOMETRÍA HEMÁTICA MEDIANO RENDIMIENTO
	<b>PREGUNTA</b>	/PARÁMETROS A MEDIR/ESTÁN SOLICITANDO OBLIGATORIAMENTE MÍNIMO 18 PARÁMETROS; SIN EMBARGO HOY EN DÍA LA BASE INSTALADA EN LA SS DE MEDIANO RENDIMIENTO PRESENTA 26 PARÁMETROS, DISMINUYENDO LA CALIDAD EN SUS RESULTADOS. RECOMENDAMOS SEAN MÍNIMO 26 PARÁMETROS OBLIGADOS PARA NO DISMINUIR LA CALIDAD DE SUS RESULTADOS.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.</b>
92	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO C-1 DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA (CETS) EQUIPO NO 1. BIOMETRÍA HEMÁTICA
	<b>PREGUNTA</b>	/PARÁMETROS A MEDIR / LOS PARÁMETROS RETIC #, RETIC %, IRF, ANÁLISIS DE RETICULOCITOS / NO SON NECESARIOS EN UNA EVALUACIÓN PARA ACEPTAR O RECHAZAR UN DONADOR; POR LO QUE SOLICITAMOS SEAN OPCIONALES.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.</b>
93	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO C-1 DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA (CETS) EQUIPO NO 1. BIOMETRÍA HEMÁTICA
	<b>PREGUNTA</b>	/ PARÁMETROS A MEDIR / TECNOLOGÍA VCS / SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR EN LUGAR DE LA METODOLOGÍA VCS LA METODOLOGÍA DE IMPEDANCIA CON CITOQUÍMICA DE ABSORBANCIA CON VOLUMEN LA CUAL GENERA RESULTADOS DE IGUAL CALIDAD A LA SOLICITADA Y QUE USTEDES MISMOS DESCRIBEN LA METODOLOGÍA DE ESTA DESCRIPCIÓN.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.</b>
94	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO C-1 DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA (CETS) EQUIPO NO 1. BIOMETRÍA HEMÁTICA
	<b>PREGUNTA</b>	/ CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO / 1 VOLUMEN DE MUESTRA MAXIMO 250 / SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR UN ANALIZADOR CON VOLUMEN DE MUESTRA MÁXIMO 300 MICROLITROS; YA QUE ESTO NO CAMBIA DE FORMA SIGNIFICATIVA EL VOLUMEN DE ASPIRACIÓN, ADEMÁS QUE EL TUBO MÁS PEQUEÑO PARA TOMA DE MUESTRA PROPORCIONA UNA MAYOR CANTIDAD A 300 MICROLITROS.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.</b>
95	<b>REFERENCIA</b>	EQUIPO NO.14 DE BACTERIOLOGIA
	<b>PREGUNTA</b>	DADO QUE EN ALGUNAS CARACTERÍSTICAS CONTENIDAS EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ANALIZADOR SE MANEJA EL TÉRMINO PANELES Y EN OTRA TARJETA ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR CUALQUIERA DE LAS PRESENTACIONES SOLICITADAS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE REFIERE A PANELES SOLAMENTE.</b>
96	<b>REFERENCIA</b>	EQUIPO NO.14 DE BACTERIOLOGIA
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAN EQUIPO CON PANELES DE IDENTIFICACIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EL TERMINO EQUIVALENTE UTILIZADO EN EL MERCADO QUE ES TARJETA LA CUAL TIENE LA MISMA FUNCIONALIDAD QUE EL PANEL ¿SE ACEPTA?

	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, SE REQUIEREA PANELES SOLAMENTE.</b>
97	<b>REFERENCIA</b>	EQUIPO NO.14 DE BACTERIOLOGIA
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAN EQUIPO CON METODOLOGÍA LECTURA AUTOMÁTICA DE LA IDENTIFICACIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD POR FLUORESCENCIA, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y NO CERRAR A UNA ESPECIFICACIÓN LA PRESENTE LICITACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA CON TECNOLOGÍA DE TRANSMISIÓN ÓPTICA EL CUAL ES EQUIVALENTE AL SOLICITADO ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.</b>
98	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO C-1 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA (CETS). EQUIPO NO 2. PARA TIPAJE SANGUINEO, PRUEBAS CRUZADAS, ANTICUERPOS IRREGULARES SOLICITAN: CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ANALIZADOR TIPO LAS PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD DEBEN REALIZARSE EN TARJETAS DE GEL QUE CONTENGAN ANTIGLOBULINAPOLIESPECÍFICA (ANTI IG G Y ANTI C3D). SE REQUIERE EQUIPO PARA BANCO DE SANGRE AUTOMATIZADO Y SEMIAUTOMATIZADO. METODOLOGÍA: EQUIPO COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO PARA REALIZAR LAS TÉCNICAS DE INMUNOHEMATOLOGIA EN TARJETAS DE GEL PARA LAS PRUEBAS DE GRUPO SANGUÍNEO ABO DIRECTO E INVERSO, FACTOR RH, FENOTIPO RH, COOMBS DIRECTO, RASTREO E IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS Y PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD.
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE FAVORECER LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE PERMITA OFERTAR TARJETAS, CASSETTES O MICROPLACAS. SIN QUE ESTO AFECTE LA CALIDAD NI EL PROCESAMIENTO DE LAS PRUEBAS. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.</b>
99	<b>REFERENCIA</b>	EQUIPO NO 3. SEROLOGIA  CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO: ANALIZADOR DE INMUNOENSAYO COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO, CON MENÚ COMPLETO PARA BANCO DE SANGRE (HIV, HBSAG, HCV, SÍFILIS Y CHAGAS) . TECNOLOGÍA QUIMIOLUMINISCENCIA 20 DONANTES/ HORA (PERFIL COMPLETO) PROTOCOLOS FLEXIBLES DE ENSAYO: SE TRABAJA CON DISTINTOS PROTOCOLOS PARA TENER UN MEJOR DESEMPEÑO Y MAYOR PRECISIÓN CLÍNICA ,PROTOCOLOS DE DOS PASOS: CONJUGADO NO TIENE CONTACTO CON LA MUESTRA, EVITANDO EFECTO PROZONA POR ALTAS CONCENTRACIONES ROTOR REFRIGERADO (4 +/- 8°C), CON CAPACIDAD PARA 25 REACTIVOS CARGA DE MUESTRAS FRONTALES. GRADILLAS PARA TUBOS PRIMARIOS DE DISTINTOS TAMAÑOS Y COPAS CAPACIDAD DE MUESTRAS SIMULTÁNEAS: 100 RUTINA, 35 URGENCIA DETECCIÓN DE COÁGULOS (TECNOLOGÍA DE PRESIÓN DIFERENCIAL) Y BURBUJAS ARRASTRE DE MUESTRAS MENOR A 0.1 PPM CARGA DE INSUMOS Y CONSUMIBLES PERMITE 5 HORAS DE OPERACIÓN DE MANOS LIBRES DILUCIÓN AUTOMÁTICA REACTIVOS LISTOS PARA USAR EL EQUIPO DEBE
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

		<p>INSTRUMENTO AUTOMATIZADO PARA OBTENER UN ALTO NIVEL DE SEGURIDAD EN EL PROCESAMIENTO DE LOS ENSAYOS                  PRINCIPIO DE MEDICIÓN QUIMIOLUMINISCENCIA                  QUE REALICE LOS 5 MARCADORES EN LA MISMA PLATAFORMA CON DISPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE MUESTRAS Y REACTIVOS                  CHEQUEO AUTOMÁTICO DE IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS                  CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO CON GRÁFICAS DE LEVEY JENNINGS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PRUEBAS QUE REALIZA                  CURVA DE CALIBRACIÓN ESTABLE POR LO MENOS 28 DÍAS                  SENSOR CON CAPACIDAD DE DETECCIÓN DE COÁGULO                  CON PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA INTERFASE BIDIRECCIONAL CON CONSUMIBLES                  ACCESO CONTINUO DE MUESTRAS Y REACTIVOS EN FORMA CONSTANTE CON DILUCIÓN AUTOMÁTICA                  CAPACIDAD DE PROCESAR MUESTRAS DE URGENCIA SIN NECESIDAD DE INTERRUMPIR EL TRABAJO YA PROGRAMADO Y EN PROCESO CON INTERFCE PARA ASESORÍA TÉCNICA DIRECTA.                  CAPACIDAD DE PROCESO DE 180 PRUEBAS POR HORA                  IDENTIFICACIÓN DE REACTIVOS POR RADIOFRECUENCIA (RFID)                  25 POSICIONES PARA REACTIVOS                  UTILIZACIÓN DE PUNTAS DESECHABLES Y CELDAS INDIVIDUALES DE REACCIÓN                  CARGA CONTINUA DE HASTA 120 TUBOS                  ¿SE ACEPTA?</p>
	<b>RESPUESTA</b>	<b>FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.</b>
<b>100</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>ANEXO B-1, DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS. EQUIPO NO.11 GASOMETRÍA.</b>
	<b>PREGUNTA</b>	<p>CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO, INCISO 2 Y 5. SOLICITAN UN SOLO CARTUCHO MULTIPRUEBAS DONDE SE ENCUENTREN INTEGRADAS LAS SOLUCIONES, REACTIVOS, SENSORES, BOLSA DE DESECHO, GASES Y AGUJA DE TOMA. CON EL OBJETO DE QUE LA CONVOCANTE SE BENEFICIE AL RECIBIR UNA MAYOR CANTIDAD DE PROPUESTAS Y CON ELLO SE FAVOREZCA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR UN ANALIZADOR QUE NO REQUIERE TANQUES DE GAS Y QUE CUENTE CON UN SOLO CARTUCHO (PAQUETE) DONDE SE ENCUENTREN INTEGRADOS CALIBRADORES Y BOLSA DE DESECHO. ¿SE ACEPTA?</p>
	<b>RESPUESTA</b>	<b>FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.</b>
<b>101</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>ANEXO B-1, DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS. EQUIPO NO.11 GASOMETRÍA.</b>
	<b>PREGUNTA</b>	<p>CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO, INCISO 19. CON EL OBJETO DE QUE LA CONVOCANTE SE BENEFICIE AL RECIBIR UNA MAYOR CANTIDAD DE PROPUESTAS Y CON ELLO SE FAVOREZCA LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN ANALIZADOR QUE CUENTE CON TARJETA MICROSENSOR, O BIEN, CON ELEMENTOS DESECHABLES DE SENSORES QUE NO REQUIEREN MANTENIMIENTOS DIARIOS, TIENEN VIDAS OPERATIVAS PROLONGADAS Y SE PUEDEN REEMPLAZAR EN SEGUNDOS. ¿SE ACEPTA?</p>
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA.</b>
<b>102</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>ANEXO B-1, DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS. EQUIPO NO.11 GASOMETRÍA.</b>
	<b>PREGUNTA</b>	<p>PROCESAMIENTO DE DATOS, HARDWARE. INCISO 4. DADO QUE ESTA UN ANALIZADOR CORRECTAMENTE INTERFASADO SOLO REQUIERE LA LECTURA DEL CÓDIGO DE BARRAS O INGRESO DEL ID DEL PACIENTE, Y A QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO AFECTA LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN ANALIZADOR CON SISTEMA DE INTERFACE UNI O BIDIRECCIONAL. ¿SE ACEPTA?</p>

4

	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.</b>
<b>103</b>	<b>REFERENCIA</b>	EN ANEXO B-1, ANEXO C REFERENTE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DEL CETS
	<b>PREGUNTA</b>	<p>/ DESCRIPCION DE BOLSAS DE SANGRE/ SOLICITAN BOLSA CUÁDRUPLE TOP AND BOTTOM CPD/ ADSOL BOLSA PARA FRACCIONAR SANGRE CUADRUPLE TIPO TOP AND BOTTOM: CONTIENE UNA BOLSA PRIMARIA DE 450 500 ML PL- 146 CON 63 A 70 ML DE SOLUCION ANTICOAGULANTE CPD, CONECTADA A UN TUBO COLECTOR INTEGRAL Y A UN SISTEMA SECUNDARIO FORMADO POR TRES BOLSAS UNA BOLSA VACIA DE 350 - 400 ML PL-146, OTRA VACIA DE 400-450 ML PL-1240 PARA ALMACENAR PLAQUETAS POR 5 DIAS Y UNA MAS DE 450 ML PL-146 CONTENIDO 100 ML DE SOLUCION ADITIVA ADSOL QUE PROPORCIONA COMO MINIMO 42 DÍAS DE VIGENCIA AL CONCENTRADO ERITROCITARIO; CON AGUJA CALIBRE 16 G CON INDICADOR DE BISEL TACTIL Y VISUAL. COMPATIBLE CON SISTEMA DE REDUCCION DE LEUCOCITOS EN 1 O MAS LOGARITMOS.</p> <p>SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR BOLSA CUADRUPLE TOP AND BOTTOM CPD/SAGM, CON UNA BOLSA PRIMARIA DE 450 +/- 45 ML, CON UN TUBO COLECTOR INTEGRAL FLEXIBLE CON AGUJA DE 16 G, PARED ULTRAFINA, TRIBISELADA Y SILICONIZADA CON BAJA RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN (INDOLORA A LA PUNCIÓN). SOPORTE RANURADO DE LA AGUJA PARA FÁCIL MANEJO CON INDICADOR DE ORIENTACIÓN DEL BISEL. BOLSAS SECUNDARIAS DE 300 ML MÍNIMO FABRICADAS CON TOTM PARA CONSERVACIÓN DE LAS PLAQUETAS 5 DÍAS. TODAS LAS BOLSAS UNIDAS POR TUBOS CONECTORES DE GRAN FLEXIBILIDAD IDENTIFICADOS POR CÓDIGOS CADA CINCO CENTÍMETROS Y ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN ADHERIBLES DE FÁBRICA. EL SISTEMA T&amp;B PERMITE POR SU DISEÑO, UNA DESLEUCOCITACIÓN MÍNIMO DE 1 LOGARITMO CON RESPECTO A LOS VALORES INICIALES DEL DONADOR. UNA BOLSA SATÉLITE CON 100 ML DE SOLUCIÓN ADITIVA SAG-MANITOL PARA CONSERVACIÓN DEL CONCENTRADO ERITROCITARIO POR 42 DÍAS.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES</b>
<b>104</b>	<b>REFERENCIA</b>	EN ANEXO B-1, ANEXO C REFERENTE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DEL CETS
	<b>PREGUNTA</b>	<p>/ DESCRIPCION DE BOLSAS DE SANGRE / SOLICITAN BOLSA TRIPLE TOP AND BOTTOM CPD/ ADSOL BOLSA PARA FRACCIONAR SANGRE TRIPLE TIPO TOP AND BOTTOM: CONTIENE UNA BOLSA PRIMARIA DE 450-500 ML PL- 146 CON 63 A 70 ML DE SOLUCION ANTICOAGULANTE CPD, CONECTADA A UN TUBO COLECTOR INTEGRAL Y A UN SISTEMA SECUNDARIO FORMADO POR TRES BOLSAS UNA BOLSA VACIA DE 350 ? 400 ML PL-146, Y OTRA DE 450 ML PL-146 CONTENIDO 100 ML DE SOLUCION ADITIVA ADSOL QUE PROPORCIONA COMO MINIMO 42 DIAS DE VIGENCIA AL CONCENTRADO ERITROCITARIO; CON AGUJA CALIBRE 16 G CON INDICADOR DE BISEL TACTIL Y VISUAL. COMPATIBLE CON SISTEMA DE REDUCCION DE LEUCOCITOS EN 1 O MAS LOGARITMOS.</p> <p>SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR BOLSA TRIPLE PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SOLUCIÓN CPD + SAG MANITOL, PARA RECOLECCIÓN DE 450 +/-45 ML DE SANGRE SISTEMA TOP AND BOTTOM (T&amp;B). BOLSA MATRIZ CON 63 ML DE SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE CPD CON UN TUBO COLECTOR INTEGRAL FLEXIBLE CON AGUJA DE 16 G, PARED ULTRAFINA, TRIBISELADA Y SILICONADA CON BAJA RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN (INDOLORA A LA PUNCIÓN). SOPORTE RANURADO DE LA AGUJA PARA FÁCIL MANEJO CON INDICADOR DE ORIENTACIÓN DEL BISEL. BOLSAS SECUNDARIAS DE 300 ML MÍNIMO. TODAS LAS BOLSAS UNIDAS POR TUBOS CONECTORES DE GRAN FLEXIBILIDAD IDENTIFICADOS POR CÓDIGOS CADA CINCO CENTÍMETROS Y</p>

		ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN ADHERIBLES DE FÁBRICA. UNA BOLSA SATÉLITE CON 100 ML DE SOLUCIÓN ADITIVA SAG-MANITOL PARA CONSERVACIÓN DEL CONCENTRADO ERITROCITARIO POR 42 DÍAS. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.</b>
<b>105</b>	<b>REFERENCIA</b>	EN ANEXO B-1, ANEXO C REFERENTE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DEL CETS
	<b>PREGUNTA</b>	/ DESCRIPCIÓN DE BOLSAS DE SANGRE/ BOLSA TRANSFER BOLSA PARA TRANSFERENCIA CON CAPACIDAD DE 150ML CON ACOPLADOR, PARA PROCESAMIENTO E INFUSIÓN DE CONCENTRADO ERITROCITARIO Y/O PLASMA. PAQUETE CON 12 UNIDADES. SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR BOLSA UNITARIA PARA TRANSFERENCIA DE 300 ML ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES.</b>
<b>106</b>	<b>REFERENCIA</b>	EN ANEXO B-1, ANEXO C REFERENTE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DEL CETS
	<b>PREGUNTA</b>	/ DESCRIPCIÓN DE BOLSAS DE SANGRE/ BOLSA SIMPLE BOLSA SENCILLA CON CAPACIDAD DE 450ML PARA OBTENCIÓN DE SANGRE TOTAL DE DONACIÓN Y/O SANGRÍAS TERAPÉUTICAS. PLÁSTICO PL 146 Y SOLUCIÓN ADENINA. AGUJA CON CAPUCHÓN NO REPOSICIONABLE Y BISEL PARA FACILITAR SU USO, DE UNA SOLA PIEZA. PAQUETE CON 12 UNIDADES. SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR BOLSA SIMPLE CPDA CON CAPACIDAD DE 450 ML. PLÁSTICO PVC. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES</b>
<b>107</b>	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO B-1, ANEXO C REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DEL CETS.
	<b>PREGUNTA</b>	/ DESCRIPCIÓN DE BOLSAS DE SANGRE/ SOLICITAN BOLSA CUÁDRUPLE TOP AND BOTTOM CPD/ ADSOL BOLSA PARA FRACCIONAR SANGRE CUÁDRUPLE TIPO TOP AND BOTTOM: CONTIENE UNA BOLSA PRIMARIA DE 450 500 ML PL- 146 CON 63 A 70 ML DE SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE CPD, CONECTADA A UN TUBO COLECTOR INTEGRAL Y A UN SISTEMA SECUNDARIO FORMADO POR TRES BOLSAS UNA BOLSA VACÍA DE 350 - 400 ML PL-146, OTRA VACÍA DE 400-450 ML PL-1240 PARA ALMACENAR PLAQUETAS POR 5 DÍAS Y UNA MÁS DE 450 ML PL-146 CONTENIDO 100 ML DE SOLUCIÓN ADITIVA ADSOL QUE PROPORCIONA COMO MÍNIMO 42 DÍAS DE VIGENCIA AL CONCENTRADO ERITROCITARIO; CON AGUJA CALIBRE 16 G CON INDICADOR DE BISEL TÁCTIL Y VISUAL. COMPATIBLE CON SISTEMA DE REDUCCIÓN DE LEUCOCITOS EN 1 O MÁS LOGARITMOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA PARA FRACCIONAR SANGRE CUÁDRUPLE TIPO TOP AND BOTTOM: CONTIENE UNA BOLSA PRIMARIA DE 450 ML CON 63 ML DE SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE CPD CON SALIDA POR ARRIBA Y POR ABAJO CONECTADA A UN TUBO COLECTOR INTEGRAL CON AGUJA 16 G CON PUNTA DE TRIPLE BISELADO Y DISEÑO DE PARED ULTRA DELGADA Y CON PROTECTOR DE AGUJA, BOLSA DE DIVERSIFICACIÓN Y CON SISTEMA DE SEGURIDAD PARA TOMA DE MUESTRA, UNIDA A UN SISTEMA SECUNDARIO FORMADO POR DOS BOLSAS SATÉLITES VACÍA DE 400 ML AMBAS BOLSAS PARA ALMACENAR PLAQUETAS POR 5 DÍAS Y OTRA DE 450 ML CON 100 ML DE SOLUCIÓN ADITIVA (OPTISOL) QUE PROPORCIONE COMO MÍNIMO 42 DÍAS DE VIGENCIA AL CONCENTRADO ERITROCITARIO; COMPATIBLE CON SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE LEUCOCITOS EN 1 O MÁS LOGARITMOS. YA QUE LA BOLSA SOLICITADA DESCRIBE A UNA MARCA COMERCIAL LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.

	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES</b>
<b>108</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>ANEXO B-1, ANEXO C REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DEL CETS</b>
	<b>PREGUNTA</b>	<p>/ DESCRIPCION DE BOLSAS DE SANGRE/ SOLICITAN BOLSA TRIPLE TOP AND BOTTOM CPD / ADSOL BOLSA PARA FRACCIONAR SANGRE TRIPLE TIPO TOP AND BOTTOM: CONTIENE UNA BOLSA PRIMARIA DE 450-500 ML PL- 146 CON 63 A 70 ML DE SOLUCION ANTICOAGULANTE CPD, CONECTADA A UN TUBO COLECTOR INTEGRAL Y A UN SISTEMA SECUNDARIO FORMADO POR TRES BOLSAS UNA BOLSA VACIA DE 350 ? 400 ML PL-146, Y OTRA DE 450 ML PL-146 CONTENIDO 100 ML DE SOLUCION ADITIVA ADSOL QUE PROPORCIONA COMO MINIMO 42 DIAS DE VIGENCIA AL CONCENTRADO ERITROCITARIO; CON AGUJA CALIBRE 16 G CON INDICADOR DE BISEL TACTIL Y VISUAL. COMPATIBLE CON SISTEMA DE REDUCCION DE LEUCOCITOS EN 1 O MAS LOGARITMOS.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA PARA FRACCIONAR SANGRE TRIPLE TIPO TOP AND BOTTOM: CONTIENE UNA BOLSA PRIMARIA DE 450 ML CON 63 ML DE SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE CPD CON SALIDA POR ARRIBA Y POR ABAJO CONECTADA A UN TUBO COLECTOR INTEGRAL CON AGUJA 16 G CON PUNTA DE TRIPLE BISELADO Y DISEÑO DE PARED ULTRA DELGADA Y CON PROTECTOR DE AGUJA, BOLSA DE DIVERSIFICACIÓN Y CON SISTEMA DE SEGURIDAD PARA TOMA DE MUESTRA, UNIDA A UN SISTEMA SECUNDARIO FORMADO POR UNA BOLSA SATÉLITE VACÍA DE 400 ML Y OTRA DE 450 ML CON 100 ML DE SOLUCIÓN ADITIVA (OPTISOL) QUE PROPORCIONE COMO MÍNIMO 42 DÍAS DE VIGENCIA AL CONCENTRADO ERITROCITARIO; COMPATIBLE CON SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE LEUCOCITOS EN 1 O MÁS LOGARITMOS.</p> <p>YA QUE LA BOLSA SOLICITADA DESCRIBE A UNA MARCA COMERCIAL Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.</p>
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES.</b>
<b>109</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>ANEXO B-1, ANEXO C REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DEL CETS</b>
	<b>PREGUNTA</b>	<p>/DESCRIPCION DE BOLSAS DE SANGRE/ SOLICITAN BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA TRANSFERENCIA CON CAPACIDAD DE 150ML PAQUETE CON 12 UNIDADES.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE ALA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA DE TRANSFERENCIA DE 150 ML EN EMPAQUE INDIVIDUAL PARA GARANTIZAR LA ESTERILIDAD EN PRESENTACIÓN CAJA CON 25 PIEZAS</p>
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO DEBIENDO HACER EL AJUSTE CORRESPONDIENTE A LAS CANTIDADES SOLICITADAS</b>
<b>110</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>ANEXO B-1, ANEXO C REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DEL CETS</b>
	<b>PREGUNTA</b>	<p>/DESCRIPCION DE BOLSAS DE SANGRE/ SOLICITAN BOLSA SIMPLE BOLSA SENCILLA CON CAPACIDAD DE 450ML PARA OBTENCION DE SANGRE TOTAL DE DONACION Y/O SANGRIAS TERAPEUTICAS. PLASTICO PL 146 SOLUCION ADENINA. AGUJA CON CAPUCHON NO REPOSICIONABLE Y BISEL PARA FACILITAR SU USO, DE UNA SOLA PIEZA. PAQUETE CON 12 UNIDADES. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA SENCILLA PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE CPDA-1, DE USO ÚNICO, VOLUMEN DE RECOLECCIÓN DE 450ML CON 63 ML CPDA-1, CON AGUJA 16G CON PUNTA DE TRIPLE BISELADO Y DISEÑO DE PARED ULTRA DELGADA. YA QUE LA BOLSA SOLICITADA DESCRIBE A UNA MARCA COMERCIAL Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.</p>

	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES.</b>
111	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO C-1. DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA CETS. EQUIPO NO. 5 EQUIPO DE AFERESIS
	<b>PREGUNTA</b>	<p>/METODOLOGIA/ SOLICITAN BAJOS VOLUMENES EXTRACORPOREOS: PLAQUETAS [209 ML], CÉLULAS MONONUCLEARES [163 ML]. INFUSION DE SOLUCIÓN FISIOLÓGICA SIN ABRIR EL SISTEMA. PROVEE MAYORES OPORTUNIDADES DE COLECTAR DOBLES Y TRIPLES PRODUCTOS DE PLAQUETAS. PERMITE INTRODUCIR EL VOLUMEN MEDIO PLAQUETARIO PARA EFICIENTAR LAS COLECCIONES DE PLAQUETAS Y DETERMINAR EL LIQUIDO DE ALMACENAMIENTO BRAZALETE Y MANGUITO QUE MINIMIZAN PROBABILIDAD DE VENAS PONCHADAS POSIBILIDAD DE OBTENER PLAQUETAS DESPLAZMATIZADAS CONTROL DE INFUSIÓN AL CITRATO CANDADO DE SEGURIDAD POSTDONACION.</p> <p>SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR MAQUINA DE AFERESIS CON TECNOLOGIA: OBTENCION DE DOBLE PRODUCTO DE PLAQUETAS, ALTO NIVEL DE SEGURIDAD Y PRECISIÓN, PROTOCOLOS TOTALMENTE AUTOMATICOS. UNICA VENIPUNCIÓN, PARAMETROS DE RECOLECCIÓN PERSONALIZADOS, FACILIDAD Y FLEXIBILIDAD DE USO ¿SE ACEPTA?</p>
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES.</b>
112	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO C-1. DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA CETS. EQUIPO NO. 5 EQUIPO DE AFERESIS
	<b>PREGUNTA</b>	<p>/ PARAMETROS A MEDIR/ SOLICITAN COLECCIÓN DE PLAQUETAS, PLASMA Y CONCENTRADO ERITROCITARIO EN UN MISMO PROCEDIMIENTO. PRODUCTOS LEUCORREDUCIDOS* EN 1X106 , COLECCIÓN DE CÉLULAS MONONUCLEARES (TALLO), RECAMBIO PLASMÁTICO TERAPÉUTICO</p> <p>SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR PARAMETROS A MEDIR COLECCIÓN DE PLAQUETAS, PLASMA, EN UN MISMO PROCEDIMIENTO. PLAQUETAS LEUCORREDUCIDAS, COLECCIÓN DE CÉLULAS MONONUCLEARES (TALLO), RECAMBIO PLASMÁTICO TERAPÉUTICO. ¿SE ACEPTA?</p>
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES.</b>
113	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO C-1. DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA CETS. EQUIPO NO. 5 EQUIPO DE AFERESIS
	<b>PREGUNTA</b>	<p>/CARACTERISTICAS DEL EQUIPO/ SOLICITAN SISTEMA CERRADO EN PLAQUETAS. COLECCIÓN DE CÉLULAS MONONUCLEARES EN DOBLE PUNCIÓN. PANTALLA TÁCTIL EN ESPAÑOL, BRAZALETE Y MANGUITO, CON ALARMA DE SEGURIDAD PARA EL DONADOR. CONTROL AUTOMATIZADO DE ANTICOAGULANTE. CUENTA CON BALANZAS QUE PERMITEN CALCULAR VOLUMEN DE ACD Y SOLUCIÓN FISIOLÓGICA. INCLUYE PARÁMETROS DE DONADOR-PACIENTE: TEMPERATURA, FRECUENCIA CARDIACA, PRESIONES SISTÓLICA Y DIASTÓLICA. CON INFUSIÓN DE SOLUCIÓN FISIOLÓGICA PARA MANTENER AL DONADOR ISOVOLÉMICO</p> <p>SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA DE AFERESIS PARA COLECCIÓN DE PLAQUETAS, COLECCIÓN DE CELULAS PROGENITORAS, RECAMBIO PLASMATICO, UNIPUNCIÓN, PANTALLA GRANDE, BRAZALETE, COMODIDAD Y SEGURIDAD PARA EL DONANTE. ¿SE ACEPTA?</p>
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.</b>
114	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO C-1. DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA CETS. EQUIPO NO. 5 EQUIPO DE AFERESIS

	<b>PREGUNTA</b>	<p>/CARACTERISTICAS DEL EQUIPO/ SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR:                  SISTEMA AUTOMATIZADO DE AFÉRESIS QUE PERMITE LA COLECCIÓN DE PLAQUETAS, PLASMA, CONCENTRADO ERITROCITARIO O DOBLE CONCENTRADO ERITROCITARIO LEUCODEPLETADO CON &lt;1X106 LEUCOCITOS EN UNA SOLA PLATAFORMA, FLUJO CONTINUO UNIPUNCIÓN, SOFTWARE EN ESPAÑOL. CONSTA DE 5 BOMBAS (EXTRACCIÓN, RETORNO, ACD, PLAQUETAS Y PLASMA), SENSOR DE NIVEL DE RESERVORIO, DETECTOR DE ACD Y DETECTOR GLÓBULOS ROJOS, SENSOR DE PRESIÓN DE CENTRÍFUGA Y SENSOR DE HUMEDAD, UN PORTACASETE QUE INCORPORA DE MANERA INTEGRADA LOS CABEZALES DE LAS BOMBAS DE CARGA AUTOMÁTICA, FILTROS, DIAFRAGMAS DE PRESIÓN, SENSORES Y DEPÓSITO DE RETORNO; ADEMÁS ES LA INTERFASE DE HARDWARE PARA LOS SENSORES, VÁLVULAS Y DETECTOR DE GLÓBULOS ROJOS. CONTROL AUTOMATIZADO DE ANTICOAGULANTE. TIENE UNA PANTALLA TÁCTIL (TOUCH SCREEN) A COLOR EN IDIOMA ESPAÑOL Y PERMITE LA COLECCIÓN DE LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS FUERA DE LA CENTRÍFUGA DIRECTAMENTE EN LA BOLSA DE ALMACENAMIENTO SIN NECESIDAD DE TRASVASE MANUAL, SISTEMA DE FLUJO CONTINUO Y CERRADO, IDIOMA EN ESPAÑOL, SOFTWARE ESCALABLE, PESO LIGERO DE 84 KG. CON SELLADOR DIELÉCTRICO INTEGRADO MENSAJES DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ANTE SITUACIÓN DE ALERTA Y CUENTA CON SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL DONANTE. CON UN VOLUMEN EXTRACOPOREO BAJO DE 196 ML.                  YA QUE EL EQUIPO SOLICITADO DESCRIBE A UNA MARCA COMERCIAL Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN</p>
	<b>RESPUESTA</b>	<b>FAVOR DE APEGARSE A BASES.</b>
115	<b>REFERENCIA</b>	<b>ANEXO C-1. DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA CETS. EQUIPO NO 6 SELLADOR</b>
	<b>PREGUNTA</b>	<p>/ CARACTERISTICAS DE EQUIPO/ SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR:                  SELLADOR DIELÉCTRICO PORTÁTIL DISEÑANDO PARA HACER SELLOS HERMÉTICOS CON PRECORTE PARA SEPARAR FÁCILMENTE LAS BOLSAS DE SANGRE SIN CONTAMINACIÓN ALGUNA, SELLA TUBOS DE 5 MM EN 1.5 SEGUNDOS CONTROLADO POR EL MICRO-CONTROLADOR, PRESENTA UNA PISTOLA SELLADORA ERGONÓMICAMENTE DISEÑADA QUE LE DA COMODIDAD AL USUARIO, CON INDICADOR DE SELLADO Y DISEÑADA DE TAL FORMA QUE MINIMIZA LA FUERZA REQUERIDA Y ASEGURA UN MEJORA AGARRE Y SELLOS CONSISTENTES. LA GUARDA ANTISALPICADURA FÁCIL DE QUITAR PROPORCIÓN SEGURIDAD; NO REQUIERE CALENTAMIENTO, LA BATERÍA NH NI QUEDA COMPLETAMENTE CARGADA EN UN MÁXIMO DE TRES HORAS PARA REALIZAR MÁS 1000 SELLOS DE ALTA CALIDAD (TOTALMENTE CARGADA 1500 SELLOS), PROTECCIÓN TÉRMICA ADICIONAL PARA LA BATERÍA CON INDICADOR DE CARGA, PESO: ALIMENTACIÓN BASE 2000 GMS, CABEZA SELLADORA 230 GMS, DIMENSIÓN DE FUENTE DE PODER: 160MMX250MMX40MM</p>
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO.</b>
116	<b>REFERENCIA</b>	<b>ANEXO C-1. DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA CETS. EQUIPO NO 7 MEZCLADOR</b>
	<b>PREGUNTA</b>	<p>/CARACTERISTICAS DE EQUIPO/ SOLICITAN CUANDO SE ALCANZA EL VOLUMEN DESEADO, LA MÁQUINA CIERRA CON UNA PINZA EL TUBO DEL DONANTE. FUNCIONA CON BATERÍA Y CON CORRIENTE, POR LO QUE PUEDE UTILIZARSE COMO UN APARATO PORTÁTIL. LA BATERÍA PROPORCIONA ENERGÍA DURANTE MÁS DE 12 HORAS, CON 4 RECOLECCIONES POR HORA.                  EQUIPADO CON MICROPROCESADOR, PROPORCIONA UN NIVEL DE</p>

		<p>AUTOMATIZACIÓN TOTALMENTE INNOVADOR. AUTO CALIBRACIÓN QUE BRINDA SEGURIDAD. ES CAPAZ DE DETECTAR PROBLEMAS DE FLUJO Y GARANTIZA QUE EL VOLUMEN RECOLECTADO SERÁ DE <math>\pm 5</math>ML CON RESPECTO DEL PROGRAMADO. DIFERENTES OPCIONES DE VOLUMEN A RECOLECTAR.</p> <p>CUENTA CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO NUMÉRICO, INDICADOR LUMINOSO, MENSAJES SONOROS, SISTEMA DE DETECCIÓN DE TUBO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL; SI SE DETECTA UNA AVERÍA, LA MÁQUINA INFORMA AL OPERADOR Y SE PONE FIN A LA RECOLECCIÓN. AUTO APAGADO EN 20 MINUTOS EN CASO DE NO UTILIZARSE PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA.</p> <p>SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR BALANZA AGITADORA ELECTRONICA PARA BOLSAS DE SANGRE PARA CUALQUIER TIPO DE BOLSA, MONITORIZACION EN PANTALLA DE VOLUMEN DONADO, ALARMAS. ¿SE ACEPTA?</p>
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES</b>
117	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO C-1. DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA CETS. EQUIPO NO 7 MEZCLADOR
	<b>PREGUNTA</b>	<p>/CARACTERISIRICAS DE EQUIPO/ SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR:</p> <p>RECOLECTOR AUTOMÁTICO DE SANGRE CON MOVIMIENTO OSCILATORIO CONTINUO CON CHAROLA MAGNÉTICA PARA COLOCAR BOLSA DE SANGRE DE CUALQUIER CONFIGURACIÓN CON O SIN SOLUCIÓN ADITIVA, CLAMP OBTURADOR DE PASO EN POSICIÓN CENTRAL CON DETECTOR DE CORRECTA COLOCACIÓN DE LÍNEA, CON PANTALLA LCD ( TOUCH SCREEN) ILUMINADA A COLOR SENSIBLE AL TACTO EN IDIOMA ESPAÑOL PARA FACILITAR LA TRANSFERENCIA DE DATOS, TIEMPO DE DONACIÓN, FLUJO Y VOLUMEN RECOLECTADO, ALARMAS AUDIBLES Y LED INDICADOR, CON SISTEMA DE CONVERSIÓN DE PESO A VOLUMEN.</p> <p>CON AUTO-CHEQUEO ANTES DE CADA DONACIÓN, ALARMAS DE SEGURIDAD PROGRAMABLES DE FLUJO, RETRASO EN VENOPUNCIÓN Y AVISO AUDIBLE AL TÉRMINO DE LA FLEBOTOMÍA, CON BATERÍA INCLUIDA.</p>
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO.</b>
118	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO C-1. DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA CETS. EQUIPO NO 8 FRACCIONADOR
	<b>PREGUNTA</b>	<p>/CARACTERISTICAS DE EQUIPO/ SOLICITAN EL SISTEMA INCLUYE 7 PROTOCOLOS DE FUNCIONAMIENTO ENUMERADOS DEL 0 AL 6, CON NUEVE PROGRAMAS CADA UNO, Y SE USA CON EL SISTEMA DE BOLSAS TOP AND BOTTOM OPTIPAC® U OTRAS BOLSAS DE SANGRE ESTÁNDAR.</p> <p>CUENTA CON SISTEMA DE CALIBRACIÓN, DETECTOR DE HEMOGLOBINA PARA EVITAR CONTAMINACIÓN DE GLÓBULOS ROJOS EN CONCENTRADOS PLAQUETARIOS, SOFTWARE DISPONIBLE EN INGLÉS Y ESPAÑOL, PASSWORD DE SEGURIDAD PARA EVITAR MODIFICACIONES EN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS, CON OPCIÓN PARA PROCESAMIENTO DE DATOS.</p> <p>ASÍ MISMO, PROVEE GRAN CONTROL DEL PROCESO AL SER INTERFASABLE, QUE CONTROLA 2 BALANZAS POR CADA SISTEMA LO QUE PERMITE PESAR AUTOMÁTICAMENTE, ERITROCITOS, PLASMA O CUALQUIER OTRO COMPONENTE SANGUÍNEO PREPARADO.</p> <p>LA TERMINAL PERMITE CONECTAR LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS PARA INTRODUCIR INFORMACIÓN Y REGISTRAR:</p> <p>FECHA Y HORA  DURACIÓN DEL PROCESO  PROTOCOLO Y PROGRAMAS DEL SISTEMA  MENSAJES DE ALARMA</p>

		<p>PESO Y VOLUMEN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES SANGUÍNEOS</p> <p>SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS 16 PROGRAMAS PARA DIFERENTES TIPOS DE BOLSAS, CON REGULADOR DE FLUJO Y 5 SELLADORES, FUNCIONA SIN COMPRESOR DE AIRE. ¿SE ACEPTA?</p>
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES.</b>
<b>119</b>	<b>REFERENCIA</b>	<p>ANEXO C-1. DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA CETS. EQUIPO NO 8 FRACCIONADOR</p> <p>/CARACTERISTICAS DE EQUIPO/ SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR:</p>
	<b>PREGUNTA</b>	<p>EXTRACTOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS ALTAMENTE FLEXIBLE PARA EL PROCESAMIENTO ESTANDARIZADO DE SANGRE. EL DISPOSITIVO ESTÁ DISEÑADO PARA UTILIZARSE CON TODOS LOS SISTEMAS COMUNES DE BOLSAS, TANTO EL TIPO TAB ("TOP-AND-BOTTOM, CON SALIDA SUPERIOR E INFERIOR) COMO EL TIPO CONVENCIONAL TAT (CON DOS SALIDAS SUPERIORES), CON O SIN FILTROS INCORPORADOS. PRESENTA PANTALLA GRÁFICA A COLOR NÍTIDA INDICADORA DE TÉCNICA DE FRACCIONAMIENTO PARA SEGUIR FÁCILMENTE CADA PASO DEL PROCESO DE SEPARACIÓN, CON SOFTWARE EN ESPAÑOL, CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS BALANZAS, LOS DETECTORES Y LA POSICIÓN DE Prensado, Prensa con ángulo superior para evitar contaminación por glóbulos rojos, equipada con un detector de posición para ofrecer alta estabilidad durante la extracción, con microprocesador electrónico de procesos que supervisa y mide continuamente el flujo y peso de todos los hemocomponentes, soporte telescópico para bolsas con diseño ergonómico, 5 selladores de alta frecuencia automáticos con precorte (no requiere tijeras para separar la tubería), 5 obturadores de paso automático, 1 motor regulador de flujo, ajuste automático en el diámetro de la bolsas, 10 detectores ópticos y 2 detectores de presión, 3 balanzas para la medición del peso del plasma, buffy coat y solución aditiva, regulación del aire comprimido para presión constante, con 11 programas para todo tipo de fraccionamiento y tipo de bolsa utilizada, lector de código de barras, interfazable con sistema operativo de gestión de datos tomes. YA QUE EL EQUIPO SOLICITADO DESCRIBE A UNA MARCA COMERCIAL Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.</p>
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES</b>
<b>120</b>	<b>REFERENCIA</b>	<p>4.5.- REQUISITOS TÉCNICOS QUE COMPLEMENTAN Y CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA</p>
	<b>PREGUNTA</b>	<p>/ PUNTO 4.5.19/ SOLICITAN ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN DONDE EL LICITANTE ACEPTA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE COMPROMETE A: A).- QUE LA INTERFAZ DE CADA USUARIO ESTARA EN IDIOMA ESPAÑOL. B).- QUE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA RED DE LABORATORIOS CLINICOS Y CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSION SANGUINEA (CETS) DEBERÁ SER INSTALADO EN: 1.- INTERNET Y LOCAL: PARA CONCENTRACION DE DATOS ESTADISTICOS, 2.- INTERFASE DE EQUIPOS CLINICOS DE MANERA LOCAL. 3.-DESARROLLADO EN (Y/O): PHP, JAVA, JAVASCRIPT, HTML, 4.-BASE DE DATOS: MYSQL 5.- INFRAESTRUCTURA: PROPIA CON MULTIPLES SERVIDORES PARA LOGRAR: O REDUNDANCIA DE SERVICIO O REDUNDANCIA EN RESPALDO EN DIFERENTES SERVIDORES O REDUNDANCIA EN RESPALDO EN DIFERENTES DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 6.-SISTEMA OPERATIVO DE SERVIDORES: LINUX Y FREEBSD</p>

		SOLICITAMOS NOS PERMITA ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE EL LICITANTE ACEPTA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE COMPROMETE A INSTALAR UN SISTEMA INFORMATICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSION SANGUINEA EN IDIOMA ESPAÑOL, CON DIFERENTES CARACTERISTICAS PERO QUE CUMPLE PARA SER UTILIZADO EN BANCOS DE SANGRE. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES</b>
<b>121</b>	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO 1.
	<b>PREGUNTA</b>	/CONDICIONES DE SERVICIO/ SOLICITAN EL SISTEMA DEBERA FORMAR UNA RED DE COMUNICACION ON LINE PARA EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA (LESP), RED DE LABORATORIOS CLINICOS EN 12 UNIDADES HOSPITALARIAS Y 4 CENTROS DE SALUD, CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSION SANGUINEA (CETS), CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION EN SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (CAPASITS) EN EL ESTADO DE TLAXCALA, DONDE SE INCLUYA LA COMUNICACION PARA LABORATORIOS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS Y CENTROS DE SALUD LOS CUALES FORMAN PARTE DEL SISTEMA DE SALUD DE TLAXCALA, CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSION SANGUINEA (CETS), CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCION EN SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (CAPASITS), EL CONTROL OPERATIVO DEBERA ESTAR EN EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA TLAXCALA. SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR DIFERENTES SISTEMAS INFORMATICOS PARA LESP, CAPASITS, LABORATORIOS Y CETS, SIN TENER QUE ESTAR EN RED DE COMUNICACIÓN ON LINE ENTRE EL LESP. RED DE LABORATORIOS, CETS Y CAPASITIS. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE SOLICITA QUE CADA UNIDAD OPERE CON SU PROPIO SERVIDOR DE DATOS.</b>
<b>122</b>	<b>REFERENCIA</b>	EQUIPO NO.13 PARA HEMOGLOBINA GLICOSILADA
	<b>PREGUNTA</b>	PARÁMETROS A MEDIR, REALICE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA, MICRO ALBÚMINA, PROTEÍNA C REACTIVA, DÍMERO D. SOLICITAMOS PARA ESTA PARTIDA SE ACEPTE UN INSTRUMENTO QUE REALICE HEMOGLOBINA GLICOSILADA Y MICRO ALBUMINA, Y LAS PRUEBAS DE PROTEÍNA C REACTIVA Y DIMERO D SE PUEDAN PROCESAR EN INSTRUMENTOS ALTERNOS, YA QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS FAVORECEN A UNA SOLA CASA COMERCIAL NO PERMITIENDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES</b>
<b>123</b>	<b>REFERENCIA</b>	EQUIPO NO.13 PARA HEMOGLOBINA GLICOSILADA
	<b>PREGUNTA</b>	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO: QUE EL KIT SEA EN PRESENTACIÓN DE 24 PBAS. EN PRUEBAS INDIVIDUALES SIN MERMA DE REACTIVO PUNTO: 4 SOLICITAMOS SE ACEPTEN LAS PRESENTACIONES DE CADA CASA COMERCIAL, CON EL COMPROMISO DE ENTREGAR LA CANTIDAD DE REACTIVO NECESARIO PARA REALIZAR EL TOTAL DE LAS PRUEBAS SOLICITADAS, YA QUE LA PRESENTACIÓN DE 24 PBAS ES DE UNA MARCA EN ESPECÍFICO Y NO TIENE NINGÚN IMPACTO EN LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.</b>
<b>124</b>	<b>REFERENCIA</b>	EQUIPO NO.13 PARA HEMOGLOBINA GLICOSILADA
	<b>PREGUNTA</b>	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO: QUE LOS RESULTADOS CUANTITATIVOS SEAN EN TRES MINUTOS DE CUALQUIERA DE LAS PRUEBAS, QUE PUEDA REALIZAR CUALQUIER PRUEBA

		DEL PANEL DE FORMA SIMULTÁNEA. PUNTO: 5 SOLICITAMOS QUE LOS RESULTADOS CUANTITATIVOS SEAN POR LO MENOS EN 5 MIN. YA ES UN TIEMPO CORTO Y LOS RESULTADOS SE REPORTARAN EN TIEMPO Y FORMA CON LA MÁS ALTA CALIDAD, DE IGUAL FORMA SOLICITAMOS SE PUEDAN REALIZAR LAS PRUEBAS EN FORMA INDEPENDIENTE PARA EVITAR ARRASTRES DE LA MUESTRA YA QUE LA ORINA DE LA MICROALBUMINA NO ES COMPATIBLE CON LA SANGRE TOTAL DE LA HBA1V. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>FAVOR DE REFERIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NO. 23</b>
<b>125</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO 1 QUIMICA CLINICA DE ALTO RENDIMIENTO</b>
	<b>PREGUNTA</b>	CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: PUNTO: 11 SOLICITAN: QUE REQUIERA UN VOLUMEN DE MUESTRA MAXIMO DE 2 A 30 MICROLITROS. ACTUALMENTE LOS INSTRUMENTOS DE QUÍMICA CLÍNICA UTILIZAN MICRO MUESTRAS, Y ES DEPENDIENDO DE CADA CASA COMERCIAL, POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTEN INSTRUMENTOS CON UN VOLUMEN DE MUESTRA ENTRE 3 Y 40UL, LO CUAL SIGUE SIENDO UN VOLUMEN PEDIÁTRICO, Y PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN NO CERRANDO LAS ESPECIFICACIONES. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.</b>
<b>126</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO 1 QUIMICA CLINICA DE ALTO RENDIMIENTO</b>
	<b>PREGUNTA</b>	CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: PUNTO: 12 CAPACIDAD DE PROGRAMACION DE POR LO MENOS 96 REACTIVOS ABORDO EN LA PRESENTE LICITACIÓN SE SOLICITAN 39 ANALITOS, POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTE INSTRUMENTO CON POR LO MENOS 60 REACTIVOS ABORDO, YA QUE CON ESTA CANTIDAD DE REACTIVOS SE CUBRE EL MENÚ SOLICITADO, AUNADO A ESTO LA ESPECIFICACIÓN DE 96 REACTIVOS ABORDO ES UNA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PROPIA DEL INSTRUMENTO DE LA MARCA IL MODELO ILAB TAURUS, LA CUAL JUNTO CON OTRAS CARACTERÍSTICAS SE PUEDEN OBSERVAR EN EL FOLLETO DE ESTE INSTRUMENTO, TAL CUAL APARECEN EN ESTAS BASES, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.</b>
<b>127</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO 1 QUIMICA CLINICA DE ALTO RENDIMIENTO</b>
	<b>PREGUNTA</b>	CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: PUNTO: 16 LINEALIDAD EXTENDIDA EN PRUEBAS ENZIMATICAS. PARA EVITAR QUE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN EN LOS INSTRUMENTOS NO TENGAN NINGUNA DESVIACIÓN DE LA REALIDAD, CADA INSTRUMENTO CUENTA CON UNA LINEALIDAD DE REACTIVOS ADECUADA PARA EL REPORTE DE LOS RESULTADOS, EL AUMENTAR LA LINEALIDAD DE LAS PRUEBAS MEDIANTE EL INSTRUMENTO PUEDE LLEGAR A OCASIONAR ERRORES AL REPORTAR LOS RESULTADOS, POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTEN LAS LINEALIDADES DE CADA CASA COMERCIAL CON EL COMPROMISO DE ENTREGAR LA CANTIDAD DE REACTIVO NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DEL 100% DE LOS ANALITOS SOLICITADOS, ADEMÁS DE QUE ESTA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CORRESPONDE AL INSTRUMENTO DE LA MARCA IL MODELO ILAB TAURUS, LA CUAL PUEDEN OBSERVAR EN EL FOLLETO DEL MISMO. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.</b>
<b>128</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO 1 QUIMICA CLINICA DE ALTO RENDIMIENTO</b>
	<b>PREGUNTA</b>	CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: PUNTO 17: LAS CELDAS DE REACCION CON TEMPERATURA DE INCUBACION POR AGUA A 37+- 1°C LOS

		INSTRUMENTOS DE PUNTA YA NO CUENTAN CON ESTE TIPO DE INCUBACIÓN YA QUE REQUIEREN DE UN MANTENIMIENTO MINUCIOSO, ADEMÁS DE SOLUCIONES PARA EVITAR EL CRECIMIENTO DE HONGOS Y DESARROLLO DE BACTERIAS, POR LO CUAL SOLICITAMOS SE ACEPTE UN INSTRUMENTO SIN NINGÚN TIPO DE MANTENIMIENTO Y SIN CONTAMINACIONES, AHORRANDO TIEMPO DE MANTENIMIENTO DEL USUARIO. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA.</b>
<b>129</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO 2 QUIMICA CLINICA MEDIANO RENDIMIENTO:</b>
	<b>PREGUNTA</b>	RENDIMIENTO: RENDIMIENTO 400 PRUEBAS FOTOMETRICAS/HORA Y 400 PRUEBAS ISE / HORA LA VELOCIDAD INDICADA EN LA PRESENTE LICITACIÓN CORRESPONDE EXACTAMENTE COMO LO INDICA EL FOLLETO DEL INSTRUMENTO DE LA MARCA IL MODELO ILAB 650, POR LO QUE PARA CUMPLIR CON LA LEY DE TRANSPARENCIA SOLICITAMOS SE PUEDAN ACEPTAR INSTRUMENTOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS Y CON UNA VELOCIDAD DE POR LO MENOS 900 PRUEBAS POR HORA INDEPENDIEMENTE DE LA MEZCLA DE PRUEBAS FOTOMÉTRICAS Y ELECTROLITOS, CON ESTA CARACTERÍSTICA SE GARANTIZA LA ENTREGA DE RESULTADOS CON CALIDAD Y EN TIEMPO Y FORMA. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE.</b>
<b>130</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO 2 QUIMICA CLINICA MEDIANO RENDIMIENTO:</b>
	<b>PREGUNTA</b>	PARAMETROS A MEDIR: PRUEBAS ADICIONALES: IGE SOLICITAMOS ESTAS PRUEBAS PUEDAN SER REALIZADAS EN EL INSTRUMENTO DE INMUNOLOGÍA YA QUE LA METODOLOGÍA QUE USAN ESTOS INSTRUMENTOS ES MÁS PRECISA Y EXACTA, QUE LA METODOLOGÍA DE TURBIDIMETRIA QUE USAN LOS INSTRUMENTOS DE QUÍMICA CLÍNICA. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES</b>
<b>131</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO 2 QUIMICA CLINICA MEDIANO RENDIMIENTO:</b>
	<b>PREGUNTA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:</b> PUNTO: 3 CON 98 REACTIVOS ABORDO REFRIGERADOS. EN LA PRESENTE LICITACIÓN SE SOLICITAN 34 ANALITOS, POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTE INSTRUMENTO CON POR LO MENOS 60 REACTIVOS ABORDO, YA QUE CON ESTA CANTIDAD DE REACTIVOS SE CUBRE EL MENÚ SOLICITADO, AUNADO A ESTO LA ESPECIFICACIÓN DE 98 REACTIVOS ABORDO ES UNA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PROPIA DEL INSTRUMENTO DE LA MARCA IL MODELO ILAB 650, LA CUAL JUNTO CON OTRAS CARACTERÍSTICAS SE PUEDEN OBSERVAR EN EL FOLLETO DE ESTE INSTRUMENTO, TAL CUAL APARECEN EN ESTAS BASES, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.</b>
<b>132</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO 2 QUIMICA CLINICA MEDIANO RENDIMIENTO:</b>
	<b>PREGUNTA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:</b> PUNTO: 5 RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 340 A 850 NANOMETROS. LOS RANGOS DE LONGITUD DE ONDA DEPENDEN DE CADA CASA COMERCIAL, SIN EMBARGO LOS ANALITOS QUE SOLICITAN EN ESTA LICITACIÓN SE DETERMINAN EN UN RANGO DE 340 A 700 NM, PARA QUE LA PRESENTE LICITACIÓN NO SEA EXCLUYENTE SOLICITAMOS SE ACEPTE INSTRUMENTO QUE CUENTE CON EL RANGO DE LONGITUD DE ONDA NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ANALITOS SOLICITADOS, CON EL OBJETIVO DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.</b>
<b>133</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO 2 QUIMICA CLINICA MEDIANO RENDIMIENTO:</b>

	<b>PREGUNTA</b>	CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: PUNTO: 6 SISTEMA FOTOMETRICO CON 12 LONGITUDES DE ONDA COMO MINIMO. IGUAL QUE EN EL PUNTO ANTERIOR ESTA ESPECIFICACIÓN DEPENDE DE CADA CASA COMERCIAL, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE SE ACEPTEN INSTRUMENTOS CON SISTEMA FOTOMÉTRICO CON LAS LONGITUDES DE ONDA NECESARIOS PARA REALIZAR LAS DETERMINACIONES SOLICITADAS, CON ESTO NO SE LIMITARÍA LA PARTICIPACIÓN DE LOS OFERTANTES. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.</b>
<b>134</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO 2 QUIMICA CLINICA MEDIANO RENDIMIENTO:</b>
	<b>PREGUNTA</b>	CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: PUNTO: 15 CARRUSELL DE MUESTRAS CON 75 POSICIONES INCLUYENDO POSICIONES PARA URGENCIAS. LOS INSTRUMENTOS CON TECNOLOGÍA DE PUNTA CUENTAN CON CARGA DE MUESTRAS CONTINUAS, HACIENDO LA CARGA DE MUESTRAS SIN FIN, ADEMÁS DE COLOCAR LAS URGENCIAS EN CUALQUIER MOMENTO DÁNDOLES PRIORIDAD DE PROCESO, POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTEN INSTRUMENTOS CON CARGA CONTINUA Y 96 PRUEBAS EN TOTAL. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LOS SOLICITADO EN LAS BASES</b>
<b>135</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO 2 QUIMICA CLINICA MEDIANO RENDIMIENTO:</b>
	<b>PREGUNTA</b>	CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: PUNTO: 19 EN POSICION DE REPOSO (STANDBY) NO CONSUME REACTIVOS NI AGUA NI OTRAS SUBSTANCIAS. LOS ELECTROLITOS POR ION SELECTIVO QUE ES EL ESTÁNDAR DE ORO REQUIERE DE CALIBRACIONES CADA 24 HRS, SOLICITAMOS PARA ESTAS PRUEBAS SE ACEPTE EL CONSUMO DE REACTIVOS PARA LA CALIBRACIÓN CON EL COMPROMISO DE ENTREGAR EL REACTIVO NECESARIO PARA PROCESAR EL NÚMERO TOTAL DE PRUEBAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.</b>

**SINAPSIS BENEDETTO, S.A. DE C.V.**

<b>136</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO. 5 BIOMETRÍA HEMÁTICA MEDIANO RENDIMIENTO</b>
	<b>PREGUNTA</b>	/ CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO / PUNTO 5 / SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL YA QUE EL VOLUMEN DE TRABAJO DE LOS LABORATORIOS PARA ESTE NIVEL DE INSTRUMENTO, ES SUFICIENTE UN INSTRUMENTO SIN ESTA CARACTERÍSTICA.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE</b>
<b>137</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO. 8 COAGULÓMETRO BAJO RENDIMIENTO</b>
	<b>PREGUNTA</b>	/ PROCESAMIENTO DE DATOS / SOLICITAN QUE EL ANALIZADOR PERMITA LA INTERFAZ AL SOFTWARE PRINCIPA DEL LABORATORIO, INTERFAZ BIDIRECCIONAL, PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA INTERFAZ BIDIRECCIONAL, PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA INTERFAZ / SIN EMBARGO LOS EQUIPOS DE ESTE NIVEL NO PRESENTAN CAPACIDAD DE INTERFAZ, POR LO QUE SOLICITAMOS SEA UNA CARACTERÍSTICA OPCIONAL.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES</b>
<b>138</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>ANEXO C-1 DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA (CETS) EQUIPO NO 1. BIOMETRÍA HEMÁTICA</b>

	<b>PREGUNTA</b>	/ CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO / 5 AUTOMUESTREADOR Y PERFORADOR AUTOMÁTICO DEL TAPÓN DE HULE DEL TUBO DE RECOLECCIÓN DE SANGRE O UNIDAD DE MUESTREO AUTOMÁTICO CON AGITADOR / SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR UN ANALIZADOR SIN AUTOMUESTREADOR NI PERFORADOR YA QUE DE ACUERDO AL VOLUMEN DE TRABAJO DIARIO ES SUFICIENTE UN INSTRUMENTO CON SISTEMA DE TOMA DE TUBO ABIERTO SIN AUTOCARGADOR.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA.</b>
139	<b>REFERENCIA</b>	EQUIPO NO. 9 DE URIANALISIS ALTO RENDIMIENTO.
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAN, EQUIPO CON METODOLOGÍA DE LECTURA FOTOMÉTRICAS CON LUZ MONOCROMÁTICA CON LONGITUD DE ONDA 525 Y 635 NM DETERMINACIÓN DE MÉTODO FOTOELÉCTRICO (COMPARACIÓN DE COLOR), DADO QUE ESTA ESPECIFICACIÓN PERTENECE AL EQUIPO URISPIN READER U-500 LO CUAL ESTÁ LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y FAVORECIENDO LA LICITACIÓN A OTRA MARCA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA EQUIVALENTE A LA SOLICITADA ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA.</b>
140	<b>REFERENCIA</b>	EQUIPO NO. 9 DE URIANALISIS ALTO RENDIMIENTO.
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAN, CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO CON CAPACIDAD DE ALMACENAR 2000 RESULTADOS EN MEMORIA, CAPACIDAD DE DESECHO HASTA DE 150 TIRAS Y OPCIÓN DE REPORTE EN SÍMBOLOS DADO QUE ESTAS ESPECIFICACIONES PERTENECEN AL EQUIPO URISPIN READER U-500 LO CUAL ESTÁ LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y FAVORECIENDO LA LICITACIÓN A OTRA MARCA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA EQUIVALENTE A LA SOLICITADA ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, APEGARE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.</b>
141	<b>REFERENCIA</b>	EQUIPO NO. 10 DE URIANALISIS ALTO RENDIMIENTO.
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAN, EQUIPO CON METODOLOGÍA DE LECTURA FOTOMÉTRICAS CON LUZ MONOCROMÁTICA CON LONGITUD DE ONDA 525 Y 635 NM DETERMINACIÓN DE MÉTODO FOTOELÉCTRICO (COMPARACIÓN DE COLOR), CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE 120 MUESTRAS /HORAS EN MODO CONTINUO O 60 MUESTRAS EN HORA EN MODO SIMPLE DADO QUE ESTA ESPECIFICACIÓN PERTENECE AL EQUIPO URISPIN READER U-120 LO CUAL ESTÁ LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y FAVORECIENDO LA LICITACIÓN A OTRA MARCA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA EQUIVALENTE A LA SOLICITADA ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA.</b>
142	<b>REFERENCIA</b>	EQUIPO NO. 10 DE URIANALISIS ALTO RENDIMIENTO.
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAN, CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO CON CAPACIDAD DE ALMACENAR 2000 RESULTADOS EN MEMORIA, PANTALLA LCD TOUCH SCREEN DADO QUE ESTAS ESPECIFICACIONES PERTENECEN AL EQUIPO URISPIN READER U-120 LO CUAL ESTÁ LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y FAVORECIENDO LA LICITACIÓN A OTRA MARCA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA TECNOLOGÍA EQUIVALENTE A LA SOLICITADA ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.</b>
143	<b>REFERENCIA</b>	EQUIPO NO 3. SEROLOGIA RENDIMIENTO CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE MÍNIMO 200 PRUEBAS POR HORA TENER CAPACIDAD DE MANEJO DE URGENCIAS, SIN AFECTAR

		LA RUTINA DE TRABAJO.
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE 180 PRUEBAS POR HORA SIN QUE SE VEA AFECTADA SU PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD EN LAS MUESTRAS. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES</b>
144	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO B-1, DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS. EQUIPO NO.11 GASOMETRÍA.
	<b>PREGUNTA</b>	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO, INCISO 6. DADO QUE TODAS LAS METODOLOGÍAS DISPONIBLES EN EL MERCADO, TIENEN INTERFERENCIAS EN LA MEDICIÓN POR LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS EN LA MUESTRA Y A QUE EL TIPO Y GRADO DE INTERFERENCIA ES ESPECÍFICO PARA CADA METODOLOGÍA, AUN EN AQUELLOS ANALIZADORES QUE PUEDAN IDENTIFICARLA SOLO ALGUNAS DE ELLAS. POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUBRIR ESTE PUNTO NOS PERMITA HACER REFERENCIA A LAS INTERFERENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MARCA Y MODELO DE EQUIPO PROPUESTO. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.</b>
145	<b>REFERENCIA</b>	EN ANEXO 1 PARTIDA NO. 112
	<b>PREGUNTA</b>	/ PRUEBA REAL CANTIDAD 7800 SANGRE TOTAL SEGURA PROCESADA/ SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿CUÁNTA BOLSA PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE TRIPLE SE UTILIZARÁ EN ESTA PARTIDA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>APROXIMADAMENTE EL 30 %</b>
146	<b>REFERENCIA</b>	EN ANEXO 1 PARTIDA NO. 112
	<b>PREGUNTA</b>	/PRUEBA REAL, CANTIDAD 7800 SANGRE TOTAL SEGURA PROCESADA/ SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿CUÁNTA BOLSA PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CUÁDRUPLE SE UTILIZARÁ EN ESTA PARTIDA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>APROXIMADAMENTE EL 70 %</b>
147	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO C-1. DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA CETS.
	<b>PREGUNTA</b>	/INCISO I. "ADEMÁS DEBERÁ INCLUIR EN LA PROPUESTA LOS SIGUIENTES COMPONENTES/ SOLICITAN LA CANTIDAD DE 4 FRACCIONADOR AUTOMATIZADO PARA HEMOCOMPONENTES.  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA COLOCAR LA CANTIDAD NECESARIA DE SISTEMAS FRACCIONADORES DE ACUERDO AL RENDIMIENTO DE CADA EQUIPO Y A LAS NECESIDADES DEL CETS.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES.</b>
148	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO C-1. DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA CETS.
	<b>PREGUNTA</b>	/INCISO I. "ADEMÁS DEBERÁ INCLUIR EN LA PROPUESTA LOS SIGUIENTES COMPONENTES/ SOLICITAN CENTRIFUGA SEROFUGE CANTIDAD 3 PARA EL CETS.  SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR 3 CENTRIFUGAS PARA BANCO DE SANGRE DE DIFERENTE MARCA. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.</b>
149	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO C-1. DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA CETS.
	<b>PREGUNTA</b>	/INCISO I. "ADEMÁS DEBERÁ INCLUIR EN LA PROPUESTA LOS SIGUIENTES

		COMPONENTES/ SOLICITAN 1 CONECTOR DE TUBERÍA ESTÉRIL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME ¿CUANTAS CONEXIONES ESTÉRILES SE TIENE PROGRAMADO REALIZAR EN ESTA LICITACIÓN?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>2000</b>
<b>150</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>ANEXO B2 SISTEMA INFORMATICO RED DE LABORATORIOS</b>
	<b>PREGUNTA</b>	EN LAS "ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA INFORMATICO" EN EL APARTADO VI, DICE: "MANEJADOR DE BASE DE DATOS ORACLE". PREGUNTA: ¿SE REFIEREN A BASE DE DATOS RELACIONAL? EN CASO AFIRMATIVO, ¿SE PUEDE OFERTAR SQL? DADO QUE ORACLE ES UNA MARCA REGISTRADA.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.</b>
<b>151</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO 1 QUIMICA CLINICA DE ALTO RENDIMIENTO</b>
	<b>PREGUNTA</b>	METODOLOGIA: ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA REALIZAR PRUEBAS DE QUIMICA CLINICA COLORIMETRICAS, ESPECTROFOTOMETRICAS, DE PUNTO FINAL Y CINETICAS, ION SELECTIVO, TURBIDIMETRIA, QUE DETECTE COAGULOS, CON AREA REFRIGERADA PARA LA COLOCACION DE CONTROLES Y CALIBRADORES. QUE PROCESE SUERO, PLASMA, ORINA Y LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO. PARA EL CASO DEL ÁREA REFRIGERADA PARA LA COLOCACIÓN DE CONTROLES Y CALIBRADORES, SOLICITAMOS SE ACEPTE QUE EL ÁREA REFRIGERADA SEA SOLO PARA LOS REACTIVOS ABORDO, YA QUE LOS CALIBRADORES Y CONTROLES DEBEN TENER UN TRATAMIENTO ESPECIAL Y LA ALÍCUOTA QUE SE USA PARA CALIBRAR O CONTROLES YA NO DEBE SER USADA DESPUÉS DE HABERLOS USADO, CON ESTO SE PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA.</b>
<b>152</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO 1 QUIMICA CLINICA DE ALTO RENDIMIENTO</b>
	<b>PREGUNTA</b>	RENDIMIENTO: 500 PRUEBAS FOTOMETRICAS Y 375 ELECTROLITOS POR HORA O CONTINUA QUE ACEPTE MUESTRAS DE URGENCIA SIN NECESIDAD DE INTERRUMPIR EL PROCESAMIENTO DE RUTINA. LA VELOCIDAD INDICADA EN LA PRESENTE LICITACIÓN CORRESPONDE EXACTAMENTE COMO LO INDICA EL FOLLETO DEL INSTRUMENTO DE LA MARCA IL MODELO ILAB TAURUS, POR LO QUE PARA CUMPLIR CON LA LEY DE TRANSPARENCIA SOLICITAMOS SE PUEDAN ACEPTAR INSTRUMENTOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS Y CON UNA VELOCIDAD DE 900 PRUEBAS POR HORA INDEPENDIEMENTE DE LA MEZCLA DE PRUEBAS FOTOMÉTRICAS Y ELECTROLITOS, CON ESTA CARACTERÍSTICA SE GARANTIZA LA ENTREGA DE RESULTADOS CON CALIDAD Y EN TIEMPO Y FORMA. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PUEDE OFERTAR MÁS DE LO SOLICITADO.</b>
<b>153</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO 1 QUIMICA CLINICA DE ALTO RENDIMIENTO</b>
	<b>PREGUNTA</b>	PARAMETROS A MEDIR: PRUEBAS ADICIONALES: FERRITINA E IGE SOLICITAMOS ESTAS PRUEBAS PUEDAN SER REALIZADAS EN EL INSTRUMENTO DE INMUNOLOGÍA YA QUE LA METODOLOGÍA QUE USAN ESTOS INSTRUMENTOS ES MÁS PRECISA Y EXACTA, QUE LA METODOLOGÍA DE TURBIDIMETRIA QUE USAN LOS INSTRUMENTOS DE QUÍMICA CLÍNICA. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES.</b>
<b>154</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO 1 QUIMICA CLINICA DE ALTO RENDIMIENTO</b>

	<b>PREGUNTA</b>	CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: PUNTO 21: MANTENIMIENTO AUTOMATICO DE INICIO Y CIERRE DE DIA. SOLICITAMOS SE ACEPTE UN INSTRUMENTO CON UN MANTENIMIENTO MÍNIMO DE 5 MIN. DIARIOS CON LO CUAL AYUDA AL USUARIO A COMENZAR SU TRABAJO EN CUALQUIER MOMENTO. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA. EL ENCENDIO Y APAGADO DEL EQUIPO DEBE SER PROGRAMABLE POR EL USUARIO.</b>
<b>155</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO 1 QUIMICA CLINICA DE ALTO RENDIMIENTO</b>
	<b>PREGUNTA</b>	CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: PUNTO: 23 GRADILLA DE 5 POSICIONES CON UNA CARGA CONTINUA DE HASTA 100 MUESTRAS ABORDO. SOLICITAMOS QUE EL INSTRUMENTO CUENTE CON SECTORES DE 4 POSICIONES Y CARGA CONTINUA DE HASTA 96 PRUEBAS DE FLUJO CONTINUO, CON LO CUAL SE CONVIERTE EN UNA CADENA CONTINUA SIN DEJAR DE RECIBIR MUESTRAS EN CUALQUIER MOMENTO. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA BASES.</b>
<b>156</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO 1 QUIMICA CLINICA DE ALTO RENDIMIENTO</b>
	<b>PREGUNTA</b>	SOFTWARE: PUNTO: 6 CON SOFTWARE EN ESPAÑOL AMIGABLE, BAJO AMBIENTE WINDOWS QUE MANEJE DATOS DEL PACIENTE, CON MODULO DE CONTROL DE CALIDAD Y GRAFICA DE LEVEY-JENNINGS. SOLICITAMOS SE ACEPTE INSTRUMENTO CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS Y UN SOFTWARE AMIGABLE PROPIO DEL INSTRUMENTO, CON LO CUAL SE EVITA SE INFECTE POR VIRUS O SE INTRODUZCAN PROGRAMAS NO DESEABLES AL INSTRUMENTO. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.</b>
<b>157</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO 2 QUIMICA CLINICA MEDIANO RENDIMIENTO:</b>
	<b>PREGUNTA</b>	CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: PUNTO: 7 VOLUMEN DE MUESTRA DE 2 A 40 MICROLITROS. ACTUALMENTE LOS INSTRUMENTOS DE QUÍMICA CLÍNICA UTILIZAN MICRO MUESTRAS, Y ES DEPENDIENDO DE CADA CASA COMERCIAL, POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTEN INSTRUMENTOS CON UN VOLUMEN DE MUESTRA ENTRE 3 Y 40UL, LO CUAL SIGUE SIENDO UN VOLUMEN PEDIÁTRICO, Y PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN NO CERRANDO LAS ESPECIFICACIONES. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.</b>
<b>158</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO 2 QUIMICA CLINICA MEDIANO RENDIMIENTO:</b>
	<b>PREGUNTA</b>	CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: PUNTO: 8 VOLUMEN DE REACTIVO DE 20 A 400 MICROLITROS. SOLICITAMOS SE ACEPTE INSTRUMENTO CON VOLUMEN DE REACTIVO DE 200 Y 327 MICROLITOS, CON EL COMPROMISO DE ENTREGAR LA CANTIDAD DE REACTIVO NECESARIA PARA REALIZAR EL NÚMERO TOTAL DE PRUEBAS SOLICITADAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE</b>
<b>159</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO 2 QUIMICA CLINICA MEDIANO RENDIMIENTO:</b>
	<b>PREGUNTA</b>	CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: PUNTO: 10 CUANDO UNA PRUEBA SOBREPASA LOS LIMITES DE LINEALIDAD POR SU ORIGEN PATOLOGICO O DEBIDO A LOS RANGOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS POR EL USUARIO EL EQUIPO REALIZARA AUTOMATICAMENTE LA DILUCION DE ESTA. LAS PROPORCIONES DE DILUCION PODRAN SER DEFINIDAS POR EL USUARIO. SOLICITAMOS SE ACEPTE UN INSTRUMENTO QUE CUANDO UNA PRUEBA SOBREPASA LOS LÍMITES DE LINEALIDAD POR SU ORIGEN PATOLÓGICO O

		DEBIDO A LOS RANGOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS POR EL USUARIO EL EQUIPO REALICE AUTOMÁTICAMENTE LA DILUCIÓN DE ESTA, Y LAS DILUCIONES YA ESTÉN PROGRAMADAS EN EL INSTRUMENTO, CON LO CUAL EL USUARIO AHORRARA TIEMPO AL NO PROGRAMAR LAS DILUCIONES. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA.</b>
<b>160</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO 2 QUIMICA CLINICA MEDIANO RENDIMIENTO:</b>
	<b>PREGUNTA</b>	CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: PUNTO: 20 CON PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO Y PROGRAMABLE. EN LA ACTUALIDAD LOS INSTRUMENTOS DE SE MANTIENEN ENCENDIDOS TODO EL DÍA PARA PODER RESPONDER A LAS URGENCIAS, POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTEN INSTRUMENTOS CON QUE CUENTEN CON LA CAPACIDAD DE MANTENERSE ENCENDIDO PARA CUALQUIER EMERGENCIA, Y EVITAR QUE TARDE EL REINICIO CUANDO SE PRENDE, LO CUAL RETRASARÍA LA ENTREGA DE RESULTADOS. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA. EL ENCENDIO Y APAGADO DEL EQUIPO DEBE SER PROGRAMABLE POR EL USUARIO.</b>
<b>161</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO. 3 QUIMICA CLINICA BAJO RENDIMIENTO:</b>
	<b>PREGUNTA</b>	<p>DESCRIPCION TECNICA DEL ANALIZADOR:                      TIPO:                      SISTEMA AUTOMATIZADO PARA DETERMINAR PRUEBAS DE QUIMICA CLINICA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS UNIDADES MEDICAS, DE MODALIDAD QUIMICA SECA. ESTAS CARACTERÍSTICAS SON LIMITATIVAS EN ESTE PROCESO LICITATORIO, YA QUE SE FAVORECE A UNA MARCA COMERCIAL, LA CUAL ES OCD ANTERIORMENTE J&amp;J, POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTEN INSTRUMENTOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>CAPACIDAD DE 30 REACTIVOS A BORDO.                      TÉCNICAS DE ANÁLISIS: COLORIMÉTRICAS, ENZIMÁTICAS O TURBIDIMÉTRICAS.                      DETERMINACIONES: GLU, UREA, CREATININA, AC. ÚRICO, COL, TRI, HDL, LDL, BILI, TGO, TGP. PT, ALB, LDH, CPK, CPK MB, FOF AL, AMI.                      RANGO DE LONGITUD DE ONDA MÍNIMO DE 340 A 800 NANÓMETROS.                      SISTEMA FOTOMÉTRICO CON 12 LONGITUDES DE ONDAS FIJAS E INTERMEDIAS.                      SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PARA CONSERVACIÓN DE REACTIVO CON 30 POSICIONES, INTEGRADO EN EL EQUIPO.                      CAPACIDAD DE ENSAYO DE 240 PRUEBAS POR HORA.                      VOLUMEN DE MUESTRA DE 30 µL.                      CAPACIDAD DE EFECTUAR LA DILUCIÓN PREVIO DE LA MUESTRA EN CASO DE REQUERIRSE.                      LIMPIEZA AUTOMATICA DE AGUJAS Y CUBETAS DE REACCION                      ACEPTA TUBOS PRIMARIO, COPA Y COPILLA PEDIÁTRICA.                      CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA Y SISTEMA QUE ACEPTA MUESTRAS DE URGENCIAS Y CAPACIDAD DE ACCESO ALEATORIO.                      SISTEMA DE MEZCLADO AUTOMATICO SIN CONTACTO DIRECTO CON LA MEZCLA REACTIVA                      BAÑO DE INCUBACIÓN EN SECO, CON CONTROL DE TEMPERATURA A 37 °C.                      CARRUSEL PARA 40 MUESTRAS, INCLUYENDO 5 POSICIONES PARA URGENCIAS.                      CUBETAS DE REACCION DE PLASTICO SEMI PERMANENTES, CON UNIDAD DE LAVADO ABORDO.</p>

		<p>VOLUMEN DE REACTIVO DE 340 UL                  SENSOR DE NIVEL DE MUESTRA                  SENSOR DE NIVEL DE REACTIVO                  CONTROL DE CALIDAD CON GRÁFICAS DE LEVEY JENNIGS, Y CON CRITERIOS WESTGARD INTEGRADO.                  CONSUMO DE AGUA DE 3.5 LITROS POR HORA                  SOFTWARE EN ESPAÑOL.                  MONITOR E IMPRESORA ADICIONAL.                  REGULADOR, NO BREAK.                  CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ.</p> <p>CON LOS BENEFICIOS DE OBTENER RESULTADOS CON LA CALIDAD REQUERIDA POR EL INSTITUTO EN TIEMPO Y FORMA.                  R= SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER ESTAS CARACTERÍSTICAS LIMITATIVAS A OTRA OFERTAS. ¿SE ACEPTA?</p>
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES</b>

**MEDICA CONSULTORA, S.A. DE C.V.**

<b>162</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO. 5 BIOMETRÍA HEMÁTICA MEDIANO RENDIMIENTO</b>
	<b>PREGUNTA</b>	/ CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO / PUNTO 7 / SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL YA QUE EL VOLUMEN DE TRABAJO DE LOS LABORATORIOS PARA ESTE NIVEL DE INSTRUMENTO, ES SUFICIENTE UN INSTRUMENTO SIN ESTA CARACTERÍSTICA.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.</b>
<b>163</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO. 6 COAGULÓMETRO ALTO RENDIMIENTO</b>
	<b>PREGUNTA</b>	/ METODOLOGÍA / COAGULOMETRO-NEFELOMÉTRICO LECTURA DE FORMACIÓN DEL COAGULO A 90 GRADOS INMUNOTURBIDIMÉTRICO, COAGULOMÉTRICO, ELECTROMAGNÉTICO CROMOGENICO / ESTA ESPECIFICACIÓN ES ESPECÍFICA DE LOS EQUIPOS DE LA MARCA IL, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SOLICITAMOS SEA UNA ESPECIFICACIÓN OPCIONAL
	<b>RESPUESTA</b>	<b>APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.</b>
<b>164</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO. 7 COAGULÓMETRO MEDIANO RENDIMIENTO</b>
	<b>PREGUNTA</b>	/ METODOLOGÍA / REALIZA 1100 PUNTOS DE LECTURA POR CADA DETERMINACIÓN / ESTA ESPECIFICACIÓN ES ESPECÍFICA DE LOS EQUIPOS DE LA MARCA IL, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SOLICITAMOS SEA UNA ESPECIFICACIÓN OPCIONAL.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APAGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.</b>
<b>165</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO. 7 COAGULÓMETRO MEDIANO RENDIMIENTO</b>
	<b>PREGUNTA</b>	/ RENDIMIENTO / CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE 175 TP O 115 TTPA POR HORA / SOLICITAMOS NOS SEA ACEPTADA UNA VELOCIDAD DE 60 PRUEBAS POR HORA ACORDE A LA CARGA DE TRABAJO DE LOS LABORATORIOS SOLICITANTES DE ESTE NIVEL DE EQUIPO.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.</b>
<b>166</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO. 7 COAGULÓMETRO MEDIANO RENDIMIENTO</b>
	<b>PREGUNTA</b>	/ CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO / 1 DETECCIÓN DEL COAGULO POR NEFELOMETRÍA / ESTA ESPECIFICACIÓN ES ESPECÍFICA DE LOS EQUIPOS DE LA MARCA IL, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SOLICITAMOS SEA UNA ESPECIFICACIÓN OPCIONAL
	<b>RESPUESTA</b>	<b>APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.</b>

167	REFERENCIA	EQUIPO NO. 8 COAGULÓMETRO BAJO RENDIMIENTO
	PREGUNTA	/ METODOLOGÍA / LECTURA POR ABSORBANCIA, PUNTO FINAL, METODOS CINÉTICO ALGORITMOS COAGULOMÉTRICOS / ESTA ESPECIFICACIÓN ES ESPECÍFICA DE LOS EQUIPOS DE LA MARCA IL MODELO CL ANALYSER, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SOLICITAMOS SEA UNA ESPECIFICACIÓN OPCIONAL
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE
168	REFERENCIA	EQUIPO NO. 8 COAGULÓMETRO BAJO RENDIMIENTO
	PREGUNTA	/ CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO / CON 3 CANALES DE LECTURA 2 PARA TP Y APTT A 630NM, 1 PARA PRUEBAS CROMOGÉNICAS E INMUNOLÓGICAS A 405 / ESTA ESPECIFICACIÓN ES ESPECÍFICA DE LOS EQUIPOS DE LA MARCA IL, LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SOLICITAMOS SEA UNA ESPECIFICACIÓN OPCIONAL
	RESPUESTA	APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.
169	REFERENCIA	EQUIPO NO.14 DE BACTERIOLOGIA
	PREGUNTA	SOLICITAN CAPACIDAD PARA LEER PLACAS DE 96 POZOS CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR PLACAS AL TERMINO EQUIVALENTE EN EL MERCADO EL CUAL ES TARJETA PRUEBAS BIOQUÍMICAS. ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE REFIERE A PANELES SOLAMENTE.
170	REFERENCIA	EQUIPO NO.15 HEMOCULTIVOS
	PREGUNTA	EN REFERENCIA A LA PARTIDA 15 HEMOCULTIVOS SOLICITAN SISTEMA CON DETECCIÓN A TRAVÉS DEL CAMBIO DE PRESIÓN DE GASES EN EL ESPACIO SUPERIOR DE LAS BOTELLAS, ESTA CARACTERÍSTICA CORRESPONDE EN ESPECÍFICO A UNA SOLA CASA COMERCIAL EN EL MERCADO ESPECÍFICAMENTE AL SISTEMA AUTOMATIZADO VERSÁTIL PARA LA DETECCIÓN DE CRECIMIENTO MICROBIANO VERSATREK DE IL, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y ABRIR LA PRESENTE LICITACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA CON DETECCIÓN DE CRECIMIENTO BACTERIANO POR LA PRODUCCIÓN DE CO2 EN EL MEDIO EQUIVALENTE AL SOLICITADO ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.
171	REFERENCIA	EQUIPO NO.15 HEMOCULTIVOS
	PREGUNTA	EN REFERENCIA A LA PARTIDA 15 HEMOCULTIVOS SOLICITAN SISTEMA DE AGITACIÓN VORTEXING ESTA CARACTERÍSTICA CORRESPONDE EN ESPECÍFICO A UNA SOLA CASA COMERCIAL EN EL MERCADO ESPECÍFICAMENTE AL SISTEMA AUTOMATIZADO VERSÁTIL PARA LA DETECCIÓN DE CRECIMIENTO MICROBIANO VERSATREK DE IL, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y ABRIR LA PRESENTE LICITACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DE AGITACIÓN EQUIVALENTE AL SOLICITADO ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.
172	REFERENCIA	EQUIPO NO.15 HEMOCULTIVOS
	PREGUNTA	EN REFERENCIA A LA PARTIDA 15 HEMOCULTIVOS SOLICITAN CONECTOR CON MEMBRANA HIDROFÓBICA , ESTA CARACTERÍSTICA CORRESPONDE EN ESPECÍFICO A UNA SOLA CASA COMERCIAL EN EL MERCADO ESPECÍFICAMENTE AL SISTEMA AUTOMATIZADO VERSÁTIL PARA LA DETECCIÓN DE CRECIMIENTO MICROBIANO VERSATREK DE IL, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y ABRIR LA PRESENTE LICITACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE ,COLOCAR

		COMO OPCIONAL ESTA CARACTERÍSTICA Y NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA QUE NO REQUIERA DE CONECTORES ADICIONALES ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, APEGARE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.</b>
<b>173</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO.15 HEMOCULTIVOS</b>
	<b>PREGUNTA</b>	EN REFERENCIA A LA PARTIDA 15 HEMOCULTIVOS SOLICITAN QUE NO REQUIERA UTILIZAR COMPONENTES FLUORESCENTES, CILINDROS DE CALIBRACIÓN, NI ESTÁNDARES DE REFLECTANCIA QUE EMPLEE MÉTODO DE INACTIVACIÓN DE ANTIBIÓTICOS POR DILUCIÓN, ESTAS CARACTERÍSTICAS CORRESPONDEN EN ESPECÍFICO A UNA SOLA CASA COMERCIAL EN EL MERCADO ESPECÍFICAMENTE AL SISTEMA AUTOMATIZADO VERSÁTIL PARA LA DETECCIÓN DE CRECIMIENTO MICROBIANO VERSATREK DE IL, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y ABRIR LA PRESENTE LICITACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE ,NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA CON COMPONENTES CROMOGENICOS Y CON UN MÉTODO DE INACTIVACIÓN DE ANTIBIÓTICOS A TRAVÉS DE PERLAS POLIMÉRICAS ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.</b>
<b>174</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>ANEXO B-1, DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS. EQUIPO NO.11 GASOMETRÍA.</b>
	<b>PREGUNTA</b>	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO, INCISO 7. CONSIDERANDO QUE EL INSTITUTO CONTARÁ CON UN SISTEMA INFORMÁTICO CON UNA CAPACIDAD ILIMITADA DE ALMACENAMIENTO, AL CUAL SE INTERFASARÁN LOS ANALIZADORES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUBRIR ESTE PUNTO SE NOS PERMITA REFERENCIAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL ANALIZADOR OFERTADO. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.</b>
<b>175</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>ANEXO B-1, DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS. EQUIPO NO.11 GASOMETRÍA.</b>
	<b>PREGUNTA</b>	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO, INCISO 8. CON EL OBJETO DE QUE LA CONVOCANTE SE BENEFICIE AL RECIBIR UNA MAYOR CANTIDAD DE PROPUESTAS Y CON ELLO SE FAVOREZCA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN ANALIZADOR QUE UTILICE ELEMENTOS DESECHABLES DE ELECTRODOS/SENSORES QUE NO REQUIEREN MANTENIMIENTOS DIARIOS, TIENEN VIDAS OPERATIVAS PROLONGADAS Y SE PUEDEN REEMPLAZAR EN SEGUNDOS. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA.</b>
<b>176</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>ANEXO B-1, DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS. EQUIPO NO.11 GASOMETRÍA.</b>
	<b>PREGUNTA</b>	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO, INCISO 14. ENTENDEMOS QUE PARA MANTENER UN CORRECTO CONTROL DE CALIDAD DE ACUERDO A LINEAMIENTOS INTERNACIONALES, LA CONVOCANTE ACEPTARÁ UN ANALIZADOR QUE CUENTE CON CONTROL DE CALIDAD AUTOMÁTICO QUE GENERE INFORMES ESTADÍSTICOS, GRÁFICAS DE LEVEY-JENNINGS Y QUE EJECUTE CUALQUIER NIVEL DE MANERA PRE-PROGRAMADA O BAJO SOLICITUD. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.</b>
<b>177</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>ANEXO C-1. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA CETS. EQUIPO NO. 5 EQUIPO DE AFERESIS</b>
	<b>PREGUNTA</b>	/ TIPO / SOLICITAN EQUIPO PARA PROCEDIMIENTO DE AFERESIS DE UNA SOLA VIA (UNIPUNCIÓN) SISTEMA DE AFERESIS DE FLUJO CONTINUO PARA LA COLECCIÓN DE PLAQUETAS Y PLASMA LEUCORREDUCIDOS Y

		CONCENTRADO ERITROCITARIO EN UNIPUNCIÓN.  SOLICITAMOS NOS PERMITA EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS DE AFERESIS DE UNA SOLA VIA (UNIPUNCIÓN), PARA LA COLECCIÓN DE PLAQUETAS, PLASMA Y CELULAS MONONUCLEARES. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO.</b>
176	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO C-1. DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA CETS. EQUIPO NO 6 SELLADOR
	<b>PREGUNTA</b>	/CARACTERISTICAS DE EQUIPO/ SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR SELLADOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE MESA PARA TUBOS PVC DE GRADO MEDICO CON REGULACION AUTOMATICA DE TIEMPO DE SELLADO Y DE POTENCIA EMITIDA. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.</b>
177	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO C-1. DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA CETS.
	<b>PREGUNTA</b>	/INCISO I. "ADEMÁS DEBERÁ INCLUIR EN LA PROPUESTA LOS SIGUIENTES COMPONENTES/ SOLICITAN 1 CONECTOR DE TUBERÍA ESTÉRIL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL CONECTOR DE TUBERÍA ESTÉRIL QUE SOLICITAN DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: EQUIPO PARA REALIZAR CONEXIONES DE TUBERÍA DE PVC EN CONDICIONES DE ESTERILIDAD DE SEGUNDA GENERACIÓN. CON PANTALLA LCD QUE PROPORCIONA INFORMACIÓN DEL EQUIPO Y SUGERENCIA DE OPERACIÓN COMO: CAMBIO DE LÁMINA O NAVAJA, TOTAL DE CONEXIONES, PRÓXIMO MANTENIMIENTO, SELLADO TERMINADO, ABRIR LA PINZA, CASETE VACIO, INSERTAR CASETE CON LÁMINAS. PANEL DE CONTROL AMIGABLE AL USUARIO, FÁCIL DE USAR, EL CAMBIO DE LÁMINA ES REEMPLAZADO AUTOMÁTICAMENTE DESPUÉS DE CADA UNIÓN PARA SEGURIDAD Y COMODIDAD LAS LÁMINAS USADAS SON ELIMINADAS DE FORMA AUTOMÁTICA EN UNA CAJA INTEGRADA AL EQUIPO QUE TIENE UN MONITOR DE SENSOR INTEGRADO QUE MIDE LA OCUPACIÓN DE LA CAJA EN CADA MOMENTO Y DE ESTA MANERA SOLICITA VACIAR LA MISMA ANTES DE QUE SE LLENE, ACEPTA CUALQUIER TUBERÍA CON DIÁMETRO INTERNO DE 2.9 A 3.1 MM Y DIÁMETRO EXTERNO DE 3.9 A 4.5 MM COMPACTO Y LIVIANO (18.4CM X 13.9CM X 27.6CM) (5.5 KG) PORTÁTIL. CON ALARMAS AUDIBLE PARA AVISAR EN CASO DE UN PROBLEMA DEL CERRADO DEL CLAMP.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITATIVO.</b>
178	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO C-2. SISTEMA INFORMATICO CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA
	<b>PREGUNTA</b>	/ESPECIFICACIONES MINIMAS DEL SISTEMA INFORMATICO/ SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DE BANCO DE SANGRE CON DIFERENTES CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS DE SOFTWARE Y HARDWARE EN BASES PERO QUE CUMPLE PARA SER UTILIZADO EN LOS PROCESOS DE BANCO DE SANGRE ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>APEGARSE A LOS SOLICITADO EN LAS BASES.</b>
179	<b>REFERENCIA</b>	EQUIPO NO.12 INMUNOLOGÍA Y MARCADORES TUMORALES.
	<b>PREGUNTA</b>	ESTÁN SOLICITANDO EQUIPO NO.12 INMUNOLOGÍA Y MARCADORES TUMORALES. CARACTERÍSTICAS SIN EMBARGO ESTAS CARACTERÍSTICAS SON ESPECIFICAS DEL MODELO DE EQUIPO ARCHITECT I2000 DE LA MARCA ABBOTT SE ANEXA ILINK <a href="http://www.imex.mx/nosotros/diagnosticos/inmunologia/archite-ct-i2000.html">HTTP://WWW.IMEX.MX/NOSOTROS/DIAGNOSTICOS/INMUNOLOGIA/ARCHITE-CT-I2000.HTML</a> SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS CON LA INTENCIÓN DE PERMITIR LA

4

		<p>LIBRE PARTICIPACIÓN EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATIZADO</p> <p>PRINCIPIO DE DETECCIÓN QUIMIOLUMINISCENCIA REFRIGERACIÓN DE REACTIVOS A BORDO CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 50 MUESTRAS ACCESO ALEATORIO. CARGA CONTINUA TANTO DE REACTIVOS Y MUESTRAS ACEPTE TUBOS, COPAS Y MICROTUBOS EN UN MISMO SECTOR CURVA DE CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA CURVA DE CALIBRACIÓN ESTABLE PROMEDIO 28 DÍAS ACCESO ILIMITADO DE MUESTRAS URGENTES. ACEPTA LA PROGRAMACIÓN DE CUALQUIER PRUEBA Y/O PERFIL EN CUALQUIER MOMENTO LECTURA E IDENTIFICACIÓN DE REACTIVOS Y MUESTRAS POR CÓDIGO DE BARRAS. VELOCIDAD DE PROCESO DE HASTA 90 PRUEBA POR HORA.</p> <p>ESTAS CARACTERÍSTICAS PERMITIRÁN AL MENOS A 3 CASAS COMERCIALES CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES, LO QUE SE REFLEJARA EN UNA PROPUESTA MÁS COMPETITIVA EN BENEFICIO DEL ESTADO. ¿SE ACEPTA?</p>
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, APEGARSE A LA SOLICITADO EN LAS BASES</b>
<b>180</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>EQUIPO NO. 16 PARA MARCADORES CARDIOPULMONARES</b>
	<b>PREGUNTA</b>	<p>ESTÁN SOLICITANDO PARA ESTA PARTIDA UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA MARCA TRIAGE DE IL, <a href="http://www.ildiagnostics.com/#IL--TRIAGE/C11BB">HTTP://WWW.ILDIAGNOSTICS.COM/#IL--TRIAGE/C11BB</a></p> <p>POR LO QUE ESTO PUEDE INTERPRETARSE COMO TENDENCIOSO AL DIRIGIR LA LICITACIÓN A UNA MARCA ESPECIFICA CON EL FIN DE FAVORECERLOS, SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MUESTRAS EN SANGRE TOTAL VENOSA CON ANTICOAGULANTE EDTA, EN MEMORIA QUE ARCHIVE DATOS DE PACIENTES HASTA 500 RESULTADOS CAPACIDAD PARA PROCESAR MINIMO 25 MUESTRAS POR HORA. VOLUMEN DE 150 UL DE MUESTRA TEMPERATURA CONTROLADA EL REACTIVO EN KIT DE 25 PRUEBAS SIN MERMA QUE LOS REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS SEAN DE 120 V. 60 HZ CALIBRACIÓN AUTOMATICA ELECTRONICA CONTROL DE CALIDAD LIBRE DE MANTENIMIENTO PUEDE SER UTILIZADO POR PERONAL NO ESPECIALIZADO RESULTADOS CUANTITATIVOS EN 15 MINUTOS</p> <p>LO QUE PERMITIRÁ AL MENOS QUE TRES CASAS COMERCIALES PUEDAN OFERTAR ESTAS CARACTERÍSTICAS Y DE ESTA MANERA SE HACE PARTICIPACIÓN EQUITATIVA AL NO FAVORECER A NINGUNA CASA COMERCIAL. ¿SE ACEPTA?</p>
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.</b>
<b>181</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>ANEXO B2 SISTEMA INFORMATICO RED DE LABORATORIOS</b>
	<b>PREGUNTA</b>	<p>EN EL APARTADO 53, DE "CODIGO DE BARRAS" DICE "MANEJO DE SEROTECA". PREGUNTA: PARA EL CÓDIGO DE BARRAS, NO ES NECESARIO UNA</p>

		SEROTECA, ¿SE PUDE OFERTAR EL MÓDULO DE SEROTECA PARA ALMACENAMIENTO?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.</b>
<b>182</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>ANEXO B2 SISTEMA INFORMATICO RED DE LABORATORIOS</b>
	<b>PREGUNTA</b>	EN EL APARTADO 70, DE "TRABAJO EN LABORATORIO" DICE "VISUALIZACION EN GRAFICA TIPO PASTEL Y UTILIZANDO CODIGO DE COLORES, EL STATUS DE PROCESAMIENTO DE CADA SECCION, POR EJEMPLO: GRIS - SIN PROCESAR, VERDE - CON RESULTADO, ROJO - BLOQUEADO, AMARILLO - RETENIDO". ESTAS DESCRIPCIONES LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN A UN SOLO PROVEEDOR. PREGUNTA: SE PUEDE OFERTAR QUE SE DISTINGA EL ESTATUS DE LAS MUESTRAS DE OTRA MANERA, FÁCIL DE DISTINGUIR POR LOS USUARIOS?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.</b>
<b>183</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>ANEXO B2 SISTEMA INFORMATICO RED DE LABORATORIOS</b>
	<b>PREGUNTA</b>	EN EL APARTADO 185 AL 187 DE "MODULO DE ANALISIS INTELIGENTE DE DATOS (BI)", NO SE ESPECIFICA QUÉ TIPO DE DATOS SE QUIEREN ANALIZAR Y SOLICITAN QUE SEA UN "MODULO", POR LO QUE ES AMBIGUA LA PETICIÓN Y PUEDE SER LIMITANTE A UN PROVEEDOR. PREGUNTA: ¿SE PUEDE OFERTAR UN PROGRAMA QUE REALICE ESTE TIEMPO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN UNA VEZ QUE SE ACLARE QUÉ TIPO DE DATOS Y TIPO DE ANÁLISIS SE REQUIERE?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.</b>
<b>184</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>ANEXO B2 SISTEMA INFORMATICO RED DE LABORATORIOS</b>
	<b>PREGUNTA</b>	EN EL APARTADO 190 DE "OTROS", DICE "MANEJO DE BIBLIOTECA DENTRO DE LA MISMA APLICACIÓN CON POSIBILIDAD DE SUBIR CUALQUIER TIPO DE DOCUMENTO, MANUAL, VIDEO, ETC., QUE DE APOYO AL SERVICIO DE LABORATORIO". PREGUNTA: ¿SE PUEDE OFERTAR EL EQUIPO DE CÓMPUTO DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO QUE SOPORTEN EL ALMACENAJE DE VIDEOS, MANUALES CON LICENCIAMIENTO DE OFFICE?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.</b>
<b>185</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>ANEXO B2 SISTEMA INFORMATICO RED DE LABORATORIOS</b>
	<b>PREGUNTA</b>	EN EL APARTADO 191 DE "OTROS", DICE "CUENTE CON CHAT QUE PERMITA LA COMUNICACIÓN ENTRE USUARIOS DE LA APLICACIÓN, AUN CON OTROS LABORATORIOS INTERCONECTADOS". PREGUNTA: ¿EL MEDIO DE COMUNICACIÓN DEL CHAT SOLICITADO ES INTERNET, ESTE LO PROVEE EL INSTITUTO O ES POR CUENTA DEL OFERTANTE?, ¿SE PUEDE OFERTAR EL MISMO CHAT QUE TIENEN INSTALADO DE FÁBRICA LAS ESTACIONES DE TRABAJO?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>ES POR CUENTA DEL LICITANTE.</b>
<b>186</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>4.- ASPECTOS TÉCNICOS 4.5.10</b>
	<b>PREGUNTA</b>	4.5.10. EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA DISTRIBUIDOR DEBERA PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE, POR MEDIO DE LA CUAL MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE RESPALDA LA PROPOSICIÓN DEL DISTRIBUIDOR Y LE GARANTIZA EL ABASTO SUFICIENTE DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA QUE A SU VEZ PUEDA CUMPLIR CON LO ADJUDICADO QUE SE DERIVE DE ESTA LICITACIÓN ENTENDEMOS QUE PARA DAR FIEL Y CABAL CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, BASTARÁ CON PRESENTAR CARTA DE APOYO DE FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO O REPRESENTANTE ÚNICO EN MÉXICO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO ES CORRECTO, SE SOLICITA CARTA EN ORIGINAL DEL FABRICANTE DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE RESPALDA LA PROPUESTA DEL DISTRIBUIDOR Y GARANTIZA EL ABASTO SUFICIENTE DE INSUMOS Y EQUIPOS.</b>
<b>187</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>4.- ASPECTOS TÉCNICOS</b>
	<b>PREGUNTA</b>	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA FIRMAR AUTÓGRAFAMENTE LOS DOCUMENTOS AL FINAL DE CADA UNO DE ELLOS, EN LA FIRMA, MIENTRAS QUE LAS DEMÁS HOJAS QUE INTEGREN LAS PROPUESTAS SEAN RUBRICADOS. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA.</b>
<b>188</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>4.- ASPECTOS TÉCNICOS 4.5.14</b>
	<b>PREGUNTA</b>	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LAS HOJAS DE MANUALES REFERENCIADAS ACOMPAÑADAS CON CARTA DEL LICITANTE MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SON COPIA FIEL DEL ORIGINAL, ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE</b>
<b>189</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>4.- ASPECTOS TÉCNICOS</b>
	<b>PREGUNTA</b>	LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS SERA EN RECOPIADORES LEFORT DE DOS ARGOLLAS, SOLICITANDO ATENTAMENTE NO PRESENTAR HOJAS SUELTAS Y ENGRAPADAS, NI EN FÓLDER CON BROCHE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LOS DOCUMENTOS EN CARPETAS DE TRES ARGOLLAS PARA MEJOR SEGURIDAD, ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.</b>

**ASESORÍA Y DISTRIBUCIÓN DE REACTIVOS INDUSTRIALES Y PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.**

<b>190</b>	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO 1. PAGINA 27 RENGLON 20. DICE: QUE ESTABLECE EL NUMERO DE PRUEBAS A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO MARZO A DICIEMBRE 2015.
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL PERIODO ES DE JULIO A DICIEMBRE 2015. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE PRUEBAS SON LAS QUE SE REALIZARAN EN LOS EQUIPOS DE QUIMICA CLINICA DE BAJO RENDIMIENTO
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO ES CLARA LA PREGUNTA.</b>
<b>191</b>	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO A-1 EQUIPO NO. 1 SEROLOGIA. METODOLOGIA, PARRAFO 2. DICE ENSAYO INMUNOENZIMATICO QUIMIOLUMINISCENTE DE MACROPARTICULAS.
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA METODOLOGIA ES POR QUIMIOLUMINISCENCIA DE MICROPARTICULAS
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE.</b>
<b>192</b>	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO C-1 PÁGINA 66. TABLA I. ADEMÁS DEBERA INCLUIR... RENGLON IV DICE EQUIPO PARA REALIZAR BIOMETRIAS HERMETICAS
	<b>PREGUNTA</b>	SE REFIEREN A BIOMETRIAS HEMATICAS
	<b>RESPUESTA</b>	<b>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</b>

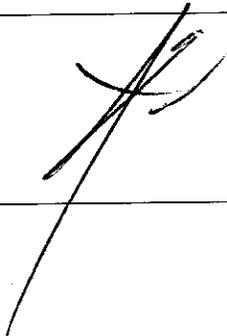




**NOTAS GENERALES:**

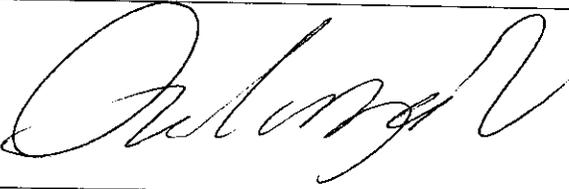
- 1.- MEDIANTE OFICIO OF/RM/0936/06/2015, DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2015 Y RECIBIDO EN LAS INTALACIONES DE ESTA DIRECCIÓN CON FECHA 18 DE JUNIO DE 2015, LA CONTRATANTE EL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA, SOLICITA A ESTA DIRECCIÓN PRECISAR QUE LA PRESENTE LICITACIÓN CORRESPONDE A LA ADJUDICACIÓN DE UN SERVICIO INTEGRAL PARA PRUEBAS DE LABORATORIO EN LABORATORIO ESTATAL, CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA, CAPASITS Y RED DE LABORATORIOS CLÍNICOS.
- 2.- SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL CANJE DE SU COPIA DE LA FICHA BANCARIA POR EL RECIBO OFICIAL ES ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (CAJA) PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NÚM. 3 PLANTA BAJA TLAXCALA, TLAX., Y LO PODRÁN REALIZAR LOS DÍAS 30 DE JUNIO DE 2015 Y 01 DE JULIO DE 2015, EN UN HORARIO DE ATENCIÓN DE 9:00 A 14:00 HORAS.
- 3.- EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y REVISIÓN LEGAL, SE LLEVARA ACABO EL DÍA 02 DE JULIO DE 2015 A LAS 10:30 HRS.

**LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:**

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 15:20 HORAS. DEL DÍA DE SU INICIO LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**REPRESENTANTES**

DIR. JORGE CAPIZ JASSO	
LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO	
C.P. MICAELA TANIA DEGALES MORALES	
C.P. JOSÉ EMILIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	
DR. ARMANDO GARCÍA TEPIXTLE	
Q.F.B. ROSA AURORA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	

<b>DISTRIBUCIONES DAIS, S.A. DE C.V.</b>	
<b>IL DIAGNOSTICS, S.A DE C.V.</b>	
<b>SINAPSIS BENEDETTO, S.A. DE C.V.</b>	
<b>SOLUCIONES Y EQUIPOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.</b>	
<b>LABORATORIOS LICAN, S.A. DE C.V.</b>	
<b>MEDICA CONSULTORA, S.A. DE C.V.</b>	

-----FIN DE TEXTO-----

