




Alegría

No. de Oficio: OF/RM/2154/12/2015

Santa Ana Chiautempan, Tlax., a 8 de Diciembre de 2015.

C. Jorge Capiz Jasso
Director de Recursos Materiales, Servicios
y Adquisiciones de Gobierno del Estado
Presente.

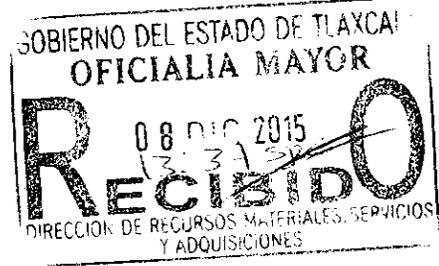


Derivado del minucioso y detallado análisis que realizaron las áreas de Coordinación Estatal de Estomatología y la Dirección de Laboratorio Estatal a las propuestas que presentaron los proveedores participantes, envío a usted el Dictamen Técnico de la Licitación Pública Nacional número GET-LPN-116/2015, referente a la adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio correspondiente a la partida 53101, por lo que le solicito de la manera más atenta de continuidad al proceso antes mencionado.

Atentamente

[Handwritten signature]

C.P. Luz María Portillo García
Directora de Administración
del O.P.D. Salud de Tlaxcala

[Handwritten signature]
Lic. Vella Carrasco Hernández
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
del O.P.D. Salud de Tlaxcala

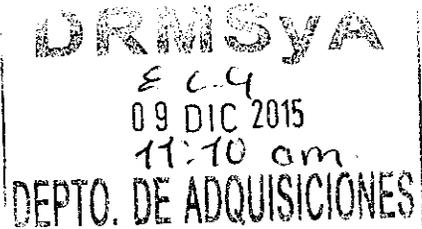

Anexos:
Dictamen Técnico original de la Licitación Pública Nacional GET-LPN-116/2015.

- Copias:**
- ❖ c.c.p.- Lic. Ubaldo Velasco Hernández.- Oficial Mayor de Gobierno del Estado.- Para su conocimiento.
 - ❖ c.c.p.- Dra. Elizabeth Guadalupe Silva Muñoz.- Coordinadora Estatal de Estomatología del O.P.D. Salud de Tlaxcala.- Para su conocimiento.
 - ❖ c.c.p.- Quim. Cristina Montalvo Melo.- Directora del Laboratorio Estatal del O.P.D. Salud de Tlaxcala.- Para su conocimiento.



Ignacio Picazo Nte. No. 25
Col. Centro Chiautempan, Tlax. C.P. 90800
Telefonos: (246) 46 2 10 60, ext. 8048, 8028

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]
09. Dic 15



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ANÁLISIS TÉCNICO

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TLAXCALA
Secretaría de Salud en el Estado de Tlaxcala

DESENLACE ADMINISTRATIVO S.C. ANEXO 1.B

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-1PN-116/2015 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	4.5.1. CARTA DE GARANTÍA 24 M	4.5.2. REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR SSA	4.5.3 AVISO DE FUNCIONA MIENTO	4.5.4 OPINION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SAT 2015	4.5.5 CARTA BAJO PROTESTA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGAR LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN BASES	4.5.6 CARTA BAJO PROTESTA DE DEGR VENDA QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LA NORMA DE CALIDAD	4.5.7.- CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001- 2000 VIGENTES (FABRICANTES NACIONALES) TUV, CE, FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS)	4.5.8.- FOLLETOS, FICHAS O CATALOGOS	OBSERVACIONES
1	AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR ESTOMATOLÓGICO. EQUIPO PORTÁTIL, AUTOMÁTICO PARA LA CONFORMACION DE AMALGAMAS. INTEGRADO POR UN DEPÓSITO PARA MERCURIO Y OTRO PARA LIMADURA. MARCA: LORMA ORIGEN: NACIONAL. MODELO: UNICO	PIEZAS	18	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SE ACEPTA
2	COMPRESOR SUCCIONADOR (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) DESCRIPCION ADICIONAL: COMPRESOR LIBRE DE ACEITE DE ARRANQUE AUTOMATICO DE 90 LITROS. MARCA: CONFORTE ORIGEN: NACIONAL. MODELO: UNICO	PIEZAS	20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SE ACEPTA
3	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL. EQUIPO SEMI PORTATIL PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL Y MATERIAL POR MEDIO DE VAPOR AUTOGENERADO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS. SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS. CONTROLADO POR MICROPROCESADOR. TIPO GABINETE O SOBREMESA. CON DEPÓSITO DE AGUA, SALIDA MANUAL DE AGUA A DRENAJE, CAMARA, PUERTA Y CHAROLAS PERFORADAS, CAPACIDAD Y MATERIAL DE LA CAMARA. DESPLIEGUE DIGITAL DE: PRESION, TEMPERATURA Y TIEMPO DE ESTERILIZACION. TEMPERATURA DE CONTROL. SELECTOR DEL MODO DE OPERACION PARA LIQUIDOS, INSTRUMENTOS Y PAQUETES. CONTROL PARA EL TIEMPO DE ESTERILIZACION. CONTROL AUTOMATICO DE TODO PROCESO DE ESTERILIZACION. INDICADORES DEL PROCESO DE ESTERILIZACION Y DE FIN DE CICLO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDE LA APERTURA DE LA PUERTA DURANTE EL CICLO. VALVULA DE SEGURIDAD POR EXCESO DE PRESION, QUE INDIQUE FALLA DURANTE EL CICLO Y BAJA EN EL NIVEL DE AGUA. CON PRE VACIO Y POST VACIO A TRAVES DE BOMBA DE VACIO. PROGRAMAS PARA EL CICLO DE ESTERILIZACION, QUE INCLUYA EL SECADO. MARCA: LORMA ORIGEN: NACIONAL. MODELO: AV-06	PIEZAS	15	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SE ACEPTA
4	UNIDAD DENTAL (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) DESCRIPCION ADICIONAL: UNIDAD DENTAL PORTATIL. MARCA: CONFORTE ORIGEN: NACIONAL. MODELO: UNICO	PIEZAS	3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO SE ACEPTA DEBIDO A QUE EN SU FOLLETO NO INDICA CON SILLON PORTATIL
5	UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRAD. EQUIPO FIJO. ELECTRO HIDROEUMATICO. DE TECNOLOGIA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICOS EN LA ATENCION ESTOMATOLÓGICA INTEGRAL DEL PACIENTE. LAMPARA ESTOMATOLÓGICA: INTEGRADA AL SILLON. CABEZAL DE ALUMINIO. ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACION NATURAL. CON UN HAZ DE LUZ FRÍA. ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS. INTENSIDAD LUMINOSA. GRADUABLE. ILLUMINACION DENTRO DEL RANGO DE 10,000 A 50,000 LUXES CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3,500°K O MAYOR. CON ENFRIAMIENTO POR FILTROS OPTICOS. REFLECTOR DIGITICO. REDUCTORES DE CALOR (NO EXCEDER 6° LA TEMPERATURA AMBIENTE EN LA DISTANCIA FOCAL). MÓDULO ESTOMATOLÓGICO: INTEGRADO AL SILLON CON ALTURA AJUSTABLE EN CONJUNTO CON EL SILLON. POSICIONABLE EN CUALQUIER PUNTO ALREDEDOR DE 270° COMO MÍNIMO. NEGATOSCOPIO INTEGRADO AL MÓDULO. CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA ALIMENTAR Y CONTROLAR EL AIRE Y EL AGUA EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVES DE BUCLEO AUTOMATICO. BOTTLETA DE AGUA PURIFICADA CON SISTEMA DE VALVULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO. MANOMIETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2. REGULADORES DE PRESION DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VIAS. DESMONTABLE. MARCA: CONFORTE ORIGEN: NACIONAL. MODELO: 201-1E	PIEZAS	6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SE ACEPTA
6	UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLÓGICA. UNIDAD DE PROPLAXIS DENTAL. NO INVASIVO PARA LA REMOCION DE SARRIO. MANCHAS. GENERADOR DE FRECUENCIA DE TRABAJO DE 25 A 45 HZ. SELECTOR DE POTENCIA. CONSUMO DE 17 A 30 WATTS. ALIMENTACION DE AGUA CON CONTROL PARA REGULAR LA PRESION. ROCIO O SPRAY. PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE EN SUSTANCIAS QUÍMICAS V/O VAPOR. INSERTOS O PUNTAS FABRICADAS EN TITANIO O ALINEACION DE MENTAL/DIAMANTE/CARBONO. INTERCAMBIABLES. ESTERILIZABLES EN VAPOR (TRES). MARCA: WOODPECKER. MODELO: DTE ORIGEN: USA	PIEZAS	24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SE ACEPTA

[Handwritten signatures and initials]

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	4.5.1. CARTA DE GARANTÍA 24 M	4.5.2. REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR SSA	4.5.3 AVISO DE FUNCIONA MIENTO	4.5.4 OPINION DE CUMPLIMIENTO ENTREGADA POR EL SAT 2015	4.5.5 CARTA BAO PROTESTA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGARA LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN BASES	4.5.6 CARTA BAO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LA NORMA DE CALIDAD	4.5.7.- CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001- 2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) TUV, CE, FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS)	4.5.8.- FOLLETOS, FICHAS O CATALOGOS	OBSERVACIONES
7	PIEZAS	30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SE ACERTA
8	PIEZAS	8	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SE ACERTA

Fecha de elaboración: martes, 8 de diciembre de 2015

[Firma]
Eliodoro
LIC. EMILIO FREDO RIVERA GONGORA
AREA DE LICITACIONES
REVISOR

[Firma]
COORDINADORA
DRA. ELIZABETH GUANDALUPE SILVA MUÑOZ
ESPITAL DE ESTOMATOLOGIA DEL O.P.D. SAUDE DE TLAXCALA

C.P. ELIZABETH SUAREZ BOCARDO
JEFA DE OFICINA DE ADQUISICIONES
Vo. Bo.

LIC. VELIA HERNANDEZ SARRASCO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DESPLAZAMIENTO ADMINISTRATIVO S.C. ANEXO 1A

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-116/2015 REFERENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	4.5.1. CARTA DE GARANTIA 24 M	4.5.2. REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR SSA	4.5.3 AVISO DE FUNCIONAMIENTO	4.5.4 OPINION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SAT 2015	4.5.5 CARTA BAO PROTESTA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGARA LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN BASES	4.5.6 CARTA BAO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LA NORMA DE CALIDAD	4.5.7.- CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) TUV, CE, FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS)	4.5.8.- FOLLETOS, FICHAS O CATALOGOS	OBSERVACIONES
2	BANO MARIA CON CIRCULACION TE-940D EXT37X36X21 CM; TINA 14X39X15 CM; PARA 40 TUBOS; CAPACIDAD 6.3 LITROS TERMO BANOS DIGITALES CARACTERISTICAS: -SENSOR DE PLATINO TIPO PT-100 -TINA DE UNA SOLA PIEZA -RESISTENCIA TUBULAR PARA INMERSION EN ACERO INOXIDABLE -TAPAS Y CUBIERTAS EN ACERO INOXIDABLE -GABINETE TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE -CAPACIDAD PARA 40, 80 Y 160 TUBOS DE ENSAYO ESTANDAR -FABRICACIONES ESPECIALES SOBRE MEDIDAS Y ESPECIALIZACIONES DE USUARIO CARACTERISTICAS DE CONTROL -CONTROL DE TEMPERATURA PROGRAMABLE, A BASE DE MICROPROCESADOR DE ENTRADAS UNIVERSAL, TIPO P.I.D. O AUTOTUNING (AUTO SINTONIA), CONTROL DE FASE AHORRO DE ENERGIA -RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE +57 C A 100? C -SENSIBILIDAD -+0.1? C -DOBLE DISPLAY MARCA: TERLAB MODELO: TE-940D ORIGEN: NACIONAL	EQUIPO	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO SE ACEPTA DEBIDO A QUE EN EL PUNTO 4.5.6 LAS NORMAS REFERIDAS NO SON APLICABLES PARA LOS BIENES OFERTADOS
3	POTENCIOMETRO CON ELECTRODO PARA MEDICION DE SUPERFICIES LIQUIDAS MEDIDOR DE PH, MV O ORP Y MEDICIONES DE TEMPERATURA EN LA PANTALLA DE LCD CON RETRO ILUMINACION -FUNCIONES SMART STABILITY Y SMART AVERAGING THERMO SCIENTIFIC ORION PARA AUTOMATICAMENTE OPTIMIZAR LA EXACTITUD. PRECISION Y TIEMPO DE RESPUESTA -CAPACIDAD DE CALIBRACION, RECONOCIMIENTO, CALIBRACION DE PH HASTA DE 5 PUNTOS CON ALARMA DE CALIBRACION, RECONOCIMIENTO AUTOMATICO DE SOLUCIONES BUFFER USA, NIST, Y DIN QUE INCLUYA EL ELECTRODO COMPATIBLE CON EL MISMO POTENCIOMETRO MARCA: CONDUCTRONIC MODELO: UNICO ORIGEN: NACIONAL	EQUIPO	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO SE ACEPTA DEBIDO A QUE LA DESCRIPCION DE LA PROPUESTA TECNICA NO CORRESPONDE CON EL CATALOGO O FOLLETO QUE OFERTA, EN EL PUNTO 4.5.6, LAS NORMAS REFERIDAS NO SON APLICABLES PARA LOS BIENES OFERTADOS
10	AUTOCLAVE DE VAPOR AUTOGENERADO DE OPERACION AUTOMATICA AUTOCLAVE BIFASICA AGR-39 PUERTA EN BRONCE CROMADO Y SISTEMA DE CERRADO RADIAL CON VOLANTE GIRATORIO ABRIR-CERRAR *CAMARA CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 12 TIPO 304. *GENERADOR DE VAPOR DE ACERO. EQUIPADO CON TRES RESISTENCIAS EN CASO DE FALTA DE AGUA *TERMOMETRO LECTOR DE TEMPERATURA EN CAMARA *DOS VALVULAS AL FRENTE PARA LLENADO DE AGUA Y DRENAJE *NIVEL DE AGUA VISIBLE AL FRENTE *PLACA CENTRAL CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO-APAGADO. FOCOS PILOTOS. INDICADORES DE LINEA (AMARILLO), TERMOSTATO (ROJO), Y FALTA DE AGUA *CONTROL DE OPERACIONES (MANUAL), CON FUNCIONES DE ESTERILIZADO, EXPULSION RAPIDA PARA ROPA E INSTRUMENTAL Y SECADO *MANOMETROS LECTORES DE PRESION EN CAMARA Y CAMISA *ACABADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE (FRENTE Y LATERALES CON HULE PROTECTOR AZUL) *CORRIENTE ELECTRICA BIFASICA A 220 VOLTS Y TIERRA MODELO AGR-39 (35 X 90) BIFASICA MARCA: MANOLIVE MODELO: AGR-39 ORIGEN: NACIONAL	EQUIPO	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO SE ACEPTA DEBIDO A OFERTA UN AUTOCLAVE CON CAPACIDAD DE 96 LITROS Y SE REQUIERE DE 206 LITROS TAL Y COMO LO MARCA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES PREGUNTA NUMERO 28, EN EL PUNTO 4.5.6 LAS NORMAS REFERIDAS NO SON APLICABLES PARA LOS BIENES OFERTADOS

Fecha de elaboracion: martes, 8 de diciembre de 2015

ELABORO:
LIC. EMERSON RAMIREZ GONGORA
AREA DE LICITACIONES
REVISO

AUTORIZO:
ORD. ROSA FABRICA SANCHEZ GUTIERREZ
JEFA DEL AREA DE CONTROL DE EPIDEMIOLOGIA

C.P. ELIZABETH SUÁREZ BOCARDO
JEFA DE OFICINA DE ADQUISICIONES
Vo. Bo.

LIC. VELA HERNANDEZ ARBASCO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



TLAXCALA
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-1PN-116/2015 REFERENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO



SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TLAXCALA
Secretaría de Salud en el Estado de Tlaxcala

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V. AMEHO 18

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	4.5.1. CARTA DE GARANTIA 24 M	4.5.2. REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR SSA	4.5.3 AVISO DE FUNCIONA MIENTO	4.5.4 OPINION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SAT 2015	4.5.5 CARTA BAJO PROTESTA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGARA LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN BASES	4.5.6 CARTA BAJO PROTESTA DE DEGR VERDAD QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LA NORMA DE CALIDAD	4.5.7.- CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) TUV, CE, FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS)	4.5.8.- FOLLETOS, FICHAS O CATALOGOS	OBSERVACIONES
1	AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR ESTOMATOLOGICO. 1. MEZCLADOR UNIVERSAL DE ALTA VELOCIDAD PARA CAPSULAS DE AMALGAMA. 2. EQUIPO PORTATIL, AUTOMATICO PARA LA CONFORMACION DE AMALGAMAS. 3. CARACTERISTICAS TECNICAS. 3.a. VOLTAJE NOMINAL: 110 V 3.b. POTENCIA ABSORBIDA: 50 W 3.c. FUSIBLE: 1 AT 110V 3.d. INTERRUPTOR BIPOLAR CON INDICADOR LUMINOSO VERDE (ON) 3.e. FRECUENCIA DE MEZCLA: 4000 VIBRACIONES /MIN 3.f. AMPLITUD: 25 MM 3.g. FUNCIONAMIENTO: INTERMITENTE 1. DE VIBRACION PROG.: 0-90 SEC 3.i. DIMENSIONES: 210 X 205 X 120 MM. 3.j. PESO TOTAL: 3,1 KG MARCA: SATELEC MODELO: S/M	PIEZAS	18	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SE ACEPTA
	PROCEDENCIA: FRANCIA 1. ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL. 2. EQUIPO SEMI PORTATIL PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL Y MATERIAL. 3. POR MEDIO DE VAPOR AUTOGENERADO. 4. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS. 4.a. CONTRUADO POR MICROPROCESADOR. 4.b. TIPO GABINETE O SOBREMESA. 4.c. CON DEPÓSITO DE AGUA. 4.d. CON SALIDA MANUAL DE AGUA A BRENAL. 4.e. CHAROQLAS PERFORADAS 4.f. CAPACIDAD 12 LITROS. 4.g. MANOMETRO DIGITAL CON BARRA DE LEDS. MÁS FÁCIL DE MONTREAR. 3 TEMPERATURA Y PRESION. 4. h. CON UN PROGRAMA ÚNICO DE ESTERILIZACIÓN. 4. i. CON CONTROL AUTOMÁTICO DE TODO PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. 4.j. CON 13 SISTEMAS DE SEGURIDAD. 4.k. CON UN ÚNICO PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN Y SECADO SEMI AUTOMÁTICO CON LA PUERTA ENTRE ABIERTA. 4.l. POTENCIA 1.200 W MARCA: CRISTOPOLY 12 LTS MODELO: S/M PROCEDENCIA: BRASIL	PIEZAS	15	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SE ACEPTA
5	1. UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRAD. EQUIPO FIJO. ELECTRO HIDRONEUMATICO. DE TECNOLOGIA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICOS EN LA ATENCION ESTOMATOLOGICA INTEGRAL DEL PACIENTE. 2. LAMPARA ESTOMATOLOGICA. 2.a. INTEGRADA AL SILLON. 2.b. CON CABEZAL. 2.c. ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACION NATURAL. 2.d. CON UN HAZ DE LUZ FRIA ENFOCABLE. 2.e. 3 MODOS DE INTENSIDAD DE LUZ QUE VARIA DE 22000 A 6000 LUX. 3. MODULO ESTOMATOLOGICO: 3.a. INTEGRADO AL SILLON CON ALTURA AJUSTABLE EN CONJUNTO CON EL SILLON. 3.b. POSICIONABLE A UN COSTADO DEL SILLON DENTAL. 3.c. NEGATOSCOPIO INTEGRADO AL SILLON. 3.d. CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA ALIMENTAR Y CONTROLAR EL AIRE Y EL AGUA EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVES DE BLOQUEO AUTOMATICO. 3.e. BOTEJUA DE AGUA PURIFICADA CON SISTEMA DE VALVULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENRIAMIENTO. 3.f. REGULADORES DE PRESION DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. 4. SILLON: 4.a. 8 MOVIMIENTOS 4.b. 2 APOYADORES DE BRAZO 5. PEDAL DE COMANDO 7. DOSPIEZAS DE MANO DE ALTA MODELO RC 90 MARCA: KAYO MODELO: UNIK 4 PROCEDENCIA: BRASIL	PIEZAS	6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SE ACEPTA
6	1. UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA. EL PRIMER GENERADOR DE ULTRASONIDOS PIEZO-ELECTRICO. 2. UNIDAD DE PROFILAXIS DENTAL, NO INVASIVO PARA LA REMOCION DE SARRO, MANCHAS. 3. CARACTERISTICAS TECNICAS 3.a. FRECUENCIA DE VIBRACIONES DE 27 A 32 KHZ. 3.b. CON SECTOR DE POTENCIA PARA TRES MODOS PERIO, ENDO Y DETARTARJE. LA POTENCIA MÁXIMA CONSUMIDA: 40 VA. 3.c. PRESION DEL AGUA CON CONTROL PARA REGULAR LA PRESION. 3.d. CON UNA PIEZA DE MANO. 4. CON PUNTERAS DE LA MISMA MARCA. MARCA: SALETEC MODELO: BOOSTER P5 PROCEDENCIA: FRANCIA	PIEZAS	24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SE ACEPTA

X
✓
B

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO S.A. DE C.V. ANEXO 1.B

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-1/PN-116/2015 REFERENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	4.5.1. CARTA DE GARANTÍA 24 M	4.5.2. REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR SSA	4.5.3 AVISO DE FUNCIONA MIENTO	4.5.4 OPINION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SAT 2015	4.5.5 CARTA BAJO PROTESTA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGARA LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN BASES	4.5.6 CARTA BAJO VERDAD QUE DEGR BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LA NORMA DE CALIDAD	4.5.7.- CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) TUV, CE, FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS)	4.5.8.- FOLLETOS, FICHAS O CATALOGOS	OBSERVACIONES
7	REVELADOR MANUAL DE PLACAS DENTALES. 1.REVELADOR MANUAL DE PLACAS DENTALES. 2.INSTRUMENTO PORTATIL PARA REVELAR MANUALMENTE PLACAS RADIOGRAFICAS DENTALES. 3.GABINETES DE ACRILICO TRANSPARENTE. 3.a. SELLADO PARA IMPEDIR EL PASO DE LA LUZ. DOS ENTRADAS LATERALES CON MANGAS DE SEGURIDAD DE TELA COLOR NEGRO. QUE PERMITA LOS MOVIMIENTOS DEL USUARIO. 3.b. TRES RECIPIENTES UNO PARA LIQUIDO REVELADOR, OTRO PARA AGUA Y OTRO PARA FILADOR. 4. GANCHO PORTA PLACAS. MARCA: ARAIN MODELO: SYN	PIEZAS	30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SE ACEPTA
8	1. UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL. EQUIPO DE RAYOS X QUE SE EMPLEA PARA ESTUDIOS RADIOGRAFICOS DE PARECIMIENTOS ESTOMATOLOGICOS. 2. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACURBOA LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: 2.a. CONTROL DE TIEMPO DE EXPOSICION: 0.03 E- 3.00 SEGUNDOS EN PASOS DE 0.01 SEGUNDOS. 2.b. TRANSFORMADOR DE ALTA TENSION. 2.c. TUBO DE RAYOS X DE 70 KVP DE ANODO FIJO CON UN PUNTO FOCAL. CORRIENTE ANODICA 8 mA. DISTANCIA FOCAL MINIMA 200mm. 3. VOLTAJE DE ALIMENTACION: 120 Volts AC. MARCA: CORIX MODELO: PLUS 70 PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZAS	8	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SE ACEPTA

Fecha de elaboracion: martes, 8 de diciembre de 2015

ELABORÓ:

LIC. EMANUEL ALFREDO FAMILIÉZ GÓNGORA
ÁREA DE LICITACIONES
REVISÓ

C.P. ELIZABETH SUÁREZ BOCCARDO
JEFA DE OFICINA DE ADQUISICIONES
Vo. Bo.

CONFIRMADORA ESTADAL DE ESTOMATOLOGIA DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA
DRA. ELIZABETH GÓNGORA LUPE SILVA MUÑOZ

LIC. VEILA HERNÁNDEZ ESCOBEDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICTACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-116/2015 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ANÁLISIS TÉCNICO

INFUSOMED, S.A. DE C.V. ANEXO 1 A

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	4.5.1. CARTA DE GARANTÍA 24 M	4.5.2. REGISTRO DE EMITIDO POR SSA	4.5.3 AVISO DE FUNCIONAMIENTO	4.5.4 OPINION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SAT 2015	4.5.5 CARTA BAO CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENTRENAR LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN BASES	4.5.6 CARTA BAO PROTESTA DE DICER VERDAD QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LA NORMA DE CALIDAD	4.5.7.- CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001- 2000 VIGENTES (FABRICANTES NACIONALES) TVQ, CE, FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS)	4.5.8.- FOLLETOS, FICHAS O CATALOGOS	OBSERVACIONES
	<p>THERMOMIXER *FRECUENCIA DE MEZCLA ELEVADAS DE HASTA 3.000 RPM *MOVIMIENTO CIRCULAR CONTROLADO PERMITIENDO UNA MEZCLA RÁPIDA Y EFICIENTE EN TUBOS Y PLACAS *TECNOLOGÍA ANTI DERRAMES EVITA LA HUMECCIÓN DE LA TAPA, ASÍ COMO LA CONTAMINACIÓN CRUZADA *CON TAPA QUE PREVIENE LA CONDENSACIÓN Y MEJORA LA HOMOGENEIDAD DE LA TEMPERATURA PARA MEJORES RESULTADOS DE LOS ENSAYOS *CALENTAMIENTO, MEZCLA Y ENFRÍAMIENTO EN TODOS LOS FORMATOS DE TUBOS Y PLACAS (CONJUNTES DE 5 ML A 50 ML, APLICACIONES BÁSICAS CALENTAR/MEZCLAR/ENFRÍAR RANGO DE TEMPERATURA MIN: -15° C / 1) DEBAJO DE TA, MAX: 100 C VALORES DE AJUSTE MÍNIMO Y MÁXIMO 1 C / 100° C MÁXIMA EXACTITUD DE TEMPERATURA + 0.5° C A 20-45 C HOMOGENEIDAD DE TEMPERATURA MAX: + 0.5° C A 20-45 C (EN TODAS LAS POSICIONES DE LOS SMARTBLOCKS) MÁXIMA VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO 6 C /MIN MÁXIMA VELOCIDAD DE ENFRÍAMIENTO 2.5° C/MIN BETWEEN 100° C AND RT FRECUENCIA DE MEZCLA 300-3,200 RPM (DEPENDIENDO DE SMARTBLOCKS UTILIZADO) TEMPORIZADOR 15 SEC A 99:30H, CONTINUO ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100V - 130V +- 10%, 50 HZ - 60 HZ 220V - 240V +- 10%, 50 HZ - 60 HZ SALIDA 200 W (MAX.) DIMENSIONES (AN X PR X AL) 20.6 X 30.4 X 13.1 PESO 6.2 KG</p> <p>MARCA: EPENDORF MODELO: EFS384000020 PROCEDENCIA: ALEMANIA</p>	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SE ACEPTA

Fecha de elaboración: martes 3 de diciembre de 2015

AUTORIZA:

DR. ROSA FABRICA SANCHEZ GUTIERREZ
JEFA DEL ÁREA DE CONTROL DE EPIDEMIOLOGÍA

ELABORA:
LIC. ESTHER PATRICIA RAMÍREZ GÓNGORA
AREA DE LICITACIONES

CP. ELIZABETH GUILLERMO
JEFA DE OFICINA DE LICITACIONES
VIA FE

LIC. VILMA HERNÁNDEZ RAMÍREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ANEXO 1.A

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-IPN-116/2015 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	4.5.1. CARTA DE GARANTÍA 24 M	4.5.2. REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR SSA	4.5.3 AVISO DE FUNCIONA MIENTO	4.5.4 OPINION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SAT 2015	4.5.5 CARTA BAO PROTESTA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGARA LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN BASES	4.5.6 CARTA BAO PROTESTA DE DEGR VERBAO QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LA NORMA DE CALIDAD	4.5.7.- CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001- 2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) TUV, CE, FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS)	4.5.8.- FOLLETOS, FICHAS O CATALOGOS	OBSERVACIONES
1	BAÑO MARIA CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE (BAÑO DE AGUA DE USO GENERAL THERMOSCIENTIFIC) - MODELO: 184 -CONTROL TEMPERATURA/RESOLUCION UNIFORMIDAD (37 °C)/+/-0.2° C +/-0.1°C - MÁXIMO DE TEMPERATURA: 99.9°C -CAPACIDAD: 19.5L (5.2 GAL.) -DIMENSIONES INTERIORES: L x W x D: 35.6 X 30.5 X 20.3 CM (14 X 12 X 8 IN) -DIMENSIONES EXTERIORES L x W x H: 49.9 X 40 X 24.8 CM (19.7 X 15.75 X 9.75 IN) -PESO DE ENVÍO: 11.3 KG (25LB) - SISTEMA ELÉCTRICO: 120V 50/60 HZ/600 W.	EQUIPO	1	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA	NO SE ACEPTA DEBIDO A QUE NO PRESENTA EL PUNTO 4.5.2. DE LAS BASES DONDE SE REHIERA SI O NO SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO, NO PRESENTA CERTIFICADOS DE CALIDAD QUE REHIERA LAS MARCAS DE LOS EQUIPOS
2	PROCEDENCIA: BANJO MARIA CON CIRCULACIÓN TE-BAÑO EXT 37X36X21 CM; TINA 14X39X15 CM; PARA 40 TUBOS; CAPACIDAD 6.3 LITROS BAÑOS DIGITALES CARACTERÍSTICAS: -SENSOR DE PLATINO TIPO PT-100 -TINA DE UNA SOLA PIEZA -RESISTENCIA TUBULAR PARA INMERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE -TAPAS Y CUBIERTAS EN ACERO INOXIDABLE -GABINETE TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE -CAPACIDAD PARA 40, 80 Y 160 TUBOS DE ENSAYO ESTÁNDAR -FABRICACIONES ESPECIALES SOBRE MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES DE USUARIO CARACTERÍSTICAS DE CONTROL: -CONTROL DE TEMPERATURA PROGRAMABLE, A BASE DE MICROPROCESADOR DE ENTRADAS UNIVERSAL, TIPO P.I.D. O AUTOTUNING (AUTO SINTONIA), CONTROL DE FASE -AHORRO DE ENERGÍA -RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE +5°C A 100°C -SENSIBILIDAD -+0.1°C -DOBLE DISPLAY.	EQUIPO	1	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO CUMPLE	NO SE ACEPTA DEBIDO A QUE NO PRESENTA LOS PUNTOS 4.5.2, 4.5.6 Y 4.5.7 DE LAS BASES
3	PROCEDENCIA: POTENCIÓMETRO CON ELECTRODO PARA MEDICIÓN DE SUPERFICIES LÍQUIDAS MEDIDOR DE PH, MV O ORP Y MEDICIONES DE TEMPERATURA EN LA PANTALLA DE LCD CON RETRO ILUMINACIÓN -FUNCIONES SMART STABILITY Y SMART AVERAGING THERMO SCIENTIFIC ORION PARA AUTOMÁTICAMENTE OPTIMIZAR LA EXACTITUD, PRECISIÓN Y TIEMPO DE RESPUESTA -CAPACIDAD DE CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA, CALIBRACIÓN DE PH HASTA DE 5 PUNTOS CON ALARMA DE CALIBRACIÓN, RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE SOLUCIONES BUFFER USA, NIST, Y DIN QUE INCLUYA EL ELECTRODO COMPATIBLE CON EL MISMO POTENCIÓMETRO.	EQUIPO	1	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO CUMPLE	NO SE ACEPTA DEBIDO A QUE NO PRESENTA LOS PUNTOS 4.5.2, 4.5.6 Y 4.5.7 DE LAS BASES
4	PROCEDENCIA: AGITADOR CON PLATO DE CALENTAMIENTO CIMAREC III SP 46935 DE 30.4 X 30.4 -PLATO DE CERÁMICA -RANGO DE AGITACIÓN 100- 1000RPM - TEMPERATURA 150-538 °C -AGITACIÓN MAGNÉTICA -INCLUYE BARRA DE AGITACIÓN -PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO.	EQUIPO	1	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO CUMPLE	NO SE ACEPTA DEBIDO A QUE NO PRESENTA LOS PUNTOS 4.5.2, 4.5.6 Y 4.5.7 DE LAS BASES

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-1PN-116/2015 REFERENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	4.5.1. CARTA DE GARANTIA 24M	4.5.2. REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR SSA	4.5.3 AVISO DE FUNCIONAMIENTO	4.5.4 OPINION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SAT 2015	4.5.5 CARTA BAO PROTESTA QUE EN ADJUDICADO ENTREGA LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN BASES	4.5.6 CARTA BAO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS BIENES OBTENIDOS CUMPLEN CON LA NOMMA DE CALIDAD	4.5.7.- CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) TUV, CE, FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS)	4.5.8.- FOLLETOS, FICHAS O CATALOGOS	OBSERVACIONES
7	<p>ULTRA CENTRIFUGA REFRIGERADA 5418R. CENTRIFUGA REFRIGERADA. EQUIPADA CON UN ROTOR DE 18 TUBOS DE 1.5/2.0ML. HERMETICOS A LOS AEROSLES ESTANDAR. CON TAPA DE ROTOR. VELOCIDAD HASTA 15.837 X G (14,000 RPM). -BOTON SHORTSPIN APARTE PARA MAYOR ACELERACION. -BOTON CONVERTIDOR RPM/RCF. SEPARADO CON MANDO GIRATORIO PARA UNA RAPIDA SELECCION DE PARÁMETROS CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO ADICIONALES DE CENTRIFUGA REFRIGERADA 5418 R. - INDICE DE TEMPERATURA. DE 0 °C A + 40 °C. BAJA ALTURA DE ACCESO DE 26 CM. COMO UNIDAD DE REFRIGERACION SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR. MANTIENE CONSTANTE LA TEMPERATURA DE 4 °C A MÁXIMA VELOCIDAD. -FAST TEME PARA UNA PRE-REFRIGERACION DE LA CENTRIFUGA. -LA REFRIGERACION CONTINUA MANTIENE LA TEMPERATURA CUANDO EL PROCESO DE CENTRIFUGACION NO ESTA ACTIVO.</p> <p>FABRICANTE: MODELO:</p>	EQUIPO	1	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO CUMPLE	NO SE ACEPTA DEBIDO A QUE NO PRESENTA LOS PUNTOS 4.5.2, 4.5.6 Y 4.5.7 DE LAS BASES
8	<p>PROCEDENCIA: CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL CON FUENTE DE PODER Y ACCESORIOS CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL TAMAÑO (W x L x H) 29 x 30 x 9 CM TAMAÑO DE GEL (GD) (W x L) 25 x 10 CM NUMERO DE MUESTRAS 24-96 VOLUMEN DE BUFERR DE CORRIDA-2 L RECIRCULACION DE BUFERR SIN MIGRACION DE AZUL DE BROMOFENOL. -6.2 CM/Hr (A 200V)</p> <p>FABRICANTE: MODELO: PROCEDENCIA:</p>	EQUIPO	1	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO CUMPLE	NO SE ACEPTA DEBIDO A QUE NO PRESENTA LOS PUNTOS 4.5.2, 4.5.6 Y 4.5.7 DE LAS BASES
9	<p>ESPECTROFOTOMETRO SMARTSPEC FLUORESCENTOFOTOMETRO. CUANTIFICACION DE ACIDOS NUCLEICOS (OSDNA, SSONA, RNA, OLIGONUCLEOTIDOS) - CUANTIFICACION DE ACIDOS PROTEINAS (280 NM, BRADFORD, LOWRY, BCA) - CALCULO DEL GROSOR DE LA CELULA (OD600) -TASA DE UNION DE MATERIALES DE COLOR FLUORESCENTE (DYE 550/650, POR EJEMPLO. CYS, CYS) PRUEBAS ENZIMATICAS. DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUIVALENCIA (POR EJEMPLO DE ACTIVIDADES ENZIMATICAS O PRUEBAS DE BIOLOGIA CELULAR). -MEDICION DIRECTA DE LA ABSORCION DE LONGITUDES DE ONDA INDIVIDUALES SIN CALCULOS ADICIONALES (280NM, 260NM, 280NM, 340NM, 405NM, 490NM, 550NM, 595NM) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO -9. LONGITUDES DE ONDA, CON LAS QUE SE PUEDE EFECTUAR LAS MEDICIONES HABITUALES EN TRABAJOS DE BIOLOGIA MOLECULAR, BIOQUIMICA Y BIOLOGIA CELULAR. -METODOS REPROGRAMADOS PARA LA CUANTIFICACION DE ACIDOS NUCLEICOS Y PROTEINAS, ASI COMO LA TASA DE UNION DE MATERIALES DE COLOR FLUORESCENTE -CALCULO AUTOMATICO DE LOS RESULTADOS, FACTORES DE REDUCCION INCLUIDOS. -MEDICIONES DE LONGITUDES DE ONDA INDIVIDUALES SIN CALCULOS. - REGISTRO DE LOS ÚLTIMOS 100 RESULTADOS CON TODOS LOS DATOS CORRESPONDIENTES SISTEMA OPTICO. -FOTOMETRO DE ABSORCION DE HAZ ÚNICO CON RAYO DE REFERENCIA FUENTE DE LUZ LÁMPARA DE RAYO XENÓN, ALTURA DE RAYO DE LUZ: 8.5 MM LONGITUDES DE ONDA. 230, 260, 280, 340, 405, 490, 550, 595, 650 ANCHO DE BANDA ESPECTRAL: 5NM EN 230-340NM, 7NM EN 405-650NM VERACIDAD DE LAS LONGITUDES DE ONDA:++ 1NM EN 230-280NM, + 2NM EN 340-650NM AREA DE MEDICION FOTOMETRICA: 0 - 3 Å (2 Å EN 340NM), DIE METHODS: -2 Å EN 550NM/650NM PRECISION FOTOMETRICA: ++ 0.002 Å EN 0 Å, ++ 0.005 Å EN 1 Å VERACIDAD OTOMETRICA: + 1% EN 1 Å MEMORIA DE RESULTADOS: PARA RESULTADOS CON VALORES DE EXTINGUION Y DE RATIO. NUMERO DE LA MUESTRA, REDUCCION DE MUESTRA, FECHA Y HORA INTERFAZ: RS-232 C, EN SERIE, CONEXION AL PC OPCIONAL POTENCIA ABSORBIDA: APROX. 20W EN SERVICIO, APROX. 10W EN MODO STAND-BY CONEXION DE RED: 100-240 V, ++ 10%, 50-60 HZ, ++ 5% DIMENSIONES (ANCHO X LARGO X ALTO): 20 X 32 X 10 CM PESO: 3KG</p> <p>FABRICANTE: MARCA: MODELO: PROCEDENCIA:</p>	EQUIPO	1	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO CUMPLE	NO SE ACEPTA DEBIDO A QUE NO PRESENTA LOS PUNTOS 4.5.2, 4.5.6 Y 4.5.7 DE LAS BASES



CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. ANEXO 1A

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-116/2015 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ANÁLISIS TÉCNICO

SALUD DE TLAXCALA
Secretaría de Salud en el
Estado de Tlaxcala

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	4.5.1. CARTA DE GARANTÍA 24 M	4.5.2. REGISTRO DE SANITARIO EMITIDO POR SSA	4.5.3 AVISO DE FUNCIONAMIENTO	4.5.4 OPINION DE ENTREGA POR EL SAT 2015	4.5.5 CARTA BAO PROTESTA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGARA LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN BASES	4.5.6 CARTA BAO PROTESTA DE DEGR VERDAD QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LA NORMA DE CALIDAD	4.5.7.- CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001- 2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) TV, CE, FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS)	4.5.8.- FOLLETOS, FICHAS O CATALOGOS	OBSERVACIONES
10	AUTOCLAVE DE VAPOR AUTOGENERADO DE OPERACION AUTOMÁTICA AUTOCLAVE BIFÁSICA AGR-39 PUERTA EN BRONCE CROMADO Y SISTEMA DE CERRADO RADIAL CON VOLANTE GIRATORIO ABRIR-CERRAR *CAMARA CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 12 TIPO 304 *GENERADOR DE VAPOR DE ACERO, EQUIPADO CON TRES RESISTENCIAS EN CASO DE FALTA DE AGUA *TERMOMETRO LECTOR DE TEMPERATURA EN CÁMARA *DOS VALVULAS AL FRENTE PARA LLENADO DE AGUA Y DRENAJE *NIVEL DE AGUA VISIBLE AL FRENTE *PLACA CENTRAL CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO-APAGADO, FOCOS PILOTOS INDICADORES DE LINEA (AMARILLO), TERMOSTATO (ROJO) Y FALTA DE AGUA *CONTROL DE OPERACIONES (MANUAL), CON FUNCIONES DE ESTERILIZADO, EXPULSION RAPIDA PARA ROPA E INSTRUMENTAL Y SECADO. *MANOMETROS LECTORES DE PRESION EN CÁMARA Y CAMISA *ACABADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE (FRENTE Y LATERALES CON HULE PROTECTOR AZUL) *CORRIENTE ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VOLTS Y TIERRA MODELO AGR-39 (95 X 90) BIFÁSICA. FABRICANTE: MARCA: MODELO: PROCEDENCIA:	EQUIPO	1	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE	NO SE ACEPTA DEBIDO A QUE NO PRESENTA EL PUNTO 4.5.2. DE LAS BASES DONDE SE REFERIA SI O NO SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO, NO PRESENTA CERTIFICADOS DE CALIDAD QUE REFERIA LAS MARCAS DE LOS EQUIPOS
11	THERMOMIXER *FRECUENCIA DE MEZCLA ELEVADAS DE HASTA 3,000 RPM *MOVIMIENTO CIRCULAR CONTROLADO PERMITIENDO UNA MEZCLA RÁPIDA Y EFICIENTE EN TUBOS Y PLACAS *TECNOLOGÍA ANTI DERRAMES EVITA DE FORMA EFICAZ LA HUMECTACIÓN DE LA TAPA, ASÍ COMO LA CONTAMINACIÓN CRUZADA *CON TAPA QUE PREVIENE LA CONDENSACIÓN Y MEJORE LA HOMOGENEIDAD DE LA TEMPERATURA PARA MEJORES RESULTADOS DE LOS ENSAYOS *CALENTAMIENTO, MEZCLA Y ENFRIAMIENTO EN TODOS LOS FORMATOS DE TUBOS Y PLACAS COMUNES DE 5 ML A 50 ML, APLICACIONES BÁSICAS CALENTAR/MEZCLAR/ENFRÍAR RANGO DE TEMPERATURA MIN:15 °C (1) DEBAJO DE TA, MAX: 100 °C VALORES DE AJUSTE MÍNIMO Y MÁXIMO 1 °C / 100 °C MÁXIMA EXACTITUD DE TEMPERATURA +-0.5°C 20-45 °C HOMOGENEIDAD DE TEMPERATURA MAX. +-0.5°C A 20-45°C EN TODAS LAS POSICIONES DE LOS SMARTBLOCKS MÁXIMA VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO 6 °C /MIN MÁXIMA VELOCIDAD DE ENFRIAMIENTO 2.5°C/MIN BETWEEN 100 °C AND RT FRECUENCIA DE MEZCLA 300-3,000 RPM (DEPENDIENDO DEL SMARTBLOCKS UTILIZADO) TEMPORIZADOR 15 SEC A 99:30H, CONTINUO ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100V - 130V +- 10%, 50 HZ - 60 HZ 220V -240V +- 10%, 50 HZ -60 HZ SALIDA 200 W (MAX.) DIMENSIONES (AN X PR X AL) 20.6 X 30.4 X 13.1 PESO 6.2 KG. FABRICANTE: MARCA: MODELO: PROCEDENCIA:	EQUIPO	1	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTO	NO CUMPLE	NO SE ACEPTA DEBIDO A QUE NO PRESENTA LOS PUNTOS 4.5.2, 4.5.6 Y 4.5.7 DE LAS BASES

Elaboro:

Fecha de elaboracion: martes, 8 de diciembre de 2015

Autorizo:

LIC. EMILIO ARREDO RAMÍREZ GÓNGORA
ÁREA DE LICITACIONES
REVISOR

OPD. ROSA FABRICA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
JEFA DEL ÁREA DE CONTROL DE EPIDEMIOLOGÍA

C.P. ELIZABETH SÁNCHEZ BOCARDO
JEFA DE OFICINA DE ADQUISICIONES

Vº Bº

LIC. VELIA HERNÁNDEZ CÁRRASCO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ANEXO 1 B

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	4.5.1. CARTA DE GARANTIA 24 M	4.5.2. REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR SSA	4.5.3 AVISO DE FUNCIONA MIENTO	4.5.4 OPINION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SAT 2015	4.5.5 CARTA BAJO PROTESTA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGARA LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN BASES	4.5.6 CARTA BAJO PROTESTA DE DEGR VERDAD QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LA NORMA DE CALIDAD	4.5.7.- CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001- 2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) TUV, CE, FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS)	4.5.8.- FOLLETOS, FICHAS O CATALOGOS	OBSERVACIONES
1	AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR ESTOMATOLOGICO. EQUIPO PORTATIL, AUTOMATICO PARA LA CONFORMACION DE AMALGAMAS. INTEGRADO POR UN DEPOSITO PARA MERCURIO Y OTRO PARA LIMADURA. FABRICANTE: MARCA: MODELO: PROCEDENCIA: COMPRESOR SUCCIONADOR (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) DESCRIPCION ADICIONAL: COMPRESOR LIBRE DE ACEITE DE ARRANQUE AUTOMATICO DE 90 LITROS.	PIEZAS	18	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SE ACEPTA
2	PROCEDENCIA: ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL. EQUIPO SEMI-PORTATIL PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL Y MATERIAL, POR MEDIO DE VAPOR AUTOGENERADO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS. SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS. CONTROLADO POR MICROPROCESADOR. TIPO GABINETE O SOBREMESA. CON DEPOSITO DE AGUA. SALIDA MANUAL DE AGUA A DRENAJE, CAMARA, PUERTA Y CHAROLAS PERFORADAS. CAPACIDAD Y MATERIAL DE LA CAMARA. DESPLIEGUE DIGITAL DE: PRESION, TEMPERATURA Y TIEMPO DE ESTERILIZACION. TEMPERATURA DE CONTROL. SELECTOR DEL MODO DE OPERACION PARA LIQUIDOS, INSTRUMENTOS Y PAQUETES. CONTROL PARA EL TIEMPO DE ESTERILIZACION. CONTROL AUTOMATICO DE TODO PROCESO DE ESTERILIZACION. INDICADORES DEL PROCESO DE ESTERILIZACION Y DE FIN DE CICLO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA APERTURA DE LA PUERTA DURANTE EL CICLO. VALVULA DE SEGURIDAD POR EXCESO DE PRESION, QUE INDIQUE FALLA DURANTE EL CICLO Y BAJA EN EL NIVEL DE AGUA. CON PRE VACIO Y POST VACIO A TRAVES DE BOMBA DE VACIO. PROGRAMAS PARA EL CICLO DE ESTERILIZACION, QUE INCLUYA EL SECADO.	PIEZAS	20	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO CUMPLE	NO SE ACEPTA DEBIDO A QUE NO PRESENTA LOS PUNTOS 4.5.2, 4.5.6 Y 4.5.7 DE LAS BASES
3	PROCEDENCIA: UNIDAD DENTAL (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) DESCRIPCION ADICIONAL: UNIDAD DENTAL PORTATIL.	PIEZAS	15	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SE ACEPTA
4	PROCEDENCIA: FABRICANTE: MARCA: MODELO:	PIEZAS	3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO SE ACEPTA DEBIDO A QUE NO OFRECE UN SILICON PORTATIL

*no fue
requisito*

CORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. ANEXO 18

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	4.5.1. CARTA DE GARANTIA 24 M	4.5.2. REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR SSA	4.5.3 AVISO DE FUNCIONA MIENTO	4.5.4 OPINION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SAT 2015	4.5.5 CARTA BAJO PROTESTA QUE EN ADJUDICADO ENTREGARA LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN BASES	4.5.6 CARTA BAJO PROTESTA DE DEGR. VERDAD QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LA NORMA DE CALIDAD	4.5.7 - CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001- 2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) TUV, CE, FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS)	4.5.8.- FOLLETOS, FICHAS O CATALOGOS	OBSERVACIONES
5	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO. EQUIPO FLO. ELECTRO HIDROEUMATICO. DE TECNOLOGIA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICOS EN LA ATENCION ESTOMATOLOGICA INTEGRAL DEL PACIENTE. LAMPARA ESTOMATOLOGICA. INTEGRADA AL SILLON. CABEZA DE ALUMINIO. ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACION NATURAL, CON UN HAZ DE LUZ FRIA ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS, INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE. ILLUMINACION DENTRO DEL RANGO DE 10,000 A 50,000 LUXES CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3,500°K. O MAYOR. CON ENFRIAMIENTO POR FILTROS OPTICOS. REFLECTOR DIRECTO. REDUCTORES DE CALOR (NO EXCEDER 6° LA TEMPERATURA AMBIENTE EN LA DISTANCIA FOCAL). MODULO ESTOMATOLOGICO. INTEGRADO AL SILLON CON ALTURA AJUSTABLE EN LA DISTANCIA FOCAL. MODULO POSICIONABLE EN CUALQUIER PUNTO ALREDEDOR DE 270° COMO MINIMO. NEGATOSCOPIO INTEGRADO AL MODULO. CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA ALIMENTAR Y CONTROLAR EL AIRE Y EL AGUA EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVES DE BLOQUEO AUTOMATICO. BOTELLA DE AGUA PURIFICADA CON SISTEMA DE VALVULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO, MANOMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2. REGULADORES DE PRESION DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE AGERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VIAS. DESMONTABLE. FABRICANTE: MARCA: MODELO: PROCEDENCIA:	PIEZAS	6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SE ACEPTA
6	UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA. UNIDAD DE PROFILAXIS DENTAL. NO INVASIVO PARA LA REMOCION DE SARRO. MANCHAS. GENERADOR DE FRECUENCIA DE TRABAJO DE 25 A 45 HZ. SELECTOR DE POTENCIA: CONSUMO DE 17 A 30 WATTS. ALIMENTACION DE AGUA CON CONTROL PARA REGULAR LA PRESION. ROCIO O SPRAY. PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE EN SUSTANCIAS QUIMICAS Y/O VAPOR. INSERTOS O PUNTAS FABRICADAS DE TITANIO O ALEACION DE METAL/DIAMANTE/CARBONO. INTERCAMBIABLES, ESTERILIZABLES EN VAPOR (TRES). FABRICANTE: MARCA: MODELO: PROCEDENCIA:	PIEZAS	24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SE ACEPTA
7	REVELADOR MANUAL DE PLACAS DENTALES. INSTRUMENTO PORTATIL PARA REVELAR MANUALMENTE PLACAS RADIOGRAFICAS DENTALES. GABINETES DE ACILICO TRANSPARENTE. SELLADO PARA IMPEDIR EL PASO DE LA LUZ. DOS ENTRADAS LATERALES CON MANGAS DE SEGURIDAD DE TELA COLOR NEGRO. QUE PERMITA LOS MOVIMIENTOS DEL USUARIO. TRES RECIPIENTES, UNO PARA LIQUIDO REVELADOR. OTRO PARA AGUA Y OTRO PARA FIJADOR. GANCHO PORTA PLACAS. FABRICANTE: MARCA: MODELO: PROCEDENCIA:	PIEZAS	30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SE ACEPTA

✓

7

CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ANEXO 1 B

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ANÁLISIS TÉCNICO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-UPN-116/2015 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	4.5.1. CARTA DE GARANTÍA 24 M	4.5.2. REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR SSA	4.5.3 AVISO DE FUNCIONAMIENTO	4.5.4 OPINION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SAT 2015	4.5.5 CARTA BAO PROTESTA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGARA LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN BASES	4.5.6 CARTA BAO PROTESTA DE DEBER VERDAD QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LA NORMA DE CALIDAD	4.5.7. CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) TUV, CE, FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS)	4.5.8.- FOLLETOS, FICHAS O CATALOGOS	OBSERVACIONES
8	UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL EQUIPO DE RAYOS X QUE SE EMPLEA PARA ESTUDIOS RADIOGRAFICOS DE PADECIMIENTOS ESTOMATOLOGICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: CONTROL DE TIEMPO DE EXPOSICION, TRASFORMADOR DE ALTA TENSION, TUBO DE RAYOS X DE ANODO FIJO CON UN PUNTO FOCAL MA Y KV, SOPORTE PARA EL EQUIPO. LOCALIZADOR.	PIEZAS	8	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SE ACEPTA

Fecha de elaboración: martes, 8 de diciembre de 2015

ELABORO:

LIC. EMILIO ALFREDO RAMIREZ GONGORA
AREA DE LICITACIONES
REVISO

DRA. ELIZABETH GUADALUPE SILVA MUÑOZ
COORDINADORA ESTADAL DE ESTOMATOLOGIA DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

C.P. ELIZABETH SUÁREZ BOCARDO
JEFA DE OFICINA DE ADQUISICIONES
Vo/Bu
LIC. YEILA HERNÁNDEZ ARRASCO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RUM, SA DE CV, ANEXO 1.A

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-IPN-116/2015 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	4.5.1. CARTA DE GARANTÍA 24 M	4.5.2. REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR SSA	4.5.3. AVISO DE FUNCIONA MIENTO	4.5.4. OPINION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SAT 2015	4.5.5. CARTA BAJO PROTESTA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGARA LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN BASES	4.5.6. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LA NORMA DE CALIDAD	4.5.7.- CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001- 2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) TUV, CE, FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS)	4.5.8.- FOLLETOS, FICHAS O CATALOGOS	OBSERVACIONES
1	ULTRA CENTRIFUGA REFRIGERADA 5418R, SEGUN J.A. 0.- CENTRIFUGA REFRIGERADA FOLLETO PAGINA 1 PAG 1. 1.- EQUIPADA CON UN ROTOR DE 18 TUBOS DE 1,5/2,0 ML HERMATICOS A LOS AEROSOL- ESTANDAR ULTRA CENTRIFUGA REFRIGERADA 5415R, PAG 1,2.- 2.- CON TAPA DE ROTOR PAG 2.- 3.- VELOCIDAD HASTA 16.837 X G (14.000 RPM) PAG 1.- 4.- BOTON SHORTSPIN APARTE PARA MAYOR ACCELERACION PAG 1.- 5.- BOTON CONVERTIDOR RPM/RCF SEPARADO PAG 1.- 6.- OPERACION CON MANDO GIRATORIO PARA UNA RAPIDA SELECCION DE PARAMETROS CARACTERISTICAS DE PRODUCTO ADICIONALES DE CENTRIFUGA REFRIGERADA 5418 R PAG 1.- 7.- INDICE DE TEMPERATURA. DE 0? C A -40? C PAG 1.- 8.- BALA ALTURA DE ACCESO DE 23 CM. COMO UNIDAD DE REFRIGERACION SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR PAG 1.- 9.- MANTENEN CONSTANTE LA TEMPERATURA DE 4 C A MÁXIMA VELOCIDAD PAG 1.- 10.- FAST TEMP PARA UNA PRE-REFRIGERACION DE LA CENTRIFUGA PAG 1.- 11.- LA REFRIGERACION CONTINUA MANTIENE LA TEMPERATURA CUANDO EL PROCESO DE CENTRIFUGACION NO ESTA ACTIVO PAG 1.	EQUIPO	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SE ACERTA

Fecha de elaboracion: martes, 8 de diciembre de 2015

AUTORIZO:

QFD. ROSA FABRICA SANCHEZ GUTIERREZ
JEFA DEL AREA DE CONTROL DE EPIDEMIOLOGIA

ELABORO:
LIC. EMILIO ALFREDO RAMÍREZ GÓNGORA
ÁREA DE LICITACIONES
REVISÓ

C.P. ELIZABETH SUÁREZ BOCARDO
JEFA DE OFICINA DE ADQUISICIONES

LIC. VELLA HERNANDEZ GABRASO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PROMEDENTAL S.A. DE C.V. ANEXO 18

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	4.5.1. CARTA DE GARANTÍA 24 M	4.5.2. REGISTRO DE EMITIDO POR SSA	4.5.3 AVISO DE FUNCIONA MIENTO	4.5.4 OPINION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SAT 2015	4.5.5 CARTA BAJO PROTESTA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGARA LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN BASES	4.5.6 CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LA NORMA DE CALIDAD	4.5.7.- CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001- 2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) TUV, CE, FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS)	4.5.8.- FOLLETOS, FICHAS O CATALOGOS	OBSERVACIONES
1	AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR ESTOMATOLOGICO. EQUIPO PORTATIL. AMALGAMADOR PARA CAPSULAS PREDOSIFICADAS (DE ACUERDO A RESPUESTA 23 DE JUNTA DE ACLARACIONES) MARCA: RITTER MODELO: VIBRAMAT PROCEDENCIA: ALEMANIA UNIDAD DENTAL (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) DESCRIPCION ADICIONAL: UNIDAD DENTAL PORTATIL	PIEZAS	18	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SE ACEPTA
4	MARCA: TROPHY MODELO: PORTATIL PROCEDENCIA: COLOMBIA UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRAD. EQUIPO FIJO. ELECTRO HIDROEUMATICO, DE TECNOLOGIA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICOS EN LA ATENCION ESTOMATOLOGICA INTEGRAL DEL PACIENTE. LAMPARA ESTOMATOLOGICA. INTEGRADA AL SILON, CABEZAL DE ALUMINIO, ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACION NATURAL, CON UN HAZ DE LUZ FRIA ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS, INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE, ILUMINACION DENTRO DEL RANGO DE 10.000 A 50.000 LUXES, CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3.500 ° K O MAYOR, CON ENFRAMIENTO POR FILTROS OPTICOS, REFLECTOR DICOICO, REDUCTORES DE CALOR (NO EXCEDER 87 LA TEMPERATURA AMBIENTE EN LA DISTANCIA FOCAL). MODULO ESTOMATOLOGICO- INTEGRADO AL SILON CON ALTURA AJUSTABLE EN CONJUNTO CON EL SILON, POSICIONABLE EN CUALQUIER PUNTO A REDEDOR DE 270º COMO MINIMO. NEGATOSCOPIO INTEGRADO AL MODULO, CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA ALIMENTAR Y CONTROLAR EL AIRE Y EL AGUA EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVES DE BLOQUEO AUTOMATICO. BOTELLA DE AGUA PURIFICADA CON SISTEMA DE VALVULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO, MANOMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2, REGULADORES DE PRESION DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VIAS, DESMONTABLE. MARCA: RITTER MODELO: ECO PROCEDENCIA: ALEMANIA	PIEZAS	3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SE ACEPTA
5	UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA. UNIDAD DE PROFILAXIS DENTAL, NO INVASIVO PARA LA REMOCION DE SARRO, MANCHAS, GENERADOR DE FRECUENCIA DE TRABAJO DE 25 A 45 HZ, SELECTOR DE POTENCIA: CONSUMO DE 17 A 30 WATTS, ALIMENTACION DE AGUA CON CONTROL PARA REGULAR LA PRESION, ROCIO O SPRAY, PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE EN SUSTANCIAS QUIMICAS VIO VAPOR, INSERTOS O PUNTAS FABRICADAS DE TITANIO O ALINEACION DE METAL/DIAMANTE/CARBONO, INTERCAMBIABLES, ESTERILIZABLES EN VAPOR (TRES). MARCA: RITTER MODELO: UDS K PROCEDENCIA: ALEMANIA	PIEZAS	5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO SE ACEPTA DEBIDO A QUE SOLO CUENTA CON DOS MOVIMIENTOS Y NO INCLUYE BANOJILLO GIRATORIO
6	UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA. UNIDAD DE PROFILAXIS DENTAL, NO INVASIVO PARA LA REMOCION DE SARRO, MANCHAS, GENERADOR DE FRECUENCIA DE TRABAJO DE 25 A 45 HZ, SELECTOR DE POTENCIA: CONSUMO DE 17 A 30 WATTS, ALIMENTACION DE AGUA CON CONTROL PARA REGULAR LA PRESION, ROCIO O SPRAY, PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE EN SUSTANCIAS QUIMICAS VIO VAPOR, INSERTOS O PUNTAS FABRICADAS DE TITANIO O ALINEACION DE METAL/DIAMANTE/CARBONO, INTERCAMBIABLES, ESTERILIZABLES EN VAPOR (TRES). MARCA: RITTER MODELO: UDS K PROCEDENCIA: ALEMANIA	PIEZAS	24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SE ACEPTA



PROGMENTAL S.A. DE C.V. ANEXO 18

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	4.5.1. CARTA DE GARANTÍA 24 M	4.5.2. REGISTRO DE EMITIDO POR SSA	4.5.3 AVISO DE FUNCIONAMIENTO	4.5.4 OPINION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SAT 2015	4.5.5 CARTA BAJO PROTESTA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGARA LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN BASES	4.5.6 CARTA BAJO PROTESTA DE DECOR VERDAD QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LA NORMA DE CALIDAD	4.5.7.- CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) TUV, CE, FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS)	4.5.8.- FOLLETOS, FICHAS O CATALOGOS	OBSERVACIONES
7	REVELADOR MANUAL DE PLACAS DENTALES. INSTRUMENTO PORTATIL PARA REVELAR MANUAMENTE PLACAS RADIOGRAFICAS DENTALES. GABINETES DE ACRILICOTRASPARENTE, SELLADO PARA IMPEDIR EL PASO DE LA LUZ; DOS ENTRADAS LATERALES CON MANGAS DE SEGURIDAD DE TELA COLOR NEGRO, QUE PERMITA LOS MOVIMIENTOS DEL USUARIO, TRES RECIPIENTES, UNO PARA LIQUIDO REVELADOR, OTRO PARA AGUA Y OTRO PARA FIADOR, GANCHOS PORTA PLACAS. MARCA: BORGATTA MODELO: REVELADOR DE PLACAS PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZAS	30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SE ACEPTA
8	UNIDAD DE RADIOLOGIA DENTAL, EQUIPO DE RAYOS X QUE SE EMPLEA PARA ESTUDIOS RADIOGRAFICOS DE PADECIEMIENTOS ESTOMATOLOGICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: CONTROL DE TIEMPO DE EXPOSICION, TRANSFORMADOR DE ALTA TENSION, TUBO DE RAYOS X DE ANODO HIO CON UN PUNTO FOCAL MA Y KV, SOPORTE PARA EL EQUIPO, LOCALIZADOR, MARCA: IMAGE X MODELO: MURRO PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZAS	8	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA	NO SE ACEPTA DEBIDO A QUE EN SU FICHA TECNICA NO OFERTA EL CHALECO DE PLOMO

Fecha de elaboracion: martes, 8 de diciembre de 2015

Lic. Emilia Arreola Ramirez Gongora
ÁREA DE LICITACIONES
RELEVADO

Dra. Elizabeth Guadalupe Silva Muñoz
COORDINADORA ESTATAL DE ESTOMATOLOGIA DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

C.P. ELIZABETH SUAREZ BOCARDI
JEFA DE OFICINA DE ADQUISICIONES
C. B.
LIC. VELLIA HERNANDEZ CARRASCO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

COMERCIALIZADORA TECNOEQ-MEX. S.A. DE C.V. ANEXO 1A

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-116/2015 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	4.5.1. CARTA DE GARANTÍA 24 M	4.5.2. REGISTRO DE SANITARIO EMITIDO POR SSA	4.5.3. AVISO DE FUNCIONA MIENTO	4.5.4. OPINION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SAT 2015	4.5.5. CARTA BAJO PROTESTA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGARÁ LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN BASES	4.5.6. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LA NORMA DE CALIDAD	4.5.7. CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) TUV, CE, FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS)	4.5.8.- FOLLETOS, FICHAS O CATALOGOS	OBSERVACIONES
2	BAÑO MARIA CON CIRCULACIÓN TERMO EXTERNA 21 CM; TINA 14X39X15 CM; PARA 40 TUBOS; CAPACIDAD 6.3 LITROS TERMO BAÑOS DIGITALES CARACTERÍSTICAS: SENSOR DE PLATINO TIPO PT-100 - TINA DE UNA SOLA PIEZA -RESISTENCIA TUBULAR PARA INMERSIÓN EN ACERO INOXIDABLE - TAPAS Y CUBIERTAS EN ACERO INOXIDABLE -GABINETE TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE -CAPACIDAD PARA 40, 80 Y 160 TUBOS DE ENSAYO ESTÁNDAR -FABRICACIONES ESPECIALES SOBRE MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES DE USUARIO CARACTERÍSTICAS DE CONTROL -CONTROL DE TEMPERATURA PROGRAMABLE, A BASE DE MICROPROCESADOR DE ENTRADAS UNIVERSAL, TIPO P.I.D. O AUTOTUNING (AUTO SINTONIA), CONTROL DE FASE-AHORRO DE ENERGÍA -RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE +5º C A 200º C -SENSIBILIDAD +0.1º C -DOBLE DISPLAY	EQUIPO	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SE ACEPTA
	MARCA: TERLAB MODELO: TERBA00 PROCEDENCIA: NACIONAL FABRICANTE: TERLAB S.A. DE C.V.											
4	AGITADOR CON PLATO DE CALENTAMIENTO CIMAREC SP88850100 DE 26 X 26 -PLATO DE CERÁMICA - RANGO DE AGITACIÓN 50-1500RPM -TEMPERATURA A 400 C -AGITACIÓN MAGNÉTICA -INCLUYE BARRA DE AGITACIÓN -PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO	EQUIPO	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SE ACEPTA
	MARCA: THERMO SCIENTIFIC MODELO: CIMAREC PROCEDENCIA: USA FABRICANTE: THERMO FISHER SCIENTIFIC											

Fecha de elaboración: martes, 8 de diciembre de 2015

Elaborado por
LIC. EMILIO ALFREDO RAMÍREZ GÓNGORA
ÁREA DE LICITACIONES
REVISO

Autorizado por
OFD. ROSA FABRICA SANCHEZ GUTIERREZ
JEFA DEL ÁREA DE CONTROL DE EPIDEMIOLOGIA

LIC. VELIA HERNÁNDEZ GONZALEZ
JEFA DE OFICINA DE ADQUISICIONES
Vo. Bo.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MANUTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V. AMBRO 1B

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	4.5.1. CARTA DE GARANTÍA 24 M	4.5.2. REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR SSA	4.5.3 AVISO DE FUNCIONAMIENTO	4.5.4 OPINION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SAT 2015	4.5.5 CARTA BAJO PROTESTA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ENTREGARA LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN BASES	4.5.6 CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LA NORMA DE CALIDAD	4.5.7.- CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) TUV, CE, FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS)	4.5.8.- FOLLETOS, FICHAS O CATALOGOS	OBSERVACIONES
1	UNIDAD DE RADIOLOGIA DENTAL. EQUIPO DE RAYOS X QUE SE EMPLEA PARA ESTUDIOS RADIOGRÁFICOS DE PADECIMIENTOS ESTOMATOLÓGICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: 1. CONTROL DE TIEMPO DE EXPOSICION; Catalogo pag. 2. 2. TRANSFORMADOR DE ALTA TENSIÓN. Catalogo pag. 2. 3. TUBO DE RAYOS X DE ANODO. FIBRO CON UN PUNTO FOCAL DE 0.8 X 0.8 mm. Catalogo pag. 2. 4. CORRIENTE ANODICA DE MA 8 Y 6. LOCALIZADOR (CONO LARGO). Catalogo pag. 1. 2. Marca: Coramex Modelo Corix 70 plus Fabricante: Coramex, S.A. Procedencia: México	PIEZAS	8	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SE ACEPTA

Fecha de elaboración: martes, 8 de diciembre de 2015

ELABORÓ:
LIC. EMILIO ALBERTO RAMÍREZ GONGORA
ÁREA DE LICITACIONES
REVISÓ

COORDINADORA ESTATAL DE ESTOMATOLOGÍA DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA


C.P. ELIZABETH ALAREZ BOCARDO
JEFA DE OFICINA DE ADQUISICIONES
V.O. B.O.

LIC. VERÓNICA ANDRÉS CARRASCO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES SERVICIOS Y ADQUISICIONES
 DICTAMEN TECNICO Y REVISION LEGAL DE LA CONVOCANTE
 LICITACION PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-116/2015
 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO


REQUISITOS /LICITANTE	DESENLAZAMIENTO ADMINISTRATIVO	COMERCIALIZADORA TECNOLÓGICA MEX SA DE CV	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTÍCULOS DE CURACION Y LABORATORIOS	INFUSOMED SA DE CV	COOPERATIVO PROMEDICA DE MEXICO SA DE CV	IRUM SA DE CV	PROMEDENT SA DE CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV
DOCUMENTOS LEGALES	CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE LAS FACTURAS SOLICITADAS EN EL PUNTO 3.11 NO CUMPLEN YA QUE NINGUNA CONTIENE BIENES IGUALES A LOS BIENES SOLICITADOS EN ESTA LICITACION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE CON EL PUNTO 3.1. YA QUE LA ACTIVIDAD NO COINCIDE CON LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACION ASÍ MISMO LAS FACTURAS SOLICITADAS EN EL PUNTO 3.11 NO CUMPLE YA QUE SOLO UNA FACTURA CONTIENE UN BIEN IGUAL A LOS BIENES SOLICITADOS EN ESTA LICITACION	CUMPLE	CUMPLE
REQUISITOS TECNICOS ANEXO B TIEMPO DE ENTREGA	SEGÚN BASES	SEGÚN BASES	SEGÚN BASES	SEGÚN BASES	SEGÚN BASES	SEGÚN BASES	SEGÚN BASES	SEGÚN BASES

1

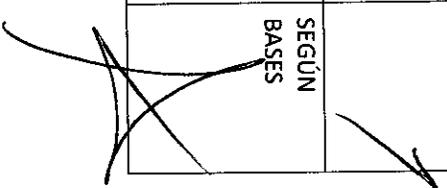


DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES SERVICIOS Y ADQUISICIONES
 DICTAMEN TECNICO Y REVISION LEGAL DE LA CONVOCANTE
 LICITACION PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-116/2015
 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

REQUISITOS /LICITANTE	DESENVOLUCE ADMINISTRATIVO O	COMERCIALIZA DORA TECNOLÓGICO-MEX SA DE CV	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIOS	INFUSOMED SA DE CV	COOPERATIVO PROMEDICA DE MEXICO SA DE CV	IRUM SA DE CV	PROMEDEN TAL SA DE CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV
TIEMPO DE GARANTIA	SEGÚN BASES	SEGÚN BASES	SEGÚN BASES	SEGÚN BASES	SEGÚN BASES	SEGÚN BASES	SEGÚN BASES	SEGÚN BASES
4.5.1.carta de vicios ocultos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SEGÚN BASES CUMPLE	SEGÚN BASES CUMPLE
4.5.2.reg sanitario	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO PARTIDA 5 DEL ANEXO B LOS DEMAS CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE EN LA PARTIDA 4 DEL ANEXO 1 B NO PRESENTA REGISTRO	CUMPLE
4.5.3. aviso de funcionamiento	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.5.4. Opinion de cumplimiento al mes de noviembre	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.5.5.carta bajo protesta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.5.6. carta que cumple con las normas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.5.7.certificados de calidad	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LAS PARTIDAS 1, 6,7,8	ANEXO 1A PARTIDA 2 CERTIFICADO NO COINCIDE CON MARCA O	NO CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA CERTIFICACIONES DE LAS PARTIDAS 4	

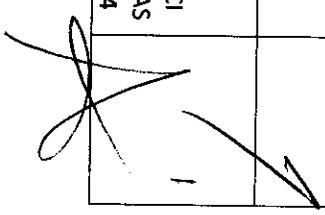

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES SERVICIOS Y ADQUISICIONES
 DICTAMEN TECNICO Y REVISION LEGAL DE LA CONVOCANTE
 LICITACION PUBLICA NACIONAL GET-LPN-116/2015
 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

REQUISITOS /LICITANTE	DESENLACE ADMINISTRATIVO	COMERCIALIZA DORA TECNOEQ-MEX SA DE CV	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIOS	INFUSOMED SA DE CV	COORPORATIVO PROMEDIGA DE MEXICO SA DE CV	IRUM SA DE CV	PROMEDENTAL SA DE CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV
4.5.8. folletos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Y 7 DEL ANEXO 1 B	
				FABRICANTE POR LO QUE NO CUMPLE			CUMPLE TODAS EXCEPTO LA PARTIDA 5 DEL ANEXO 1 B YA QUE EL FOLLETO INDICA QUE ES DE DOS MOVIMIENTOS Y NO INCLUYE BANQUILLO GIRATORIO Y LA PARTIDA 8 DEL ANEXO 1 B NO SE INCLUYE EN FICHA TECNICA EL CHALECO DE PLOMO	



DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES SERVICIOS Y ADQUISICIONES
 DICTAMEN TECNICO Y REVISION LEGAL DE LA CONVOCANTE
 LICITACION PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-116/2015
 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO


REQUISITOS / LICITANTE	DISEÑALCE ADMINISTRATIVO O	COMERCIALIZA DORA TECNOLÓGICO-MEX SA DE CV	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIOS	INFUSOMED SA DE CV	COORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO SA DE CV	IRUM SA DE CV	PROVIDEN TAL SA DE CV	MANTENIMI ENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV
PARTIDAS COTIZADAS	ANEXO 1 A- 2,3,10 ANEXO 1B- 1,2,3,4,5,6,7,8,	ANEXO 1 A PARTIDAS 2 Y 4 ANEXO 1 B 1,2,5,6,7,8	ANEXO 1B PARTIDAS 1, 3,5,6,7,8	ANEXO 1 A PARTIDAS 1,2,7,10,11 ANEXO 1 B PARTIDAS 2,3,5,	ANEXO 1 A PARTIDAS 1,2,3,4,7,8,9,10, 11 ANEXO 1 B PARTIDAS 1,2,3,4,5,6,7, 8	ANEXO 1 A PARTIDA 7	ANEXO 1 B PARTIDAS 1,4,5,6,7 Y 8	ANEXO 1 B PARTIDA 8
DESCRIPCION	CUMPLE TODAS LAS COTIZADAS EXCEPTO ANEXO 1 A PARTIDA 10 OFERTA UN AUTOCLAVE CON CAPACIDAD DE 86 LITROS Y SE REQUIERE DE 206 LT SEGÚN RESPUESTA DE LA PREGUNTA 28 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE TODAS EXCEPTO PARTIDA 10 DEL ANEXO 1 A YA QUE EN LA DESCRIPCION NO INDICA LA CAPACIDAD DE 206 LT INDICADA EN LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 28 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PARTIDAS ACEPTADAS	ANEXO 1 A PARTIDA 2	NINGUNA	ANEXO 1 B PARTIDA 3	ANEXO 1 A PARTIDAS 1,7,11 ANEXO 1 B	ANEXO 1 B PARTIDA 1,3,4,5,6,7,8,	NINGUNA	ANEXO 1 B PARTIDAS 1,6	ANEXO 1 B PARTIDA 8

1



DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES SERVICIOS Y ADQUISICIONES
 DICTAMEN TECNICO Y REVISION LEGAL DE LA CONVOCANTE
 LICITACION PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-116/2015
 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

REQUISITOS / LICITANTE	DESENLACE ADMINISTRATIVO	COMERCIALIZA DORA TECNOEQ-MEX SA DE CV	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIOS	INFUSOMED SA DE CV	COORPORATIVO PROMEDICA DE MEXICO SA DE CV	IRUM SA DE CV	PROMEDENTAL SA DE CV	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV
OBSERVACIONES	<p>ANEXO 1B- PARTIDAS 1,2,3,4,5,6,7,8, CONTRATANTE INDICA QUE LA PARTIDA 4 DEL ANEXO B NO CUMPLE PORQUE NO INDICA CON SILLON PORTATIL, PERO EN SU DESCRIPCION NO FUE SOLICITADA CON SILLON PORTATIL, POR LO QUE SE ACEPTA.</p> <p>EN LA PARTIDA 2 DEL ANEXO 1 A, LA CONTRATANTE INDICA EN SU DICTAMEN QUE LAS NORMAS</p>	DESCALIFICADO POR NO CUMPLIR LEGALMENTE	AL REVISAR PROPUESTA NO TRAE TODOS LOS CERTIFICADOS SOLICITADOS EN LAS RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS 12 Y 16 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES NI REGISTRO DE LA PARTIDA 5 DEL ANEXO 1 B	PARTIDAS 2,3,5,	<p>CONTRATANTE INDICA QUE LA PARTIDA 4 DEL ANEXO B NO CUMPLE PORQUE NO INDICA CON SILLON PORTATIL, PERO EN SU DESCRIPCION NO FUE SOLICITADA CON SILLON PORTATIL, POR LO QUE SE ACEPTA</p>	DESCALIFICADO POR NO CUMPLIR LEGALMENTE		

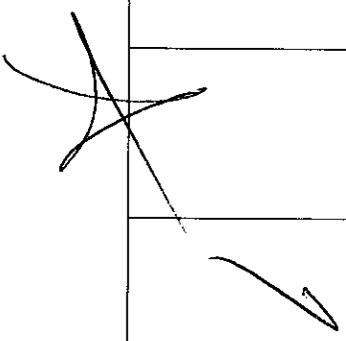


DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES SERVICIOS Y ADQUISICIONES
 DICTAMEN TECNICO Y REVISION LEGAL DE LA CONVOCANTE
 LICITACION PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-116/2015
 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

REQUISITOS /LICITANTE	DESENLAGE ADMINISTRATIVO O	COMERCIALIZA DORA TECNOEQ.MEX SA DE CV	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIOS	INENSOMED SA DE CV	COOPERATIVO PROMEDICA DE MEXICO SA DE CV	IRUM SA DE CV	PROMEDEN TAL SA DE CV	MANTENIMI ENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV
	REFERIDADAS NO SON APLICABLES , SE ANALIZAN LAS MISMAS Y SE DETERMINA QUE SI SON, INDEPENDIENTE MENTE QUE LA CONTRATANTE NO INDICO CUALES ERAN LAS NORMAS QUE TENIAN QUE CUMPLIR.							
PARTIDAS NO ACEPTADAS	ANEXO 1 A PARTIDA 10 OFERTA UN AUTOCLAVE CON CAPACIDAD DE 86 LITROS Y SE REQUIERE DE 206 LT SEGUN	ANEXO 1 A PARTIDAS 2 Y 4 ANEXO 1 B 1,2,5,6,7,8 POR NO CUMPLIR CON LAS FACTURAS SOLICITADAS, YA QUE SE PIDEN DE BIENES IGUALES	NO PRESENTA CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LAS PARTIDAS 1, 6,7,8 DEL ANEXO 1 B TAL COMO SE SOLICITO EN BASES Y EN JUNTA DE ACLARACIONES DE LA PARTIDA 5 DEL ANEXO 1 B NO	ANEXO 1A PARTIDA 2 CERTIFICADO NO COINCIDE CON MARCA O FABRICANTE POR LO QUE NO CUMPLE PARTIDA 10 DEL ANEXO 1 A	ANEXO 1 A PARTIDA 1,2,3,4,7,8,9,10, 11 ANEXO 1 B PARTIDA 2 EN VIRTUD QUE NO PRESENTA LO SOLICITADO EN LOS PUNTOS 4.5.2, 4.5.6,	ANEXO 1 A PARTIDA 7	PARTIDAS 4 Y 7 DEL ANEXO 1 B NO PRESENTA CERTIFICACIONES DE CALIDAD SOLICITADAS EN BASES Y JUNTA DE	✓




DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES SERVICIOS Y ADQUISICIONES
 DICTAMEN TECNICO Y REVISION LEGAL DE LA CONVOCANTE
 LICITACION PÚBLICA NACIONAL GET-1PN-116/2015
 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

REQUISITOS /LIGANTE	DESENLACE ADMINISTRATIVO	COMERCIALIZA DORA TECNOL-MEX SA DE CV	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIOS	INFUSOMED SA DE CV	COORDINATIVO PROMEDICA DE MEXICO SA DE CV	IRUM SA DE CV	PROMEDEN TAL SA DE CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV
	RESPUESTA DE LA PREGUNTA 28 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES ANEXO 1 A PARTIDA 3 EL FOLLETO NO COINCIDE CON LA DESCRIPCION OFERTADA, ESTA INCOMPLETO	Y NINGUNA DE LAS PRESENTADAS CONTIENE	PRESENTA REGISTRO SANITARIO	YA QUE EN LA DESCRIPCION NO INDICA LA CAPACIDAD DE 206 LT INDICADA EN LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 28 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES	Y/O 4.5.8. DE LAS BASES		ACLARACIONES, PARTIDA 5 DEL ANEXO 1 B YA QUE EL FOLLETO INDICA QUE ES DE DOS MOVIMIENTOS Y NO INCLUYE BANQUILLO GIRATORIO Y LA PARTIDA 8 DEL ANEXO 1 B NO SE INCLUYE EN FICHA TECNICA EL CHALECO DE PLOMO NO CUMPLE EN LA PARTIDA 4 DEL ANEXO 1 B NO	1

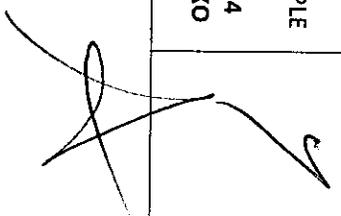

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES SERVICIOS Y ADQUISICIONES
 DICTAMEN TECNICO Y REVISION LEGAL DE LA CONVOCANTE
 LICITACION PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-116/2015
 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

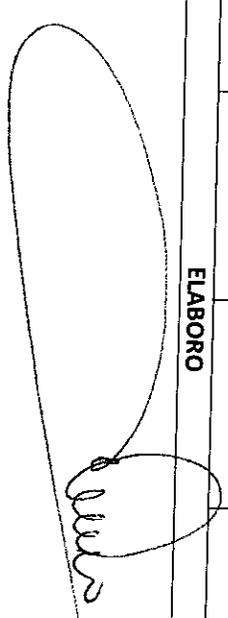
REQUISITOS LICITANTE	DESENLAJE ADMINISTRATIVO	COMERCIALIZA DORA TECNOLÓGICA MEX SA DE CV	PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIOS	INFUSOMED SA DE CV	COOPERATIVO PROMEDICA DE MEXICO SA DE CV	IRUM SA DE CV	PROMEDENTAL SA DE CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV
ELABORO								
								
AUTORIZO								
								
ALMA LUZ VILLEGAS POZAS								
JORGE CAPIZ JASSO								
							PRESENTA REGISTRO	



[Handwritten signature]

Santa Ana Chiautempan, Tlax., a 21 de Diciembre de 2015.

C. Jorge Capiz Jasso
Director de Recursos Materiales, Servicios
y Adquisiciones de Gobierno del Estado
Presente.

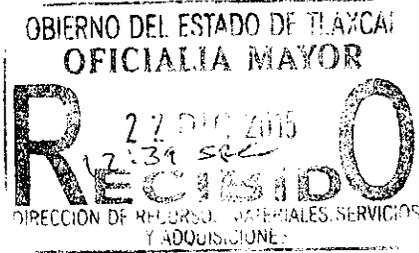

Derivado del minucioso y detallado análisis que realizaron las áreas de Coordinación Estatal de Estomatología y la Dirección de Laboratorio Estatal a las propuestas que presentaron los proveedores participantes, envío a usted el Dictamen Económico de la Licitación Pública Nacional número GET-LPN-116/2015, referente a la adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio correspondiente a la partida 53101, misma información ya fue enviada vía correo electrónico; por lo que solicito de la manera más atenta de continuidad al proceso antes citado. No omito mencionar que las partidas 1,3 y 10 del Anexo 1 A y la partida 4 del Anexo 1 B no se aceptan por así convenir los intereses del O.P.D. Salud de Tlaxcala, lo anterior con fundamento en el punto 16.5 de las bases, las partidas 7 y 11 del Anexo 1 A y las partidas 1, 2, 6 y 8 de Anexo 1 B no se aceptan por restricciones presupuestales del O.P.D. Salud de Tlaxcala ya que rebasan el techo presupuestal en plataforma, de conformidad en el punto 16.7 de las bases.

Atentamente

[Handwritten signature]

C.P. Luz María Portillo García
Directora de Administración
del O.P.D. Salud de Tlaxcala

[Handwritten signature]

Lic. Velia Carrasco Hernández
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
del O.P.D. Salud de Tlaxcala

Anexos:

Dictamen Económico original de la Licitación Pública Nacional GET-LPN-116/2015 para la adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio.

Copias:

- ❖ c.c.p.- Lic. Ubaldo Velasco Hernández.- Oficial Mayor de Gobierno del Estado.- Para su conocimiento.
- ❖ c.c.p.- Dra. Elizabeth Guadalupe Silva Muñoz.- Coordinadora Estatal de Estomatología del O.P.D. Salud de Tlaxcala.- Para su conocimiento.
- ❖ c.c.p.- Quim. Cristina Montalvo Melo.- Directora del Laboratorio Estatal del O.P.D. Salud de Tlaxcala.- Para su conocimiento.

[Handwritten signature]
Esp/earg

Ignacio Picazo Nte. No. 25
Col Centro, Chiautempan Tlax. C.P. 39000

[Handwritten signature]
22-12-2015



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ANÁLISIS ECONOMICO

SALUD DE TLAXCALA
Secretaría de Salud en el
Estado de Tlaxcala

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. GET-IPN-116/2015 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA DEL PROVEEDOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.		CORPORATIVO PROMÉDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACIÓN Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.		DISEÑACE ADMINISTRATIVO S.C.		INFUSOMED, S.A. DE C.V.		OBSERVACIONES
			C. UNIT.	C. TOTAL	C. UNIT.	C. TOTAL	C. UNIT.	C. TOTAL	C. UNIT.	C. TOTAL	C. UNIT.	C. TOTAL	
<p>ESPECTROFOTÓMETRO SMARTSPEC PLUS ESPECTROFOTÓMETRO - CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS (SSDNA, SSRNA, RNA, OLIGONUCLEOTIDOS) - CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDOS PROTEÍNAS (280 NM, BRADFORD, LOWRY, BCA) - CÁLCULO DEL GROSOR DE LA CELULA (OD600) - TASA DE UNIÓN DE MATERIALES DE COLOR FLUORESCENTE (DYE 550/550, POR EJEMPLO CYS, CYS) PRUEBAS ENZIMÁTICAS: DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUIVALENCIA (POR EJEMPLO DE ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS O PRUEBAS DE BIOLOGÍA CELULAR) - MEDICIÓN DIRECTA DE LA ABSORCIÓN DE LONGITUDES DE ONDA - INDIVIDUALES SIN CÁLCULOS ADICIONALES (230NM, 260NM, 280NM, 340NM, 405NM, 490NM, 550NM, 595NM, 650NM) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - 9 LONGITUDES DE ONDA, CON LAS QUE SE PUEDE EFECTUAR LAS MEDICIONES HABITUALES EN TRABAJOS DE BIOLOGÍA MOLECULAR, BIODINÁMICA Y BIOLOGÍA CELULAR - MÉTODOS REPROGRAMADOS PARA LA CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS Y PROTEÍNAS, ASÍ COMO LA TASA DE UNIÓN DE MATERIALES DE COLOR FLUORESCENTE - CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LOS RESULTADOS, FACTORES DE REDUCCIÓN INCLUIDOS - MEDICIONES DE LONGITUDES DE ONDA INDIVIDUALES SIN CÁLCULOS - REGISTRO DE LOS ÚLTIMOS 100 RESULTADOS CON TODOS LOS DATOS CORRESPONDIENTES SISTEMA ÓPTICO: FOTÓMETRO DE ABSORCIÓN DE HAZ ÚNICO CON RAYO DE REFERENCIA FUENTE DE LUZ: LÁMPARA DE RAYO XENÓN, ALTURA DE RAYO DE LUZ : 8.5 MM LONGITUDES DE ONDA: 230, 260, 280, 340, 405, 550, 595, 650 ANCHO DE BANDA ESPECTRAL: 5NM EN 230-340NM, 7NM EN 405-650NM VERIFICACIÓN DE LAS LONGITUDES DE ONDA +- 1NM EN 230-280NM +- 2NM EN 340-650NM ÁREA DE MEDICIÓN FOTOMÉTRICA: 0.3 A 12 A EN 340NM; DYE METHODS: 2 A EN 550NM/650NM PRECISION FOTOMÉTRICA: + 0.002 A EN 0 A; + 0.005 A EN 1 A. VELOCIDAD: FOTOMÉTRICA: + 1% EN 1 A MEMORIA DE RESULTADOS: PARA RESULTADOS CON VALORES DE EXTINCÓN Y DE RATIO, NÚMERO DE LA MUESTRA, REDUCCIÓN DE MUESTRA, FECHA Y HORA INTERFAZ: RS-232 C, EN SERIE, CONEXIÓN AL PC OPCIONAL. POTENCIA ABSORBIDA: APROX. 20W EN SERVICIO, APROX. 10W EN MODO STAND-BY CONEXIÓN DE RED: 100-240 V, + 10%; 50-60 HZ, + 5% DIMENSIONES: (ANCHO X LARGO X ALTO): 20 X 32 X 10 CM PESO: 3KG</p>	EQUIPO	1											DESERTA
<p>AUTOCLAVE DE VAPOR AUTOGENERADO DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA AUTOCLAVE BIFÁSICA AGB-39 PUERTA EN BRONCE CROMADO Y SISTEMA DE CERRADO RADIAL CON VOLANTE GIRATORIO ABRIR-CERRAR *CÁMARA CONSTRUÍDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 12 TIPO 304 *GENERADOR DE VAPOR DE ACERO, EQUIPADO CON TRES RESISTENCIAS EN CASO DE FALTA DE AGUA *TERMOMETRO LECTOR DE TEMPERATURA EN CÁMARA *DOS VÁLVULAS AL FRENTE PARA LLENADO DE AGUA DRENAR *NIVEL DE AGUA VISIBLE AL FRENTE *PLACA CENTRAL CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO-APAGADO, FOCOS PILOTOS INDICADORES DE LINEA (AMARILLO), TERMOSTATO (ROJO), Y FALTA DE AGUA *CONTROL DE OPERACIONES (MANUAL), CON FUNCIONES DE ESTERILIZADO, EXPULSIÓN RÁPIDA PARA ROPA E INSTRUMENTAL Y SECADO *MANÓMETROS LECTORES DE PRESIÓN EN CÁMARA Y CAMISA *ACABADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE (FRENTE Y LATERALES CON HULE PROTECTOR AZUL) *CORRIENTE ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VOLTS Y TIERRA MODELO AGB-39 (95 X 90) BIFÁSICA</p>	EQUIPO	1	\$ 115,200.00	\$ 115,200.00	\$ 556,000.00	\$ 556,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 99,990.00	\$ 99,990.00			NO SE ACEPTA
<p>TERMOMIXER *FRECUENCIA DE MEZCLA ELEVADAS DE HASTA 3 000 RPM *MOVIMIENTO CIRCULAR CONTROLADO PERMITIENDO UNA MEZCLA RÁPIDA Y EFICIENTE EN TUBOS Y PLACAS *TECNOLOGÍA ANTI DERRAMES EVITA DE FORMA EFICAZ LA HUMECTACIÓN DE LA TAPA, ASÍ COMO LA CONTAMINACIÓN CRUZADA *CON TAPA QUE PREVIENE LA CONDENSACIÓN Y MEJORA LA HOMOGENEIDAD DE LA TEMPERATURA PARA MEJORES RESULTADOS DE LOS ENSAYOS *CALENTAMIENTO, MEZCLA Y ENFRÍAMIENTO EN TODOS LOS FORMATOS DE TUBOS Y PLACAS COMUNES DE 5 ML A 50 ML, APLICACIONES BÁSICAS CALENTAR/MEZCLAR/ENFRÍAR *RANGO DE TEMPERATURA MIN: 15? C (3) DEBAJO DE TA, MAX: 100 C VALORES DE AJUSTE MÍNIMO Y MÁXIMO 1 C / 100? C MÁXIMA EXACTITUD DE TEMPERATURA + 0.5? C A 20-45 C *HOMOGENEIDAD DE TEMPERATURA MAX + 0.5? C A 20-45 C (EN TODAS LAS POSICIONES DE LOS SMARTBLOCKS) MÁXIMA VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO 6 C /MIN MÁXIMA VELOCIDAD DE ENFRÍAMIENTO 2.5? C/MIN BETWEEN 100? C AND RT FRECUENCIA DE MEZCLA 300-3,000 RPM (DEPENDIENDO DEL SMARTBLOCKS UTILIZADO) TEMPORIZADOR 15 SEC A 99-30H, CONTINUO ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 100V - 130V + 10%, 50 HZ - 60 HZ 220V - 240V + 10%, 50 HZ - 60 HZ SALIDA 200 W (MAX.) DIMENSIONES (AN X PR X AL) 20.6 X 30.4 X 13.1 PESO 6.2 KG</p>	EQUIPO	1											NO SE ACEPTA
<p>ANEXO 1 B AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR ESTOMATOLÓGICO, EQUIPO PORTATIL, AUTOMÁTICO PARA LA CONFORMACIÓN DE AMALGAMAS, INTEGRADO POR UN DEPÓSITO PARA MERCURIO Y OTRO PARA LIMADURA.</p>	PIEZA	18	\$ 5,780.91	\$ 104,056.38	\$ 6,222.51	\$ 112,005.18	\$ 4,000.00	\$ 72,000.00					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ANÁLISIS ECONOMICO

SALUD DE TLAXCALA

Secretaría de Salud en el
Estado de Tlaxcala

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. GET-LPN-116/2015 REFERENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA DEL PROVEEDOR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.		CORPORATIVO PROMÉDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		PROVEEDORA MEXICANA DE ARTÍCULOS DE CUBIACIÓN Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.		DESENLAKE ADMINISTRATIVO S.C.		INFUSIONED, S.A. DE C.V.		OBSERVACIONES	
			C. UNIT.	C. TOTAL	C. UNIT.	C. TOTAL	C. UNIT.	C. TOTAL	C. UNIT.	C. TOTAL	C. UNIT.	C. TOTAL		C. UNIT.
PIEZA	20	2 COMPRESOR SUCCIONADOR (EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO) DESCRIPCIÓN ADICIONAL: ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL. EQUIPO SEMIORTAtil PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL Y MATERIAL POR MEDIO DE VAPOR AUTOGENERADO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: CONTROLADO POR MICROPROCESADOR. TIPO GABINETE O SOBREMESA. CON DEPÓSITO DE AGUA, SALIDA MANUAL DE AGUA A DRENAJE, CAMARA, PUERTA Y CHAROLAS PERFORADAS, CAPACIDAD Y MATERIAL DE LA CAMARA, DESPLEGUE DIGITAL DE PRESION, TEMPERATURA Y TIEMPO DE ESTERILIZACION, INSTRUMENTOS Y PAQUETES. CONTROL PARA EL TIEMPO DE ESTERILIZACION, CONTROL AUTOMATICO DE TODO PROCESO DE ESTERILIZACION, INDICADORES DEL PROCESO DE ESTERILIZACION Y DE FIN DE CICLO. SISTEMA DE SEGURIDAD: QUE IMPIDA LA APERTURA DE LA PUERTA DURANTE EL CICLO, VALVULA DE SEGURIDAD POR EXCESO DE PRESION, QUE INDIQUE FALLA DURANTE EL CICLO Y BAJA EN EL NIVEL DE AGUA, CON PRE VACIO Y POST VACIO A TRAVES DE BOMBA DE VACIO, PROGRAMAS PARA EL CICLO DE ESTERILIZACION, QUE INCLUYA, EL SECADO.	\$ 14,772.41	\$ 221,586.15	\$ 221,586.15	\$ 15,900.86	\$ 216,512.90	\$ 19,430.00	\$ 291,450.00	\$ 59,666.00	\$ 884,980.00	\$ 12,881.00	\$ 256,620.00	NO SE ACEPTA
PIEZA	15	3 ESTERILIZADOR DE TODO PROCESO DE ESTERILIZACION, INDICADORES DEL PROCESO DE ESTERILIZACION Y DE FIN DE CICLO. SISTEMA DE SEGURIDAD: QUE IMPIDA LA APERTURA DE LA PUERTA DURANTE EL CICLO, VALVULA DE SEGURIDAD POR EXCESO DE PRESION, QUE INDIQUE FALLA DURANTE EL CICLO Y BAJA EN EL NIVEL DE AGUA, CON PRE VACIO Y POST VACIO A TRAVES DE BOMBA DE VACIO, PROGRAMAS PARA EL CICLO DE ESTERILIZACION, QUE INCLUYA, EL SECADO.	\$ 9,922.03	\$ 237,660.90				\$ 10,150.00	\$ 30,450.00					NO SE ACEPTA
PIEZA	6	5 ESTOMATOLÓGICO: INTEGRADO AL SILLON CON ALTURA AJUSTABLE EN CONJUNTO CON EL SILLON, POSICIONABLE EN CUALQUIER PUNTO ALREDEDOR DE 270° COMO MÍNIMO. NEGATOSCOPIO INTEGRADO AL MÓDULO. CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA ALIMENTAR Y CONTROLAR EL AIRE Y EL AGUA EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVES DE BLOQUEO AUTOMATICO. ROTELLA DE AGUA PURIFICADA CON SISTEMA DE VALVULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO, MANOMÉTRICOS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2. REGULADORES DE PRESION DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VIAS, DESMONTABLE. MARCA: CONFORTE ORIGEN: NACIONAL MODELO: 2011-4E	\$ 96,850.51	\$ 581,103.06	\$ 104,248.75	\$ 625,492.50	\$ 40,000.00	\$ 240,000.00	\$ 83,333.00	\$ 499,998.00				SE ACEPTA
PIEZA	24	UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLÓGICA. UNIDAD DE PROFILAXIS DENTAL, NO INVASIVO PARA LA REMOCION DE SARRO, MANCHAS, GENERADOR DE FRECUENCIA DE TRABAJO DE 25 A 45 HZ, SELECTOR DE POTENCIA: CONSUMO DE 17 A 30 WATTS, ALIMENTACION DE AGUA CON 6 CONTROL PARA REGULAR LA PRESION, ROCIO O SPRAY, PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE EN SUSTANCIAS QUÍMICAS Y/O VAPOR, INSERTOS O PUNTA FABRICADAS DE TITANIO O ALINEACION DE MENTAL/DIAMANTE/CARBONO, INTERCAMBIABLES, ESTERILIZABLES EN VAPOR (ITRES)	\$ 13,043.95	\$ 334,654.80	\$ 15,009.12	\$ 360,216.08	\$ 6,860.00	\$ 167,040.00						NO SE ACEPTA
PIEZA	30	REVELADOR MANUAL DE PLACAS DENTALES. INSTRUMENTO PORTAtil PARA REVELAR MANUALMENTE PLACAS RADIOGRÁFICAS DENTALES. GABINETES DE AGRILICO TRANSPARENTE. SELLADO PARA IMPEDIR EL PASO DE LA LUZ. DOS ENTRADAS LATERALES CON MARGAS DE SEGURIDAD DE TELA COLOR NEGRO, QUE PERMITA LOS MOVIMIENTOS DEL USUARIO, TRES RECIPIENTES, UNO PARA LIQUIDO REVELADOR, OTRO PARA AGUA Y OTRO PARA FUADOR. GANCHO PORTA PLACAS.	\$ 543.10	\$ 16,293.00	\$ 584.80	\$ 17,538.00	\$ 1,160.00	\$ 34,800.00						SE ACEPTA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LICITACION PÚBLICA NACIONAL, NO. GET-LPN-116/2015 REFERENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA DEL PROVEEDOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.		CORPORATIVO PROMÉDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		PROVEEDORA MEXICANA DE ARTÍCULOS DE CURACIÓN Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.		DESERVICIA ADMINISTRATIVO S.C.		INFUSOMED, S.A. DE C.V.		OBSERVACIONES
			C. UNIT.	C. TOTAL	MONTO ACEPTADO	C. UNIT.	C. TOTAL	MONTO ACEPTADO	C. UNIT.	C. TOTAL	MONTO ACEPTADO	C. UNIT.	
UNIDAD DE RADIOLOGICA DENTAL EQUIPO DE RAYOS X QUE SE EMPLEA PARA ESTUDIOS: RADIGRAFICOS DE PADECIMIENTOS ESTOMATOLÓGICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES: MEDICAS: CONTROL DE TIEMPO DE EXPOSICION, TRANSFORMADOR DE ALTA TENSION, TUBO DE RAYOS X DE ANODO FIJO CON UN PUNTO FOCAL MA Y KV, SOPORTE PARA EL EQUIPO LOCALIZADOR	PIEZA	8	\$ 79,500.00	\$ 636,000.00	\$ 38,398.17	\$ 267,145.36	\$ 36,745.70	\$ 293,965.60	\$ 43,500.00	\$ 348,000.00			NO SE ACEPTA
SUBTOTAL				\$ 636,000.00	\$ 1,696,370.77	\$ 237,879.15	\$ 1,647,733.06	\$ 1,913,740.00	\$ 240,000.00	\$ 2,590,737.00	\$ 31,241.00	\$ 2,590,737.00	
MONTO OFERTADO				\$ 37,760.00	\$ 271,419.32	\$ 38,060.66	\$ 283,637.29	\$ 307,158.40	\$ 38,400.00	\$ 414,517.92	\$ 4,998.56	\$ 414,517.92	
MONTO ACEPTADO				\$ 273,760.00	\$ 1,867,790.00	\$ 275,999.81	\$ 1,911,370.35	\$ 2,228,898.40	\$ 278,400.00	\$ 3,005,354.92	\$ 36,239.56	\$ 3,005,354.92	
IMPORTE TOTAL ADJUDICADO:				\$ 590,579.37									

QUINIENTOS NOVENTA MRE QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 37/100 MN.

SÍMBOLOGÍA
 PARTIDAS NO ACEPTADAS POR ASI CONVENER LOS INTERESES DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA
 PARTIDAS NO ACEPTADAS POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA
 PARTIDAS DESERTAS
 PARTIDAS ACEPTADAS

Fecha de elaboración: **lunes, 21 de diciembre de 2015**

ELABORADO:
 LIC. EMILIO ALFREDO RAMÍREZ GÓNGORA
 AREA DE LICITACIONES
 REVISADO:

AUTORIZADO:
 DRA. ELIZABETH GUADALUPE SILVA MUÑOZ
 COORDINADORA ESTATAL DE ESTOMATOLOGIA DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA
 AUTORIZADO:

C.P. ELIZABETH JUÁREZ BOCARDO
 JEFA DE OFICINA DE ADQUISICIONES
 Vg. Bg.

QUIM. CRISTINA MONTEALTO MELO
 DIRECTORA DEL LABORATORIO ESTOMATOLÓGICO DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

LIC. VERA HERNÁNDEZ BARBO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES