

**DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES  
 JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-116/2015  
 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO  
 PARA EL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAX., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO, TLAXCALA, LOS CC. JORGE CAPIZ JASSO, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE; LA LIC. MARÍA ELENA PICAZO SÁNCHEZ, COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE; **DRA. ELIZABETH GUADALUPE SILVA MUÑOZ**, QUIM. **FABRICIA SANCHEZ GUTIERREZ** LABORATORIO ESTATAL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA; EL LIC. **ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA** COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO, A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-118/2015, EL PRESENTE EVENTO SE LLEVA A CABO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, ASÍ COMO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.-----  
**HECHOS:** A CONTINUACION SE DARA RESPUESTA A LAS DUDAS PLANTEADAS POR LOS LICITANTES DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL PUNTO 7 DE LAS BASES-----

FEHLMEX SA DE CV		
1	<b>REFERENCIA</b>	3.5 PODER NOTARIAL
	<b>PREGUNTA</b>	NUESTRO REPRESENTANTE LEGAL CUENTA CON PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PODER ESPECIAL PERO TAN AMPLIO COMO EN DERECHO SE REQUIERA, PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PODERANTE, PARTICIPE EN TODA CLASE DE LICITACIONES Y CONCURSOS DE OBRA Y ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL DE CUALQUIER NATURALEZA, A LOS QUE CONVOQUE CUALQUIER SECRETARIA DE ESTADO, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES Y EN GENERAL CUALQUIER DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL, FEDERAL O LOCAL O BIEN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTALTA MAYORITARIA O MINORITARIA, FIDEICOMISOS PÚBLICOS O PRIVADOS PERSONAS MORALES O PRIVADAS O PERSONAS FÍSICAS, FACULTÁNDOLOS EXPRESAMENTE PARA QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD RECOJAN LAS BASES DE LOS CONCURSOS Y LICITACIONES, PRESENTEN LAS OFERTAS, ASISTAN A LOS ACTOS DE APERTURA DE LAS OFERTAS Y DE FALLOS DE LOS CONCURSOS O LICITACIONES; QUEDAN FACULTADOS TAMBIÉN PARA ACEPTAR CONVENIOS, REALIZAR MODIFICACIONES A LOS MISMOS Y PARTICIPAR EN LICITACIONES PRESENCIALES, ELECTRÓNICAS, INCLUYENDO EN LAS QUE SE PARTICIPE CON FIRMA DIGITAL AVANZADA. PODRÁ ACEPTAR LOS PEDIDOS Y OTORGAR CARTAS DE GARANTÍA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS OFERTAS Y FIANZAS A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PEDIDOS Y QUEDA AUTORIZADO IGUALMENTE PARA REALIZAR TODA CLASE DE GESTIONES NECESARIAS PARA ELLO, RECOGER PEDIDOS, REALIZAR PAGOS, FIRMAR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERA EN RELACIÓN CON LOS CONCURSOS O LICITACIONES EN LOS QUE PARTICIPEN, EFECTUAR CUALQUIER OTRO TRÁMITE PARA QUE PRESENTEN EN SU CASO TODO TIPO DE INCONFORMIDADES O IMPUGNACIONES. ¿ES SUFICIENTE CON ESTA FACULTAD PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA DEL PRESENTE EVENTO DE LICITACIÓN?
	<b>RESPUESTA</b>	SI ES SUFICIENTE
2	<b>REFERENCIA</b>	4.1.1 PROPUESTA TÉCNICA
	<b>PREGUNTA</b>	MENCIONA QUE UNO DE LOS REQUISITOS ES FIRMAR AL CALCE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS POR LA PERSONA AUTORIZADA PARA ELLO CONFORME AL PODER NOTARIAL. ¿TIENE QUE SER LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL, O BASTARA CON SU RUBRICA PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO?
	<b>RESPUESTA</b>	TENDRA QUE SER FIRMA AUTOGRAFA EN EL ORIGINAL

3	<b>REFERENCIA</b>	4.1.1 PROPUESTA TÉCNICA
	<b>PREGUNTA</b>	MENCIONA QUE UNO DE LOS REQUISITOS ES FIRMAR AL CALCE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS POR LA PERSONA AUTORIZADA PARA ELLO CONFORME AL PODER NOTARIAL. ¿ESTO QUIERE DECIR QUE INCLUYE A LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR OTROS COMO LOS EMITIDOS POR EL SAT, COFEPRIS, ETC?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>ES CORRECTA SU APRECIACION DEBERA ESTAR FIRMADA Y SELLADA EN TODAS LAS HOJAS TANTO EN SU PROPUESTA COMO LO DOCUMENTOS QUE LE ACOMPAÑEN</b>
4	<b>REFERENCIA</b>	4.1.1 PROPUESTA TÉCNICA Y 5.1.1
	<b>PREGUNTA</b>	MENCIONAN QUE DEBE FOLIARSE LA PROPUESTA ¿LAS PROPUESTAS SERÁN FOLIADAS TÉCNICA Y ECONÓMICA EN ORDEN CONSECUTIVO O SERÁ POR SEPARADO?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>CADA SOBRE DEBERA LLEVAR SU FOLIO INDEPENDIENTE</b>
5	<b>REFERENCIA</b>	4.1.3 PROPUESTA TÉCNICA
	<b>PREGUNTA</b>	MENCIONA QUE DEBE CAPTURARSE EN UN DISPOSITIVO USB LA PROPUESTA TÉCNICA. ¿PUEDE PRESENTARSE UN CD CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN VEZ DE LA USB?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A BASES</b>
6	<b>REFERENCIA</b>	4.6.6 INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS
	<b>PREGUNTA</b>	MENCIONAN QUE SE DEBE PRESENTAR LA PROPUESTA EN CARPETA LEFORT DE DOS ARGOLLAS Y EN PUNTO 3.13 QUE DEBEN PRESENTARSE EN FOLDER CON BROCHE BACO. ¿PUEDEN INDICARNOS POR FAVOR CUAL DEBE SER LA PRESENTACIÓN CORRECTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>LA PROPUESTA TECNICA DEBERA PRESENTARSE EN RECOPIADORES O CARPETAS LEFORT , LA DOCUMENTACION LEGAL Y ECONOMICA, PODRÁ PRESENTARSE EN FOLDER (COMO SE INDICA EN PUNTO 3.13 ) O CARPETA DE 3 ARGOLLAS</b>
7	<b>REFERENCIA</b>	6.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA
	<b>PREGUNTA</b>	PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO ENTENDEMOS QUE PODEMOS PRESENTAR UN CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, O ¿PUEDE SER A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>FAVOR DE APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL PUNTO 6.1 DE LAS BASES</b>
8	<b>REFERENCIA</b>	8. JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES
	<b>PREGUNTA</b>	¿EN CASO DE NO ASISTIR, EL ACTA SERÁ SUBIDA AL PORTAL DE COMPRA NET PARA SU CONSULTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SI ES CORRECTO SE SUBIRAN UNA VEZ FINALIZADO EL EVENTO</b>
9	<b>REFERENCIA</b>	12. APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS
	<b>PREGUNTA</b>	¿EN CASO DE NO ASISTIR, EL ACTA SERÁ SUBIDA AL PORTAL DE COMPRA NET PARA SU CONSULTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>ES CORRECTA SU APRECIACION</b>
10	<b>REFERENCIA</b>	13. FALLO
	<b>PREGUNTA</b>	¿EN CASO DE NO ASISTIR, EL ACTA SERÁ SUBIDA AL PORTAL DE COMPRA NET PARA SU CONSULTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>ES CORRECTA SU APRECIACION</b>
11	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 3
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ACEPTARA OFERTAR UN EQUIPO DE MESA CON UNA CAPACIDAD DE 23 LITROS +/- 4LITROS. SIEMPRE Y CUANDO CUMPLIENDO CON TODO LO MÍNIMO SOLICITADO EN LA CEDULA. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO</b>
12	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 3
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS EQUIPOS PRESENTEMOS LA NOM-003 Y NOM-001 PARA PRODUCTO NACIONAL Y DEBIDO A QUE ESTOS DEBEN DE ESTAR REGULADOS POR UNA NORMA NACIONAL

		QUE GARANTICE LA SEGURIDAD Y DISEÑO DE LOS RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN Y EN SU DEFECTO QUE NO HAYA ALGUNA NORMA QUE REGULE ESTOS EQUIPOS SE DEBE BASAR EN NORMAS EXTRANJERAS CON ACUERDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES ARTÍCULO 21 INCISO VII, POR ENDE, SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS EQUIPOS CUENTEN CON CERTIFICADO ASME VIGENTE A NOMBRE DEL FABRICANTE. ¿ES CORRECTO?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>ES CORRECTO Y APLICA PARA TODAS LAS PARTIDAS Y LICITANTES</b>
<b>COMERCIALIZADORA TECNOEQ-MEX SA DE CV</b>		
<b>13</b>	<b>REFERENCIA</b>	PUNTO 4.3.- TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 20 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA EMISIÓN DEL FALLO
	<b>PREGUNTA</b>	DEBIDO AL TIEMPO DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS O EN SU CASO DE LA IMPORTACIÓN DE LOS MISMOS, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL TIEMPO DE ENTREGA SE EXTIENDA A 60 DÍAS.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES</b>
<b>14</b>	<b>REFERENCIA</b>	PUNTO 4.5.2 COPIA LEGIBLE POR AMBOS LADOS DEL REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA SSA, POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS OFERTADAS, EL CUAL DEBERÁ CONTENER MARCA (PRODUCTO DENOMINADO) LABORATORIO, PRESENTACIÓN Y PROCEDENCIA. EN CASO QUE ALGUNA PARTIDA NO MANEJE REGISTRO SANITARIO SE DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO DE LA SSA DONDE SE INDIQUE QUE DICHO PRODUCTO NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO.
	<b>PREGUNTA</b>	EN CASO DE QUE ALGUNA PARTIDA NO CUENTE CON ESCRITO DE LA SSA DONDE SE INDIQUE QUE DICHO PRODUCTO NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO ¿SE ACEPTA ENTREGAR EL LISTADO DE LOS PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO PUBLICADO POR LA COFEPRIS?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA PRESENTAR LISTADO DE LOS PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO DEBIENDO INDICAR EL NUMERO DE PARTIDA EN DICHO DOCUMENTO</b>
<b>15</b>	<b>REFERENCIA</b>	4.5.5.- CARTA BAJO PROTESTA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO DENTRO DE LOS PRIMEROS TRES DÍAS POSTERIORES AL FALLO, ENTREGARÁ A LA CONTRATANTE LO SIGUIENTE: PERSONAS MORALES OFICIO DE SOLICITUD PARA PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN HOJA MEMBRETADA DIRIGIDO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, DONDE INFORME LA INSTITUCIÓN BANCARIA, NÚMERO DE CUENTA, DOMICILIO FISCAL, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO PARA DUDAS Y ACLARACIONES COPIA FOTOSTÁTICA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL (CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE O CEDULA PROFESIONAL) COPIA FOTOSTÁTICA DE PODER NOTARIAL COPIA FOTOSTÁTICA DE CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN AL RFC COPIA FOTOSTÁTICA DE CARTA DE CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA COPIA FOTOSTÁTICA DEL ACTA CONSTITUTIVA
	<b>PREGUNTA</b>	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR CUÁL ES LA CARTA DE CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>ES UN DOCUMENTO EMITIDO POR LA INSTITUCION BANCARIA EN EL CUAL CERTIFICA O VALIDA QUE EL PROVEEDOR ES CLIENTE DE ESA INSTITUCION PROPORCIONANDO A SU VEZ NUMERO DE CLIENTE, CLABE INTERBANCARIA, NUMERO DE CUENTA</b>
<b>16</b>	<b>REFERENCIA</b>	4.5.7.- CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS INDICANDO NUMERO DE PARTIDA Y ANEXO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) TUV, CE, FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) (AL MENOS UNO)
	<b>PREGUNTA</b>	PARA LA PARTIDA 7 DEL ANEXO 1B, REVELADOR MANUAL DE PLACAS DENTALES, SI EL PRODUCTO A OFERTAR ES NACIONAL Y NO CUENTA CON ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. ¿SE ACEPTA ENTREGAR UNA CARTA DONDE SE INDIQUE SOBRE QUE NORMA ES FABRICADO DICHO PRODUCTO?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>PARA TODAS LAS PARTIDAS SE DEBERÁ ANEXAR AL MENOS UN CERTIFICADO, FAVOR DE APEGARSE A BASES Y A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 12 DE ESTA ACTA</b>

17	REFERENCIA	4.6.6.- INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS SERÁ EN RECOPIADORES LEFORT DE DOS ARGOLLAS, SOLICITANDO ATENTAMENTE NO PRESENTAR HOJAS SUELTAS Y ENGRAPADAS, NI EN FÓLDER CON BROCHE
	PREGUNTA	¿SE ACEPTA ENTREGAR LAS PROPUESTAS EN CARPETAS DE 3 ARGOLLAS?
	RESPUESTA	<b>SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO</b>
18	REFERENCIA	ANEXO 1 A, PARTIDA: 1 BAÑO MARÍA CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE (BAÑO DE AGUA DE USO GENERAL THERMOSCIENTIFIC) -MODELO: 184
	PREGUNTA	EL MODELO SOLICITADO EN LA DESCRIPCIÓN YA ESTÁ DESCONTINUADO, ¿SE ACEPTA OFERTAR EL MODELO QUE LO SUSTITUYE DE LA MISMA MARCA?
	RESPUESTA	<b>SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SEAN IGUAL O MAYOR CALIDAD</b>
19	REFERENCIA	ANEXO 1 A PARTIDA: 4 AGITADOR DE CALENTAMIENTO CIMAREC III.
	PREGUNTA	EL MODELO SOLICITADO EN LA DESCRIPCIÓN YA ESTÁ DESCONTINUADO, ¿SE ACEPTA OFERTAR EL MODELO DE LA MISMA MARCA, CON DIMENSIONES DE 26 X26 Y UNA TEMPERATURA HASTA 400°C
	RESPUESTA	<b>SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO</b>
20	REFERENCIA	ANEXO 1 A PARTIDA: 6 CENTRIFUGA CLÍNICA CENTRIFUGA PEQUEÑA DE MESA SERIE SL8
	PREGUNTA	EL MODELO SOLICITADO EN LA DESCRIPCIÓN YA ESTÁ DESCONTINUADO, ¿SE ACEPTA OFERTAR EL MODELO QUE LO SUSTITUYE DE LA MISMA MARCA?
	RESPUESTA	<b>SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO</b>
21	REFERENCIA	ANEXO 1 A PARTIDA: 6 CENTRIFUGA CLÍNICA CENTRIFUGA PEQUEÑA DE MESA SERIE SL8
	PREGUNTA	¿EL EQUIPO SOLICITADO, REQUIERE DOS ROTORES?
	RESPUESTA	<b>SE REQUIERE DE UN SOLO ROTOR DE 4500 RPM</b>
22	REFERENCIA	ANEXO 1 A PARTIDA: 7 ULTRA CENTRIFUGA REFRIGERADA 5415R
	PREGUNTA	EL EQUIPO SOLICITADO YA HA SIDO DESCONTINUADO. ¿SE ACEPTA OFERTAR OTRA MARCA CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES?
	RESPUESTA	<b>SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO</b>
23	REFERENCIA	ANEXO 1 B PARTIDA: 1, AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR ESTOMATOLÓGICO. EQUIPO PORTÁTIL, AUTOMÁTICO PARA LA CONFORMACIÓN DE AMALGAMAS. INTEGRADO POR UN DEPÓSITO PARA MERCURIO Y OTRO PARA LIMADURA.
	PREGUNTA	EL EQUIPO SOLICITADO YA ESTÁ DESCONTINUADO. ¿SE ACEPTA OFERTAR UN AMALGAMADOR PARA CAPSULAS PRE-DOSIFICADAS?
	RESPUESTA	<b>SE ACEPTA PROPUESTA DEL AMALGAMADOR PARA CAPSULAS PRE-DOSIFICADAS</b>
24	REFERENCIA	ANEXO 1 B PARTIDA 3, ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL.
	PREGUNTA	EN LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO NO INDICA LA CAPACIDAD DE LA CÁMARA. ¿SE ACEPTA OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE 23 LITROS?
	RESPUESTA	<b>NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, SE REQUIERE UN AUTOCLAVE CON CAPACIDAD DE 12 LITROS CON POTENCIA DE 1200 W</b>
25	REFERENCIA	ANEXO 1 B PARTIDA: 6, UNIDAD ULTRASÓNICA ESTOMATOLÓGICA. UNIDAD DE PROFILAXIS DENTAL, NO INVASIVO PARA LA REMOCIÓN DE SARRO, MANCHAS. GENERADOR DE FRECUENCIA DE TRABAJO DE 25 A 45 HZ. SELECTOR DE POTENCIA: CONSUMO DE 17 A 30 WATTS, ALIMENTACIÓN DE AGUA CON CONTROL PARA REGULAR LA PRESIÓN, ROCIO O SPRAY. PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE EN SUSTANCIAS QUÍMICAS Y/O VAPOR. INSERTOS O PUNTAS FABRICADAS DE TITANIO O ALINEACIÓN DE MENTAL/DIAMANTE/CARBONO, INTERCAMBIABLES, ESTERILIZABLES EN VAPOR (TRES).
	PREGUNTA	¿SE ACEPTA OFERTAR UN EQUIPO CON FRECUENCIA DE LAS VIBRACIONES DE 27-32HZ Y POTENCIA MÁXIMA CONSUMIDA DE 40VA?
	RESPUESTA	<b>SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO</b>
<b>DESENLACE ADMINISTRATIVO S.C</b>		
26	REFERENCIA	ANEXO 1 A PARTIDA 10
	PREGUNTA	PODEMOS COTIZAR UN EQUIPO CON CÁMARA HORIZONTAL DE 40X40X60 CENTÍMETROS

*[Handwritten signatures and initials]*

	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SI CORRESPONDE A LA PARTIDA No. 8</b>
27	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO 1 A PARTIDA 10
	<b>PREGUNTA</b>	DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE ESTA PARTIDA NOS PODEMOS PERCATAR QUE ES UN EQUIPO DESCONTINUADO Y FUERA DE NORMA, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE NOS PERMITA COTIZAR UN EQUIPO TRIFÁSICO DE VAPOR AUTOGENERADO CON MICROPROCESADOR PARA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO, ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SI SE TIENE FUNCION DE EXPULSION LENTA PARA LIQUIDOS PARA LA ESTERILIZACION DE LIQUIDOS, CON CAPACIDAD DE 260 LITROS</b>
28	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO 1 A PARTIDA 10
	<b>PREGUNTA</b>	EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO NO ESPECIFICA LOS LITROS DE LA CAPACIDAD DE LA CÁMARA. PODEMOS OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE 96 LITROS
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE REQUIERE CON CAPACIDAD DE 260 LITROS</b>
29	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO 1 A PARTIDA 10
	<b>PREGUNTA</b>	EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO NO SE APRECIA EL TIPO DE PUERTA QUE SOLICITAN, PODEMOS OFERTAR UN EQUIPO DE UNA PUERTA DE APERTURA MANUAL DE IZQUIERDA A DERECHA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304. CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA APERTURA DURANTE EL PERIODO DE ESTERILIZACIÓN Y DESACTIVARLA CUANDO LA CÁMARA ESTE DESPRESURIZADA, ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA DE UNA SOLA PUERTA</b>
30	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO 1 A PARTIDA 10
	<b>PREGUNTA</b>	PARA ESTA PARTIDA SE PIDE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR EL CARRO CON CANASTILLA PARA CARGA Y DESCARGA DEL EQUIPO CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LA OPERACIÓN DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SU PROPUESTA</b>
31	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO 1 A PARTIDA 10
	<b>PREGUNTA</b>	EN LA DESCRIPCIÓN NO ESPECIFICA SI EL VACÍO DEBE SER MECÁNICO O ELÉCTRICO SUGERIMOS A LA CONVOCANTE SOLICITAR QUE SEA MEDIANTE BOMBA DE VACÍO YA QUE ESTO PERMITE QUE EL PROCESO SEA MÁS RÁPIDO Y MUCHO MÁS SEGURO, ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SU PROPUESTA</b>
32	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO 1 B PARTIDA 3
	<b>PREGUNTA</b>	EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO NO SE APRECIA LA CONFIGURACIÓN DEL VOLTAJE, FAVOR DE ACLARAR SI ES DE 120 VOLTS O 220 VOLTS.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE REQUIERE DE 1200 W, 120 VOLTS</b>
33	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO 1 B PARTIDA 3
	<b>PREGUNTA</b>	EN ESTA DESCRIPCIÓN NO ESPECIFICA LA CAPACIDAD DE LA CÁMARA. PODEMOS OFERTAR UN EQUIPO DE 17 A 21 LITROS, FAVOR DE ACLARAR.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE REQUIERE DE 12 LITROS</b>
34	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO 1 B PARTIDA 3
	<b>PREGUNTA</b>	EN LA DESCRIPCIÓN NO ESPECIFICA SI EL VACÍO DEBE SER MECÁNICO O ELÉCTRICO SUGERIMOS A LA CONVOCANTE SOLICITAR QUE SEA MEDIANTE BOMBA DE VACÍO YA QUE ESTO PERMITE QUE EL PROCESO SEA MÁS RÁPIDO Y MUCHO MÁS SEGURO, ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO</b>
<b>IRUM SA DE CV</b>		
35	<b>REFERENCIA</b>	4.3.- TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES:
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LOS BIENES EN UN TIEMPO DE ENTREGA DE 45 DÍAS YA QUE LOS BIENES SOLICITADOS SON DE IMPORTACIÓN Y EL TIEMPO COMENTADO ES EL APROXIMADO EN LA IMPORTACIÓN DE DICHOS EQUIPOS.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES</b>
36	<b>REFERENCIA</b>	4.5.2- COPIA LEGIBLE POR AMBOS LADOS DEL REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR LA SSA
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR EL

		LISTADO DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DONDE MENCIONA QUE DICHOS EQUIPOS NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO; O BIEN ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DONDE SE MENCIONE QUE DICHOS EQUIPOS NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO. ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 14 DE LA JUNTA</b>
37	<b>REFERENCIA</b>	4.5.8.- FOLLETOS, FICHAS O CATÁLOGOS DE CADA BIEN, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE PARTIDA Y ANEXO. LOS CUALES MÍNIMO DEBERÁN CONTENER CARACTERÍSTICAS, MARCA, FABRICANTE, MODELO Y FOTOGRAFÍA
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR FOLLETOS, FICHAS O CATÁLOGOS CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES PERO SIN FOTOGRAFÍAS, ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, ES NECESARIO PRESENTAR LA IMAGEN ASI COMO LOS FOLLETOS, FICHAS TECNICAS O CATALOGOS DEBERA SER IGUAL MARCA Y MODELO INDICADO EN SUS PROPUESTAS Y DEBERAN DE SER EN ORIGINAL</b>
38	<b>REFERENCIA</b>	PARTIDA 7 ULTRA CENTRIFUGA REFRIGERADA 5415R
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAN ULTRA CENTRIFUGA REFRIGERADA 5415R, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFRECER EL MODELO: 5418R QUE CUENTA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, YA QUE EL MODELO SOLICITADO ESTÁ DESCONTINUADO, ¿SE ACEPTA?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO EL MODELO SEA DE IGUAL O MAYOR CALIDAD</b>
39	<b>REFERENCIA</b>	PARTIDA:5 TERMOCICLADOR PUNTO FINAL
	<b>PREGUNTA</b>	SOLICITAN TERMOCICLADOR PUNTO FINAL SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE NOS PERMITA COTIZAR EL SIGUIENTE EQUIPO: EQUIPO ARTIK THERMAL CYCLER 48 WELL DUAL BLOCK. TERMOCICLADOR QUE REALIZA PCR PUNTO FINAL, QUE CUENTA CON LO SIGUIENTE: BLOQUE DUAL DE 48 POZOS PARA EXPERIMENTOS INDEPENDIENTES. POSIBILIDAD DE INTERCAMBIAR BLOQUE A 96X0.2 ML Y 384 X 0.03 ML BLOQUE CON TECNOLOGÍA PELTIER QUE ASEGURA SU CORRECTO CALENTAMIENTO O ENFRIAMIENTO A LO LARGO DEL BLOQUE. TASA DE RAMPEO MÁXIMA: 3.0°C/S RANGO DE TEMPERATURA: 4-99°C PRECISIÓN DE TEMPERATURA: ± 0.3°C A 90°C UNIFORMIDAD DE TEMPERATURA: ± 0.43°C A 90°C CALENTAMIENTO DE LA TAPA: AJUSTABLE MANUALMENTE INTERFACE: SEMI GRÁFICO. TAMAÑO: 29 CM X 38 CM X 29 CM (AN X PR X AL) PESO: 10.5 KG REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA: 100-240 V, 50-60 HZ Y 600 W. PUERTO USB PARA TRANSFERENCIA DE DATOS
	<b>RESPUESTA</b>	<b>ESTA PARTIDA QUEDA CANCELADA</b>
40	<b>REFERENCIA</b>	PARTIDA 1 BAÑO MARÍA CON TAPA DE ACERO
	<b>PREGUNTA</b>	PARTIDA 1 BAÑO MARÍA CON TAPA DE ACERO SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI REQUIERE ESTE BAÑO CON CIRCULACIÓN O SIN CIRCULACIÓN
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE REQUIERE BAÑO SIN CIRCULACION</b>
41	<b>REFERENCIA</b>	PARTIDA 1 BAÑO MARÍA CON TAPA DE ACERO
	<b>PREGUNTA</b>	PARTIDA:1 SOLICITAN: BAÑO MARÍA CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE (BAÑO DE AGUA DE USO GENERAL THERMOSCIENTIFIC) -MODELO: 184 -CONTROL TEMPERATURA/RESOLUCIÓN UNIFORMIDAD (37°C):±/-0.2? C/±/- 0.1? C -MÁXIMO DE TEMPERATURA: 99.9? C -CAPACIDAD: 19.5L (5.2 GAL.) -DIMISIONES INTERIORES: L X W X D: 35.6 X 30.5 X 20.3 CM (14 X 12 X 8IN) DIMENSIONES EXTERIORES L X W X H: 49.9 X 40 X 24.8 CM (19.7 X 15.75 X 9.75IN) -PESO DE ENVIÓ: 11.3 KG (25LB) -SISTEMA ELÉCTRICO: 120V 50/60 HZ/600 W <b>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA COTIZAR: BAÑO MARIA DIGITAL CON PANTALLA DE LCD</b>

		<p>CONSTRUIDO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE, SU TINA DE UNA SOLA PIEZA EVITA FUGAS Y CORROSIÓN, EL ELEMENTO CALEFACTOR INMERSO PROPORCIONA UN CALENTAMIENTO EFICIENTE, RÁPIDO Y EXCEPCIONALMENTE UNIFORME, CON RANGO DE OPERACIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE +5 A 100 °C. IDEAL PARA NUMEROSAS APLICACIONES EN LABORATORIOS, HOSPITALES, INDUSTRIAS, ETC. MODELOS CON CONTROL DIGITAL MICROCONTROLADO Y SENSOR PT 100, PANTALLA LCD PARA OBSERVAR TEMPERATURA DE OPERACIÓN Y PROGRAMADA, TIEMPO DE CICLO Y ESTADO DEL PROCESO. RESOLUCIÓN DE 0.1 °C. ALARMAS PARA LÍMITES ALTO Y BAJO DE TEMPERATURA. DETECCIÓN DE FALLAS Y BAJAS DE VOLTAJE. TIMER HASTA 99:59 MIN., SELECCIÓN DE IDIOMA Y UNIDADES DE OPERACIÓN. IMPRESORA TÉRMICA OPCIONAL, COMUNICACIÓN DIGITAL RS232. TAMAÑO GRANDE</p> <p>DIMENSIONES 37X64X19 CM (ANCHO X PROF. X ALTO)                  TINA 30X50X15 CM. (ANCHO X PROF. X ALTO)                  CAPACIDAD 20 LTS.                  TAPA (OPCIONAL FE-384)                  CAPACIDAD PARA 4 GRADILLAS                  PESO NETO 9.8 KG.                  POTENCIA 1000 W                  VOLTAJE 120 V                  CORRIENTE 8.3 A                  CAPACIDAD PARA 240 TUBOS                  ESTABILIDAD 0.2°C.                  TEMPERATURA AMBIENTE +5° A 100°C                  SE ACEPTA?</p>
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES</b>
42	<b>REFERENCIA</b>	PARTIDA 1 BAÑO MARÍA CON TAPA DE ACERO
	<b>PREGUNTA</b>	<p>PARTIDA:1 SOLICITAN:                  BAÑO MARÍA CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE (BAÑO DE AGUA DE USO GENERAL THERMOSCIENTIFIC) -MODELO: 184 -CONTROL TEMPERATURA/RESOLUCIÓN UNIFORMIDAD (37°C):+/-0.2? C/+/- 0.1? C -MÁXIMO DE TEMPERATURA: 99.9? C -CAPACIDAD: 19.5L (5.2 GAL.) -DIMISIONES INTERIORES: L X W X D: 35.6 X 30.5 X 20.3 CM (14 X 12 X 8IN) DIMENSIONES EXTERIORES L X W X H: 49.9 X 40 X 24.8 CM (19.7 X 15.75 X 9.75IN) -PESO DE ENVIÓ: 11.3 KG (25LB) -SISTEMA ELÉCTRICO: 120V 50/60 HZ/600 W</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA COTIZAR: TERMOBAÑO CON CIRCULACION DE PRECISIÓN FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE PARA 40 TUBOS. TINA DE 24X30X15CM DIGITAL TEMP MAX 60.0°C SENS 0.1°C</p>
	<b>RESPUESTA</b>	<b>NO SE ACEPTA, NO SE REQUIERE CON CIRCULACION</b>
43	<b>REFERENCIA</b>	PARTIDA: 6 CENTRIFUGA CLÍNICA CENTRIFUGA PEQUEÑA DE MESA SERIE SL 8 MARCA THERMO SCIENTIFIC
	<b>PREGUNTA</b>	<p>SOLICITAN:                  CENTRIFUGA CLINICA CENTRIFUGA PEQUEÑA DE MESA SERIE SL 8 MARCA THERMO SCIENTIFIC ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CENTRIFUGAS SL 8 MAX. VELOCIDAD: 4,500 RPM (CON TX-150 ROTOR), 16,000 RPM (CON MICROCLICK 24 X 2 ROTOR) REFRIGERADOR: NO MAX. RCF: 3,260 X G (CON TX-150 ROTOR), 24,328 X G(CON MICROCLICK 24 X 2 ROTOR) PROGRAMABLE: 4BOTONES DE PROGRAMAS DIRECTOS CON OPCIÓN DE NOMBRE TEMPORIZADOR: 99 HR 59 MIN, Y CONTINUO, PERFIL (ACELERACIÓN/FRENADO): 2 (STANDARD Y SUAVE) CONTROL: MICROPROCESSOR MOTOR: DC, LIBRE DE ESCOBILLA ALTURA: EXTERIOR 31 CM ALTURA CON TAPA ABIERTA: 67 CM LONGITUD EXTERIOR: 48 CM ANCHO EXTERIOR: 37 CM NIVEL DE RUIDO: &lt;58 DBA (CON MICROCLICK 24 X 2 ROTOR); &lt;61 DBA CON TODOS LOS ROTORES CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD: SISTEMA DE INTERCAMBIO DE ROTOR</p>

		AUTO-LOCK, SISTEMA DE DETECCIÓN DE DESBALANCEO. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR: CENTRIFUGA CLINICACENTRIFUGA PEQUEÑA DE MESA SERIE ST 8 MARCA THERMO SCIENTIFIC COMPATIBLES CON TODAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SEA DE IGUAL O MAYOR CALIDAD</b>
44	<b>REFERENCIA</b>	4.5.7.- CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS INDICANDO NÚMERO DE PARTIDA Y ANEXO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) TUV, CE, FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) (AL MENOS UNO)
	<b>PREGUNTA</b>	ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SERA SUFICIENTE PRESENTAR UN SOLO DOCUMENTO DE CUALQUIERA DE LOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE. ¿ES CORRECTO?
	<b>RESPUESTA</b>	<b>ES CORRECTA SU APRECIACION</b>
<b>PROMEDENTAL SA DE CV</b>		
45	<b>REFERENCIA</b>	4.6.2.
	<b>PREGUNTA</b>	EN DICHO PUNTO DICE "NO SE ACEPTARÁ PRODUCTO DE ORIGEN CHINO, COREANO, TAIWANÉS, PAKISTANÍ O DE MALASIA" POR LO ANTERIORMENTE DESCRITO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, CONFIRME SI PODRÁN OFERTARSE BIENES DE PAÍSES QUE NO APARECEN ENLISTADOS EN ESTE PUNTO.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>ES CORRECTA SU APRECIACION</b>
46	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO 1 B , PARTIDA 2
	<b>PREGUNTA</b>	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE POR FAVOR, SI SE REFIERA A QUE SUCCIONE CON LOS EYECTORES DE LA UNIDAD DENTAL
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE REQUIEREN COMPRESORES LIBRES DE ACEITE DE 90 LITROS EN EL CATALOGO DE EQUIPO VIENE COMO (COMPRESOR SUCCIONADOR) ES POR ESTO QUE EN LA DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA SE COLOCA COMPRESOR LIBRE DE ACEITE DE 90 LITROS</b>
47	<b>REFERENCIA</b>	ANEXO 1 B , PARTIDA 8
	<b>PREGUNTA</b>	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE CUAL ES EL MODELO QUE SOLICITA, MODELO DE PEDESTAL O DE MURO.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE REQUIERE MODELO DE PEDESTAL</b>
48	<b>REFERENCIA</b>	3.INTEGRACION DE LA PROPUESTAS 3.1
	<b>PREGUNTA</b>	3.1 INSCRIPCION EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES O CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL. (ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR DOCUMENTO EMITIDO POR EL PORTAL DE INTERNET, YA QUE ESTE TRAMITE SE HACE POR ESTA VIA CON LA CADENA DIGITAL.
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO</b>
49	<b>REFERENCIA</b>	3.INTEGRACION DE LA PROPUESTAS 3.8
	<b>PREGUNTA</b>	3.8.- PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2015 (ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE) CON EL ACUSE DE RECIBO DEL SAT Y CON LA LIGA DIGITAL CORRESPONDIENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR DOCUMENTO EMITIDO POR EL PORTAL DE INTERNET , YA QUE ESTE TRAMITE SE HACE POR ESTA VIA CON LA CADENA DIGITAL
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO DEBIENDO ANEXAR SU COMRPOBANTE DE PAGO BANCARIO</b>
50	<b>REFERENCIA</b>	3.INTEGRACION DE LA PROPUESTAS 3.9
	<b>PREGUNTA</b>	3.9.- DECLARACIÓN ANUAL DE LOS IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014 ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE. (COPIA SIMPLE SI ES POR VÍA ELECTRÓNICA), CON EL ACUSE DE RECIBO DEL SAT Y CON LA LIGA DIGITAL CORRESPONDIENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR DOCUMENTO EMITIDO POR EL PORTAL DE INTERNET , YA QUE ESTE TRAMITE SE HACE POR ESTA VIA CON LA CADENA DIGITAL
	<b>RESPUESTA</b>	<b>SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO DEBIENDO ANEXAR SU COMRPOBANTE DE PAGO BANCARIO</b>

NOTAS GENERALES: 1.- DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA CONTRATANTE EN SU OFICIO RM/1936/11/2015-----

DEBERAN CONSIDERAR EN LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DEL ANEXO 1A PARTIDA 10 AUTOCLAVE DE VAPOR, SE DEBERA CONSIDERAR LO SIGUIENTE: -----

SE REQUIERE DE EXPULSION LENTA PARA ESTERILIZACION DE LIQUIDOS (MEDIOS DE CULTIVO) -----

2.- EN DICHO OFICIO TAMBIEN SE SOLICITA LA CANCELACION DE LAS PARTIDAS 5 Y 6 DEL ANEXO 1 A DE LAS BASES, PARA QUE SEA CONSIDERADO POR LOS LICITANTES EN SUS PROPUESTAS -----



3.- SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL CANJE DE SU COPIA DE LA FICHA BANCARIA POR EL RECIBO OFICIAL ES ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (CAJA) PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NÚM. 3 PLANTA BAJA TLAXCALA, TLAX., Y LO PODRÁN REALIZAR LOS DÍAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN UN HORARIO DE ATENCIÓN DE 9:00 A 14:00 HORAS.--

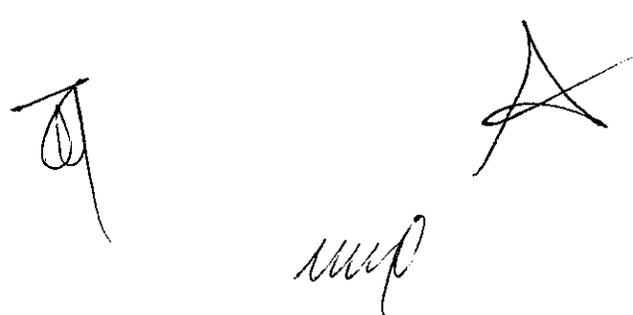
4.- EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y REVISIÓN LEGAL, SE LLEVARA ACABO EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LAS 11:30 HRS. EN ESTE MISMO RECINTO -----

-----LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:-----

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 12:05 HORAS. DEL DÍA DE SU INICIO LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.-----

REPRESENTANTES

<p><b>DIR. JORGE CAPIZ JASSO</b> Representante de la Convocante</p>	
<p><b>LIC. MA. ELENA PICAZO SÁNCHEZ</b> Representante de la Contratante</p>	
<p><b>DRA. ELIZABETH GUADALUPE SILVA MUÑOZ</b> Representante de la Contratante</p>	
<p><b>QUIM.FABRICIA SANCHEZ GUTIERREZ</b> Laboratorio Estatal de Tlaxcala</p>	
<p><b>LIC. ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA</b> Representante de la Contraloría del Ejecutivo</p>	



LICITANTES

IRON S.A de Cu.	<i>Handwritten signature</i>
Comercializadora Tecnoeq Hes S.A. de Cu.	<i>Handwritten signature</i>

-----FIN DE TEXTO-----

*Handwritten signatures and marks:*  
A series of handwritten signatures and marks, including a large checkmark and a star-like symbol.