

**COPIA
CERTIFICADA**



01

**PODER EJECUTIVO
TLAXCALA**

CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL DOCTOR ALEJANDRO GUARNEROS CHUMACERO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "SALUD DE TLAXCALA", LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO UBALDO VELASCO HERNANDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL DENOMINADA "PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO S.A. DE C.V." A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CIUDADANO JOSÉ DE JESÚS HERNANDEZ LUNA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA, QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE REFERIRÁN A "LAS PARTES" DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

1. DECLARA "SALUD DE TLAXCALA":

- 1.1 QUE LA SECRETARÍA DE SALUD ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 1, 11 Y 38 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA.
- 1.2 QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 23 DE LEY EN SALUD DEL ESTADO DE TLAXCALA EXPEDIDA POR EL DECRETO NÚMERO 77 Y PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO CON FECHA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL Y DECRETO 154 EXPEDIDO EL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL SIETE; ASÍ COMO LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE TLAXCALA.
- 1.3 QUE EL DOCTOR ALEJANDRO GUARNEROS CHUMACERO QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE FECHA VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE, EXPEDIDO POR EL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO DE TLAXCALA, CUENTA CON LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR MEMORIALES DE ESTE TIPO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 14, 15, 30, FRACCIONES I, XVI, 34 FRACCIONES IV, XIV Y XV DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE TLAXCALA Y EL ARTÍCULO 77 BIS-16 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY GENERAL DE SALUD. DEBIDO A QUE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 53101: EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, RECURSO CS Y ASF 2015 ANEXO IV SEGURO POPULAR.
- 1.4 QUE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO "SALUD DE TLAXCALA", SOLICITÓ A LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO DE TLAXCALA, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, QUE EN MATERIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SE ESTABLECEN EN EL CAPITULO SEGUNDO, ARTÍCULO 22, FRACCIÓN I Y 24, SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016, CON EL OBJETO DE CUBRIR EL REQUERIMIENTO DE SALUD DE TLAXCALA, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
- 1.5 PARA EFECTO DEL PRESENTE CONTRATO, SEÑALA DOMICILIO OFICIAL EL UBICADO EN CALLE IGNACIO PICAZO NORTE NÚMERO 25, DE LA CIUDAD DE SANTA ANA CHIAUTEMPAN, TLAX., C.P. 90800.

2. DECLARA "EL EJECUTIVO DEL ESTADO":

- 2.1 QUE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 11, 50 Y 51 FRACCIONES XIV, XV Y XVI DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA.
- 2.2 QUE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, ES LA ÚNICA FACULTADA PARA REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 19 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y DE ACUERDO A LAS FUNCIONES DEL PUNTO 3. DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS Y ADQUISICIONES, DEL CONTENIDO VII. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN EL TOMO XCIII, SEGUNDA ÉPOCA, NO. 52, CUARTA SECCIÓN, DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DEL 2014.
- 2.3 QUE EL LICENCIADO UBALDO VELASCO HERNANDEZ, EN SU CARÁCTER DE OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO, ASISTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, EN REPRESENTACIÓN DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE FECHA 24 DE ENERO DE 2011, TODA VEZ QUE POR SU CONDUCTO SE LLEVÓ A CABO LA SUBSTANCIACIÓN DEL:

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



**PODER EJECUTIVO
TLAXCALA**

02

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO GET-LPN-070/2016, SOLICITADO POR "SALUD DE TLAXCALA", EMITIENDO EL FALLO EL DÍA VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL DOS MIL DEICISEIS.

2.4 QUIEN TIENE SU DOMICILIO UBICADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NÚMERO 03 COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX, C.P. 90000.

3. DECLARA "EL PROVEEDOR":

3.1. QUE SU REPRESENTADA ACREDITA ESTAR ESTABLECIDA COMO PERSONA MORAL DENOMINADA "PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO S.A. DE C.V.", SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA NÚMERO (8427) OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE, VOLUMEN (147) CIENTO CUARENTA Y SIETE, DE FECHA VEINTIOCHO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO MIGUEL ANGEL ZAMORA VALENCIA, NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO (78) SETENTA Y OCHO, DEL DISTRITO FEDERAL, DEBIDAMENTE CONSTITUIDA CON ARREGLO A LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ACTUALMENTE EN OPERACIONES.

3.2. QUE DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUMENTO REFERIDO EN LA CLÁUSULA PRÓXIMA ANTERIOR, SE ENCUENTRA, ENTRE OTRAS, LA COMPRA, VENTA, COMISIÓN, REPRESENTACIÓN, CONSIGNACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN GENERAL DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS Y MERCANCIAS SUSCEPTIBLES DE COMERCIALIZAR, EN ESPECIAL CON ARTÍCULOS QUÍMICOS, MÉDICOS Y DE LABORATORIO.

3.3. ESTAR DEBIDAMENTE REGISTRADA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA COMO PERSONA MORAL, CON UNA ACTIVIDAD DE COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO Y COMERCIAL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, CON CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PMA850830G22, SEGÚN LO ACREDITA CON CÉDULA DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO IDCIF:14110236912.

3.4. QUE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL CIUDADANO JOSÉ DE JESÚS HERNANDEZ LUNA, QUIEN SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO TAL COMO CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NÚMERO (23171) VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y UNO, LIBRO (328) TRESCIENTOS VEINTIOCHO, DE FECHA CINCO DE JUNIO DOS MIL DOCE, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO MIGUEL ANGEL ZAMORA VALENCIA, NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO (108) CIENTO OCHO, DISTRITO FEDERAL, CUYAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI RESTRINGIDAS, POR LO QUE POSEE PLENA CAPACIDAD PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO.

3.5. QUE TIENE SU DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN CALLE CARLOS B ZETINA NÚMERO 142 COLONIA ESCANDON, MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL, C.P. 11800, PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

3.6. QUE SU REPRESENTADA TIENE SUFICIENTE EXPERIENCIA, CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA, PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A ESTE CONTRATO; QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS PROPIOS SUFICIENTES PARA ENTREGAR EL EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, QUE SE DESCRIBE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

3.7. QUE SU REPRESENTADA SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO, DEL ESTADO DE TLAXCALA, BAJO EL NÚMERO 345.

3.8. QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA; Y QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ART. 32-D) Y DE LAS LEYES TRIBUTARIAS VIGENTES.

3.9. QUE EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS, LA RESPONSABILIDAD ESTARÁ A CARGO DE "EL PROVEEDOR" EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.

QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, CUENTA CON AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y/O LICENCIA DE CONTROL SANITARIA, REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE SALUD.

4. DECLARAN "LAS PARTES":

4.1. QUE PARA EL OTORGAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, NO EXISTE ERROR, DOLO MÁLA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DE LA VOLUNTAD QUE PUDIERA INVALIDARLO, POR LO QUE EXPRESAMENTE RENUNCIAN A INVOCARLO EN CUALQUIER TIEMPO.

4.2. QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO.



03

**PODER EJECUTIVO
TLAXCALA**

- 4.3 EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SEÑALADO EN LA DECLARACIÓN I.4, EL PRESENTE CONTRATO Y SUS DEMÁS ANEXOS QUE PUDIERAN CORRESPONDERLE, SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN Y DETERMINAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN LA PRESENTE CONTRATACIÓN.
- 4.1 "SALUD DE TLAXCALA" A TRAVÉS DEL DR. EFREN SAMUEL ORRICO TORRES, DIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD Y EL DR. JOEL ALBERTO ROMERO DURAN, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE HOSPITALES O PERSONA QUE DESIGNEN, SERÁN LOS RESPONSABLES DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO 1 B Y 1 C, EN CALIDAD DE "ADMINISTRADORES TÉCNICOS DEL CONTRATO"

POR LO QUE, EN VIRTUD DE LAS DECLARACIONES VERTIDAS AMBAS PARTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, PARA EL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA CON "SALUD DE TLAXCALA" Y "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" A REALIZAR LA ENTREGA DEL EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 1 B Y 1 C, EL QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR AMBOS CONTRATANTES, FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA. ENTREGA DE LOS BIENES:

- A. **TIEMPO DE ENTREGA:** "EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE A REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES A MAS TARDAR 40 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO.
- B. **LUGAR DE ENTREGA:** "EL PROVEEDOR" DEBERÁ ENTREGAR EL EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, EN EL ALMACÉN DE INVENTARIOS DEL O.P.D. "SALUD DE TLAXCALA", UBICADO EN CARRETERA ZIMATEPEC NÚMERO 5, SANTA URSULA ZIMATEPEC, MUNICIPIO DE YAHUQUEMECAN, TLAXCALA, C.P. 90450, PREVIA CITA AL TELÉFONO 012414179708, SIENDO A CARGO DE "EL PROVEEDOR" TODO LO REFERENTE A FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, A ENTERA SATISFACCIÓN DE "SALUD DE TLAXCALA".
- C. **HORARIOS DE ENTREGA:** SERÁ DE LAS 9:00 A LAS 14:00 HORAS, EN DÍAS HÁBILES DE LUNES A VIERNES, DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL PEDIDO Y/O CONTRATO, POR LA CUAL NO SE RECIBIRA MERCANCÍA FUERA DE ESTE HORARIO Y NO SERÁ ACEPTADA CONDICIÓN ALGUNA, EN CUANTO A CARGOS ADICIONALES POR CONCEPTO DE FLETES, MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA, SEGUROS U OTROS.

TERCERA. CONDICIONES DE ENTREGA: "EL PROVEEDOR" RECONOCE QUE "SALUD DE TLAXCALA" PODRÁ SOLICITAR A "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", MODIFICACIONES A LAS FECHAS Y LUGARES DE ENTREGA, PREVIA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO, SIN QUE ESTO OCASIONE COSTOS ADICIONALES.

CUARTA. PAGO: "SALUD DE TLAXCALA" SE COMPROMETE A PAGAR POR LA ENTREGA DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, UN IMPORTE TOTAL DE \$159,305,172.20 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.) EL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTE IMPORTE INCLUYE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES, QUE MARQUEN LAS LEYES LOCALES Y/O FEDERALES, LOS CUALES DEBERÁN SER CUBIERTOS POR "EL PROVEEDOR" DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE LA FACTURA O FACTURAS.

LA FACTURA O FACTURAS QUE SE ENTREGUEN SE EMITIRÁN A NOMBRE DE "SALUD DE TLAXCALA", CON R.F.C. STL961105HT8, CON DOMICILIO EN IGNACIO PICAZO NORTE NÚMERO 25 COLONIA CENTRO DE SANTA ANA CHIAUTEMPAN TLAXCALA., DEBIENDO ACATAR A LA LETRA LO DISPUESTO PARA TAL EFECTO EN EL ANEXO 1 B Y 1 C DEL PRESENTE CONTRATO.

QUINTA. CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO SE EFECTUARÁ CON CHEQUE BANCARIO NOMINATIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA, SIEMPRE Y CUANDO SE PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA PARA SU COBRO, EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE "SALUD DE TLAXCALA", UBICADAS EN IGNACIO PICAZO NORTE, NÚMERO 25, COLONIA CENTRO, SANTA ANA CHIAUTEMPAN, TLAXCALA, LA CUAL CONSISTIRÁ EN LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y PÓLIZA DE FIANZA QUE AMPARE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA, PREVIO PROCEDIMIENTO DEL PAGO CORRESPONDIENTE.

EL PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, DEBERÁ HACERSE A NOMBRE DE "PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO S.A. DE C.V.", EN EL NÚMERO DE CUENTA 65500555133, CON CLABE INTERBANCARIA 014180655005551336, DEL BANCO: SANTANDER SERFIN, SUCURSAL: 0378 GUADALUPE INN, PLAZA: 001, CIUDAD DE MEXICO DISTRITO FEDERAL, PREVIA RECEPCIÓN Y APROBACIÓN DE LA FACTURA O FACTURAS ORIGINALES, SIEMPRE QUE PARA ESTO NO EXISTAN DEFICIENCIAS EN LA

Cuando...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**PODER EJECUTIVO
TLAXCALA**

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA EL PRECIO ESTIPULADO DEL CONTRATO SE MODIFICARÁ DURANTE SU VIGENCIA.

"SALUD DE TLAXCALA" EFECTUARÁ EL PAGO UNA VEZ QUE "EL PROVEEDOR" LLEVE A CABO LA ENTREGA DE LOS BIENES Y SERÁ DENTRO DE LOS CUARENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA ANTE EL ÓRGANO PAGADOR CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ENTREGARÁ CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.

SIXTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y VICIOS OCULTOS: "EL PROVEEDOR" GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO, LA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS SOBRE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, POR UN PERIODO DE VEINTICUATRO MESES POSTERIORES A LA ENTREGA DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO EN EL LUGAR DE ENTREGA PREVIAMENTE ESTIPULADO, CON PÓLIZA DE FIANZA, A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, EXPEDIDA POR LA EMPRESA AFIANZADORA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA ELLO, POR UN MONTO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA.), COMPROMETIÉNDOSE "EL PROVEEDOR" A REPONER EL EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, QUE PRESENTE RESULTEN DE MALA CALIDAD DE FABRICACIÓN O SE ENCUENTREN CON DEFICIENCIAS, QUE SE ENCUENTREN AMPARADOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DURANTE EL TIEMPO EN QUE SE ENCUENTRE VIGENTE LA GARANTÍA, LA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ ENTREGARSE CINCO DÍAS DESPUÉS A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO Y CONTENDRÁ EN SU TEXTO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, PARA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA.

"EL EJECUTIVO DEL ESTADO" ENTREGARÁ COPIA SIMPLE DEL CONTRATO A "EL PROVEEDOR" A FIN DE QUE ESTE TRÁMITE LA FIANZA DENTRO DEL TÉRMINO PREVIAMENTE ESTABLECIDO.

SÉPTIMA. COORDINACIÓN ENTRE "EL PROVEEDOR", "SALUD DE TLAXCALA" Y "EL EJECUTIVO DEL ESTADO": SERÁ RESPONSABILIDAD DE "EL PROVEEDOR" ESTABLECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN QUE ASEGUREN LA ENTREGA DEL EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN EL LUGAR ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

OCTAVA. RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS BIENES: "SALUD DE TLAXCALA", A TRAVÉS DEL DR. EFREN SAMUEL ORRICO TORRES, DIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD Y EL DR. JOEL ALBERTO ROMERO DURAN, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE HOSPITALES, O PERSONA AUTORIZADA, DEBERÁN VERIFICAR QUE EL EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, QUE PROPORCIONE "EL PROVEEDOR", INCLUYA LA RELACIÓN DEL MISMO, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO 1 B Y 1 C.

UNA VEZ QUE LOS BIENES SE ENTREGUEN EN EL ALMACÉN DE INVENTARIOS, LOS ADMINISTRADORES TÉCNICOS DEL CONTRATO, A TRAVÉS DE LAS PERSONAS QUE DESIGNEN PARA TAL EFECTO, DEBERÁN VERIFICAR LA CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES, SI HUBIESE DIFERENCIAS EN LA CALIDAD DE LOS MISMOS, DEBERÁ NOTIFICAR A EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE MANERA INMEDIATA, PARA QUE ESTE REQUIERA DE MANERA INMEDIATA A "EL PROVEEDOR" EL REEMPLAZO DENTRO DE UN LAPSO NO MAYOR DE CINCO (05) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE PETICIÓN FORMAL Y DE NO SUCEDER ASÍ, SE INICIARÁ EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

NOVENA. MODIFICACIONES Y PRORROGAS: "LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE "SALUD DE TLAXCALA" PODRÁ SOLICITAR A "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" LA AMPLIACION, MODIFICACION O PRORROGAR EL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO A SUS NECESIDADES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PUNTO 19.- "MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS", ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-070/2016, HASTA POR UN MÁXIMO DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%), DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL CAPÍTULO III ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, DEBIDAMENTE REQUISITADOS, APLICANDO LOS PRECIOS PREVISTOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL: "EL PROVEEDOR", "SALUD DE TLAXCALA" Y "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" SON PARTES CONTRATANTES TOTALMENTE INDEPENDIENTES, POR LO TANTO NO EXISTE NINGÚN NEXO O RELACIÓN OBRERO-PATRONAL ENTRE ELLOS, POR LO CUAL QUEDA ENTENDIDO QUE "EL PROVEEDOR" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DEL PAGO POR SALARIOS, PRESTACIONES DE DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE CAUSEN CON MOTIVO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y DEMÁS PERSONAL QUE CONTRATE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA PRIMERA. DEVOLUCIONES O CANJES: EN EL SUPUESTO DE QUE SE VERIFIQUE QUE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 B Y 1 C ENTREGADO POR "EL PROVEEDOR", NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR "SALUD DE TLAXCALA", SE PROCEDERÁ AL RECHAZO DE LO SOLICITADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, Y "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, ESTA RESCISIÓN SERÁ SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" Y "SALUD DE TLAXCALA", SIN QUE MEDIE RESOLUCIÓN JUDICIAL EN TAL SENTIDO.

DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA: "SALUD DE TLAXCALA" PODRÁ SOLICITAR A "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL O BIEN, CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA O.P.D. "SALUD DE TLAXCALA"

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.





**PODER EJECUTIVO
TLAXCALA**

05

CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, YA QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE CAUSARIA ALGÚN DAÑO A "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 48 PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.

DÉCIMA TERCERA. PENAS CONVENCIONALES: "EL PROVEEDOR" CONVIENE EN QUE SI NO CUMPLE CON LA ENTREGA DEL EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EN EL MISMO SE ESTABLECEN, PAGARÁ A "EJECUTIVO DEL ESTADO" Y/O "SALUD DE TLAXCALA" CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 70 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, CON CHEQUE DE CAJA A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA O CON NOTA DE CRÉDITO, UNA PENA CONVENCIONAL DE 0.7% POR CADA DÍA DE RETRASO, HASTA CINCO DÍAS, A PARTIR DE ESA FECHA LA CONTRATANTE DETERMINARÁ SI OTORGA UN PLAZO MAYOR, APLICANDO POR CADA DÍA DE RETRASO UNA PENA CONVENCIONAL QUE NO EXCEDA DEL LÍMITE MÁXIMO DE PENAS CONVENCIONALES CONSISTENTE EN EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, SIN INCLUIR EL I.V.A., O BIEN, SI RESCINDE EL CONTRATO. LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SERÁ DE LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE "SALUD DE TLAXCALA".

DÉCIMA CUARTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA: EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ASUME "EL PROVEEDOR" POR VIRTUD DE ESTE CONTRATO, FACULTA A "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", PARA DARLO POR RESCINDIDO SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD A SU CARGO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", COMUNIQUE A "EL PROVEEDOR" POR ESCRITO TAL DETERMINACIÓN, COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 48 PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, ADEMÁS SI ESTE INCURRE EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

- A. EL INCUMPLIMIENTO DE "EL PROVEEDOR" AL OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA, HARÁ A SU CARGO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIEREN SUFRIR "SALUD DE TLAXCALA" Y "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" POR EL BIEN CONTRATADO.
- B. POR HABERSE AGOTADO EL MONTO LÍMITE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES.
- C. SI "EL PROVEEDOR" NO REALIZA LA ENTREGA, EN EL TÉRMINO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO.
- D. POR NO REALIZAR LA ENTREGA, CONFORME A LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN ESTE CONTRATO.
- E. SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA ENTREGA DEL BIEN, DE ACUERDO A LOS DATOS Y ESPECIFICACIONES QUE EMITA "SALUD DE TLAXCALA".
- F. POR DESATENCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR "SALUD DE TLAXCALA" Y "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EN ATENCIÓN AL PRESENTE CONTRATO.
- G. SI NO DA LAS FACILIDADES NECESARIAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE AL EFECTO DESIGNE "SALUD DE TLAXCALA", PARA EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN.
- H. POR NO CONTAR CON PERSONAL SUFICIENTE Y CAPACITADO, PARA LA ENTREGA DEL BIEN, EN TIEMPO Y FORMA.
- I. POR NEGATIVA A COMPLETAR LA ENTREGA DEL BIEN CONTRATADO SIN NINGÚN MOTIVO.
- J. SI CEDE, TRASPASA O SUBCONTRATA LA TOTALIDAD O PARTE DEL DERECHO Y OBLIGACIÓN CONTRATADA, SIN CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO QUE PARA TAL EFECTO OTORGUE "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", SALVO QUE SE TRATE DE CESIONES A EMPRESAS FILIALES O SUBSIDIARIAS.
- K. SI ES DECLARADO EN ESTADO DE QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGO, POR AUTORIDAD COMPETENTE EN CONCURSO MERCANTIL Y "EL PROVEEDOR" NO ES REHABILITADO EN UN PLAZO DE SEIS MESES A PARTIR DE LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.
- L. CUALQUIER INCUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO SERÁ MOTIVO DE RESCISIÓN.

DÉCIMA QUINTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN: SI SE ACTUALIZA UNA O VARIAS HIPÓTESIS DE LAS PREVISTAS EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, CON EXCEPCIÓN DE LA SEÑALADA EN LOS INCISOS J Y K, LOS CUALES SURTIRÁN SUS EFECTOS DE INMEDIATO, "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", REQUERIRÁ POR ESCRITO A "EL PROVEEDOR" PARA QUE DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN ESTE CONTRATO, LAS SUBSANE O MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA. SI "EL PROVEEDOR" NO CUMPLIERE SATISFACTORIAMENTE DICHO REQUERIMIENTO A JUICIO DE "EL EJECUTIVO DEL ESTADO", ESTE PODRÁ EJERCITAR EL DERECHO DE RESCISIÓN PREVISTO EN LA CLÁUSULA ANTERIOR.

DÉCIMA SEXTA. VIGENCIA: LA VIGENCIA Y DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS; NO OBSTANTE "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA AL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS CONDICIONES PACTADAS, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS CONVENIDAS.

DÉCIMA SÉPTIMA. COMPETENCIA: "LAS PARTES" CONTRATANTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN SOMETERSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES Y TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., TODO LO RELATIVO AL ALCANCE, INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE SE CONSIGNAN EN ESTE CONTRATO, INCLUSIVE PARA EL CASO DE CONTROVERSIA JUDICIAL, RENUNCIANDO AL FUERO QUE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO U OTRA CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.



06

**PODER EJECUTIVO
TLAXCALA**

LEÍDO Y EXPLICADO EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO ENTERADOS DEL VALOR Y ALCANCE JURÍDICO QUE PRESENTA, AMBAS PARTES LO FIRMAN EN TRES EJEMPLARES, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX, SIENDO DÍA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS.

FIRMAS:

POR "SALUD DE TLAXCALA"

DR. ALEJANDRO GUARNEROS CHUMACERO
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

POR "EL PROVEEDOR"

CIUDADANO JOSÉ DE JESÚS HERNANDEZ LUNA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
"PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y
LABORATORIO S.A. DE C.V."

TESTIGOS DE ASISTENCIA

O.P. LUZ MARÍA PORTILLO GARCÍA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL
O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

LIC. UBALDO VELASCO HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TLAXCALA

ING. JESÚS TÉLLEZ TÉLLEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

DR. JOSÉ HIPOLITO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. REPPS

ADMINISTRADORES TÉCNICOS

DR. EFREN SAMUEL ORRICO TORRES
DIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD

DR. JOEL ALBERTO ROMERO DURAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE HOSPITALES

LAS FIRMAS QUE CONSTAN EN LA PRESENTE HOJA CORRESPONDEN AL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, QUE CELEBRAN "SALUD DE TLAXCALA", "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" Y "EL PROVEEDOR", EL DÍA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS.

07



**PODER EJECUTIVO
TLAXCALA**

**POR LA CONVOCANTE
TESTIGO DE ASISTENCIA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Flores", written over a circular stamp or seal.

LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE RECURSOS
MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
DE GOBIERNO DEL ESTADO

LAS FIRMAS QUE CONSTAN EN LA PRESENTE HOJA CORRESPONDEN AL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, QUE CELEBRAN "SALUD DE TLAXCALA", "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" Y "EL PROVEEDOR", EL DÍA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS.



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

GET-LPN-070/2016-4

08

ANEXOS:


PAR TIDA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ANEXO 1B					
1	531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO EQUIPO QUE DETECTA, MIDE Y DESPLIEGA EN PANTALLA, DE FORMA CONTINUA MÚLTIPLES PARÁMETROS FISIOLÓGICOS ASOCIADOS A UN SOLO PACIENTE: ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA CARDIACA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, TEMPERATURA, PRESIÓN NO INVASIVA, OXIMETRÍA DE PULSO, CAPNOGRAFÍA Y PRESIÓN INVASIVA, CON OPCIÓN DE MEDIR GASTO CARDÍACO E ÍNDICE BIESPECTRAL. BROCHURE OMEGA S, PÁG. 4 INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 4, 26-2 DESCRIPCIÓN: BROCHURE OMEGA S, PÁG. 4 1.- MONITOR MODULAR CON PANTALLA TÁCTIL DE 20 PULGADAS BROCHURE OMEGA S, PÁG. 4 2.- CON CAPACIDAD PARA CONECTARSE A RED DE MONITOREO POR MEDIO DE ALÁMBRICO O CONEXIÓN INALÁMBRICA INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 3-2, 3-3, 3-10 3.- SALIDA ANALÓGICA DE ECG Y SINCRONÍA PARA DESFIBRILACIÓN INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 1-8 4.- PANTALLA A COLOR TECNOLOGÍA LCD TFT DATASHEET C700, PÁG. 2	EQUIPO	28	\$596,000.00	\$16,688,000.00
	5.- DESPLIEGUE DE AL MENOS 8 CURVAS SIMULTÁNEAS CON CAPACIDAD DE DESPLIEGUE DE HASTA 32 CURVAS Y CASILLAS DE PARÁMETROS BROCHURE OMEGA S, PÁG. 5 INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 1-20 6.- MONITOREO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 1-20 7.- ECG: INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-2 7.1.- DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE 3 CURVAS A ELEGIR DE ENTRE 12 DERIVACIONES INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-16, 8-20 7.2.- FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE HASTA 12 DERIVACIONES INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-19				
	7.3.- MONITOREO Y DESPLIEGUE DEL SEGMENTO ST EN TODAS LAS DERIVACIONES MONITORIZADAS (AL MENOS TRES CANALES SIMULTÁNEOS) INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 10-3, 10-5 7.4.- DETECCIÓN DE POR LO MENOS 12 ARRITMIAS INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 9-3, 9-4, 9-5 7.5.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE FRECUENCIA CARDIACA INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-17 7.6.- PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-7 7.7.- DETECCIÓN DE MARCAPASOS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-5 8.- SPO2: INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 18-2 8.1.- CURVA DE PLETISMOGRAFÍA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 18-8 8.2.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 18-8 9.- RESPIRACIÓN: INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 12-2 9.1.- CURVA DE RESPIRACIÓN. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 12-5 9.2.- FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 15 A 300 LPM/1 A 150 BPM. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 12-5, B-36, B-50 10.- TEMPERATURA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 28-2				

[Handwritten signatures and marks on the right margin]




09

PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

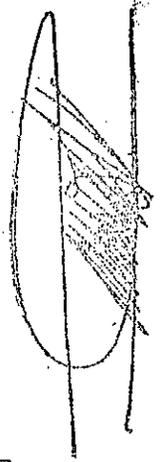

Quint

<p>10.1.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE AL MENOS DOS TEMPERATURAS (PIEL Y RECTAL O ESOFÁGICA) INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 28-2, 28-5 10.2.- MEDICIÓN DE LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA (AT) INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 28-5 11.- PRESIÓN NO INVASIVA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 13-2 11.1.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE PRESIÓN NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA). INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 13-2 11.2.- MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO DESDE 1 HASTA 240 MINUTOS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 13-7, 13-8, 13-9 11.3.- AJUSTE AUTOMÁTICO DE INFLADO DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTE SELECCIONADO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 13-7 12.- PRESIÓN INVASIVA: INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 15-2 12.1.- EN AL MENOS DOS CANALES INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 15-10 12.2.- ETIQUETADO DEL SITIO DE MEDICIÓN DE LOS SIGUIENTES: PRESIÓN ARTERIAL, PRESIÓN VENOSA CENTRAL, PRESIÓN GENERICA, ARTERIO PULMONAR, INTRACRANEAL, AURICULA DERECHA, AURICULA IZQUIERDA INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 15-2 13.- CAPNOGRAFIA: INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 20-2 13.1.-POR MEDIO DE MAINSTREAM INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 20-6 13.2.- DESPLIEGUE DE CURVA Y VALORES NUMÉRICOS INSPIRADO Y ESPIRADO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 20-9, 20-10 14.- TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 96 HORAS</p>							
<p>COMO MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO. CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE EVENTOS MÍNIMO 150, CON DURACIÓN DE 20 SEGUNDOS. DATASHEET INFINITY EXPLORER, PÁG. 2 15.- QUE CUBRA USO DESDE NEONATO HASTA ADULTO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5</p>							
<p>16.- ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES, PRIORIZADAS EN TRES NIVELES CON FUNCIÓN QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR LOS LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DE LOS SIGUIENTES: INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-2, 5-4, 5-10 16.1.- SATURACIÓN DE OXIGENO INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-14 16.2.- FRECUENCIA CARDIACA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-12 16.3.- PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA) INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-13 16.4.- TEMPERATURA INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-15 16.5.- FRECUENCIA RESPIRATORIA INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-14 16.6.- CO2 INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-11 16.7.- PRESIÓN INVASIVA INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-10 17.- ALARMA DE APNEA INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-20 18.- ALARMA DE ARRITMIA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-10, 9-6 19.- ALARMAS DEL SISTEMA QUE INDIQUEN EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-4 20.- CON SILENCIADOR DE ALARMAS INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-7 21.- INTERFASE, MENÚES Y MENSAJES EN ESPAÑOL. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-9 22.- FUNCIÓN DE CÁLCULOS HEMODINÁMICAS INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 17-2 23.- CAPACIDAD A FUTURO DE LA MONITORIZACIÓN CONTINUA NOINVASIVA DE LA PRESIÓN SANGUÍNEA ARTERIAL EN PACIENTES ADULTOS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 14-4 24.- CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA. DATASHEET GATEWAY, PÁG. 1 TRADUCCION SIMPLE DATASHEET GATEWEY PAG. 1</p>							





PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

GET-LPN-070/2016-4

10

[Handwritten signature]

	<p>25.- CAPACIDAD A FUTURO DE INTERFACE CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. DATASHEET INFINITY EXPLORER, PÁG. 1 DATASHEET GATEWAY, PÁG.1 TRADUCCION SIMPLE DATASHEET GATEWEY PÁG. 1</p> <p>26.- CAPACIDAD A FUTURO DE INTEGRAR SOFTWARE PARA EL DESPLIEGUE DE IMÁGENES TIPO DICOM, USO DE APLICACIONES DE INTERNET. DATASHEET INFINITY EXPLORER, PÁG. 2</p> <p>27.- CAPACIDAD A FUTURO DE LA MEDICIÓN DEL ÍNDICE BIESPECTRAL MEDIANTE MÓDULO DE LA MISMA MARCA QUE EL MONITOR. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 26-2, 26-4</p>							
	<p>27.1.- CON DESPLIEGUE EN PANTALLA DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES EL VALOR DE ÍNDICE BIESPECTRAL, ÍNDICE DE LA CALIDAD DE SEÑAL, INDICADOR DE ELECTROMIOGRAFÍA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 26-3, 26-6</p> <p>27.2.- MENÚ DE DESPLIEGUE EN PANTALLA DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES DE VALORES DE RELACIÓN DE SUPRESIÓN, FRECUENCIA DE BORDE ESPECTRAL, POTENCIA TOTAL Y CUENTA DE DESCARGAS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 26-6, 26-7</p> <p>28.- CAPACIDAD A FUTURO DE MEDICIÓN DE GASTO CARDIACO INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 16-2</p> <p>28.1.- POR TERMODILUCIÓN O GASTO CARDIACO CONTINUO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 16-2</p> <p>28.2.- FUNCIÓN PARA MEDICIÓN Y DESPLIEGUE DE CUÑA PULMONAR INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG.15-20</p> <p>28.3.- DESPLIEGUE DE VALORES NUMÉRICOS DE ÍNDICE CARDIACO INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG.16-4, 17-6</p> <p>28.4.- CINCO CURVAS DE PROMEDIO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 16-12</p>							
	<p>29.- CAPACIDAD A FUTURO DE MONITORIZACIÓN DE LA RELAJACIÓN MUSCULAR POR MEDIO DE MÓDULO, CON DESPLIEGUE EN PANTALLA DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES. MODOS DE INDUCCIÓN SIMPLE, TOF Y POSTETÁNICO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 25-2, 25-4, 25-5, 25-6</p> <p>30.- BATERÍA DE RESPALDO INTERCONSTRUIDA, CON CAPACIDAD PARA 240 MINUTOS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 1-18</p> <p>31.- INCLUIR SOPORTE A PARED. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-4 BROCHURE OMEGA S, PÁG. 10</p> <p>ACCESORIOS: PARA ADULTO / PEDIÁTRICO: LAS CANTIDADES SERÁN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-1</p> <p>32.- UN CABLE TRONCAL Y UN SENSORES TIPO DEDAL REUSABLES PARA OXIMETRÍA DE PULSO INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-14, C-17</p> <p>33.- UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O SUPERFICIE) POR CADA CANAL INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-18</p> <p>34.- BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, UNO ADULTO Y UNO PEDIÁTRICO, UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-19, C-20</p> <p>35.- UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE CINCO PUNTAS INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-9, C-12</p> <p>36.- OPCIONAL UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE 10 PUNTAS EN CASO DE REQUERIR DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE LAS 12 DERIVACIONES PARA CALIDAD DIAGNÓSTICA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-9</p> <p>37.- PARA CO2 POR TÉCNICA MAINSTREAM: SENSOR REUSABLE Y CABLE, ADAPTADOR DE VÍAS AÉREAS REUSABLE INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-25, C-26</p>							
	<p>38.- PARA CO2 POR TÉCNICA MICROSTREAM: 20 LÍNEAS DE MUESTRA Y 10 ADAPTADORES ENDOTRAQUEALES SE OFERTA</p>							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten mark]



**PODER EJECUTIVO
TLAXCALA**

GET-LPN-070/2016-4

11

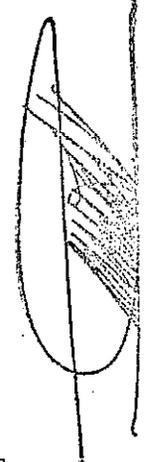

	<p>MAINSTREAM PUNTO 37</p> <p>39.- PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN INVASIVA INCLUIR AL MENOS DOS CANALES, POR CANAL: 1 CABLE TRONCAL PARA TRANSDUCTOR Y 10 KITS DE TRANSDUCTOR DESECHABLE, POR CADA CANAL. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-23</p> <p>ACCESORIOS PARA NEONATO: LAS CANTIDADES SERÁN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-1</p> <p>40.- UN CABLE TRONCAL Y UN SENSOR MULTISITIO REUSABLE PARA OXIMETRÍA DE PULSO INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-14, C-17</p> <p>41.- UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O SUPERFICIE) POR CADA CANAL INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-18</p> <p>42.- 20 BRAZALETES DESECHABLES PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA NEONATAL EN DOS MEDIDAS DIFERENTES, UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-19, C-20</p> <p>43.- UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE TRES PUNTAS INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-10, C-12</p> <p>CONSUMIBLES PARA ADULTO / PEDIÁTRICO: LAS CANTIDADES SERÁN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-2</p> <p>44.- 100 ELECTRODOS PARA ECG ADULTO / PEDIÁTRICO INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-10 CONSUMIBLES PARA NEONATO: LAS CANTIDADES SERÁN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-2</p>			
	<p>45.- 300 ELECTRODOS PARA ECG NEONATALES INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-10 REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO. INSTALACIÓN: INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. B-12</p> <p>46.- 110V, 60 HZ. ±10%. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. B-12 OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.</p> <p>NORMAS - CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS. PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA.</p>			
	<p>LA PRESENTE FICHA ES EN CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEBERÁN SER IGUALES O SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS.</p> <p>MARCA: DRÄGER</p> <p>MODELO: OMEGA S PROCEDENCIA: E.E.U.U.</p>			
2	CLAVE 531.616.5116 MESA QUIRÚRGICA	EQUIPO	16	\$836,010.00 \$13,376,160.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


Handwritten signature



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

GET-LPN-070/2016-4

12

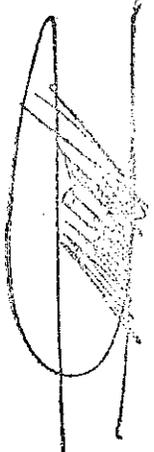

Quint



<p>ELECTROHIDRÁULICA AVANZADA. MESA PARA FACILITAR EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO, CON POSICIONES ADECUADAS PARA EL PACIENTE Y EL CIRUJANO. MESA QUIRÚRGICA ELÉCTRICA NOMBRE GENÉRICO: MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL MECANICA ESPECIALIDAD (ES); SERVICIO (S): QUIRÓFANOS. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 7 INSTRUCCIONES DE USO AXIS 200-300, PÁG. 3, 7 DEFINICIÓN: MESA PARA FACILITAR EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO, CON POSICIONES ADECUADAS PARA EL PACIENTE Y EL CIRUJANO. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG.7 DESCRIPCIÓN: INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 11 1. MESA QUIRÚRGICA CON 5 SECCIONES. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AXIS, PÁG. 1 TRADUCCION SIMPLE, ESPECIFICACIONES TECNICAS AXIS PAG. 1 2. MESA RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 16, 12 3. SISTEMA DE CUATRO RUEDAS DOBLES REGULABLES Y ELECTRO CONDUCTORAS DE 125 MM. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 12, 52 4. LA MESA DEBE CONTAR CON CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 11, 17 5. COJINES DE 60 MM FLYER AXIS 200-300, PÁG. 1 TRADUCCION SIMPLE FLYER AXIS 200-300 6. LONGITUD TOTAL CON EXTENSIÓN DE CABECERA Y PIERNAS DE 213 CM. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 52 7. ANCHO TOTAL 590 MM INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 52 8. PLACA INFERIOR (LONG. X AN.) 1.120 X 580 MM INSTRUCCIONES DE USO AXIS 200-300, PÁG. 24 9. CON BASE DE PLÁSTICO RESISTENTE Y LIGERO QUE PERMITA UNA MEJOR MOVILIDAD DE LA MESA QUIRÚRGICA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AXIS 300, PÁG. 1 TRADUCCION SIMPLE, ESPECIFICACIONES TECNICAS AXIS PAG. 1 10. COLUMNA EN ACERO INOXIDABLE. CATALOGO AXIS 200- 300, PÁG. 2, 5 TRADUCCION SIMPLE CATALOGO AXIS 200-300 PAG. 1 11. BASTIDOR O ESTRUCTURA DE SUPERFICIE Y RIELES LATERALES EN ACERO INOXIDABLE. CATALOGO AXIS 200-300, PÁG. 2, 5 TRADUCCION SIMPLE CATALOGO AXIS 200-300 PAG. 1</p>		
<p>12. RADIO TRANSPARENTE EN TODAS SUS SECCIONES. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 12 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AXIS, PÁG. 1 TRADUCCION SIMPLE, ESPECIFICACIONES TECNICAS AXIS PAG. 1 13. PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE LÍQUIDOS IP X 4 INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 53 14. LA MESA DEBE TENER LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIAR LA CABECERA Y LAS PIERNAS PARA PONER AL PACIENTE EN POSICIÓN INVERSA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AXIS, PÁG. 1 TRADUCCION SIMPLE, ESPECIFICACIONES TECNICAS AXIS PAG. 1 15. MESA CON SECCIONES: CABECERA CON AJUSTE DE FLEXIÓN CONTINUA DE +25°/-45° GRADOS. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 52 16. PELVIS Y MIEMBROS PÉLVICOS EN PLACAS INDEPENDIENTES, DESMONTABLES Y ABATIBLES Y CON MOVIMIENTO DE TIJERA. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG.43 CATALOGO AXIS 200-300, PÁG. 3 y 24</p>		



Handwritten mark or signature at the bottom right.



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

Handwritten signature

<p>17. FUNCIÓN PARA COLOCAR LA MESA EN POSICIÓN HORIZONTAL FLYER AXIS 200-300, PÁG. 1 TRADUCCION SIMPLE FLYER AXIS 200-300</p> <p>18. EL MANDO MANUAL SE DEBE DESACTIVAR AUTOMÁTICAMENTE TRES MINUTOS DESPUÉS DE HABER PULSADO LA ÚLTIMA TECLA INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 24</p> <p>19. ACCIONAMIENTO MECÁNICO DE LOS MOVIMIENTOS DE: ELEVACIÓN Y DESCENSO, AJUSTE LATERAL Y TRENDELEBURG/ TRENDELEBURG INVERSO INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 12</p> <p>20. FOWLER +70/-50 GRADOS, INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 52</p> <p>21. INCLINACIÓN TRENDELEBURG DE 30° GRADOS Y EN POSICIÓN INVERSA DE 30° GRADOS INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 52</p> <p>22. INCLINACIÓN LATERAL, IZQUIERDA Y DERECHA DE 20° GRADOS. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 52</p> <p>23. INCLINACIÓN PLACAS DE PIERNAS +20°/-90° INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 52</p> <p>24. POSICIÓN FLEX Y REFLEX 230°/110° CATALOGO AXIS 200-300, PÁG. 4</p> <p>25. REGULACIÓN DE ALTURA 69- 105 CM. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 52</p>						
<p>26. ACCESIBLE AL USO DE INTENSIFICADOR DE IMAGEN. COJÍN DESMONTABLE ELÉCTRICAMENTE CONDUCTIVO O ANTIESTÉTICO EN TODAS SUS SECCIONES Y SIN COSTURAS. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 12, 43</p> <p>27. CARGA MÁXIMA DEL PACIENTE EN ESTÁTICO DE 250 KG. FLYER AXIS 200-300, PÁG. 2 TRADUCCION SIMPLE FLYER AXIS 200-300</p> <p>28. CARGA MÁXIMA DEL PACIENTE EN DINÁMICO DE 185 KG. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 10 FLYER AXIS 200-300, PÁG. 2 TRADUCCION SIMPLE FLYER AXIS 200-300</p> <p>29. CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE CATALOGO AXIS 200-300, PÁG. 5 TRADUCCION SIMPLE CATALOGO AXIS 200-300 PAG. 1</p> <p>30. QUINTA RUEDA PARA ESTABILIDAD DIRECCIONAL INSTRUCCIONES DE USO AXIS</p> <p>31. INDICADOR DE LA BATERÍA EN EL CARGADOR INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 18</p> <p>32. INDICADOR DE LA BATERÍA EN EL CONTROL ALÁMBRICO FLYER AXIS 200-300, PÁG. 1 TRADUCCION SIMPLE FLYER AXIS 200-300</p> <p>33. TIEMPO DE CARGA DE UNA BATERÍA VACÍA DE 8 A 10 HORAS INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 20</p> <p>34. CAPACIDAD DE REALIZAR TODOS LOS MOVIMIENTOS CON CARGA MÁXIMA 60 VECES INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 20</p> <p>35. QUE CUMPLAN CON LAS EXIGENCIAS DE LAS NORMAS 93/42/CEE; 60601-1:1990, 60601-1:200, ISO 14971. INSTRUCCIONES DE USO AXIS, PÁG. 54</p> <p>36. CON ACCESORIOS PARA CIRUGÍA GENERAL CATALOGO ACCESORIOS SCHAEERER, PÁG. 3</p> <p>36.1 APOYA BRAZO CON PIEZA DE FIJACIÓN RÁPIDA CON ROTULA 1 CATALOGO AXIS 200-300, PÁG. 6 TRADUCCION SIMPLE CATALOGO AXIS 200-300 PAG. 1</p> <p>36.2 TRABA DE MUÑECA 1 CATALOGO AXIS 200-300, PÁG. 6 TRADUCCION SIMPLE CATALOGO AXIS 200-300 PAG. 1</p> <p>36.3 ARCO DE ANESTESIA CON ARTICULACIÓN CENTRAL 1 PIEZA DE FIJACIÓN RADIAL 1 CATALOGO ACCESORIOS SCHAEERER, PÁG. 7</p>						<p><i>Handwritten signature</i></p> <p><i>Handwritten signature</i></p> <p><i>Handwritten signature</i></p> <p><i>Handwritten signature</i></p>

Handwritten mark


Handwritten mark



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

GET-LPN-070/2016-4


14

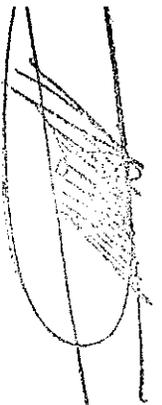

Quint



	<p>36.4 SOPORTE PARA INFUSIÓN 1 CATALOGO AXIS 200-300, PÁG. 6 TRADUCCION SIMPLE CATALOGO AXIS 200-300 PAG. 1</p> <p>36.5 APOYO PARA HOMBROS 2 CATALOGO AXIS 200-300, PÁG. 6</p> <p>36.6 SOPORTE UNIVERSAL PARA APOYO LATERAL Y DORSAL 2 CATALOGO AXIS 200-300, PÁG. 6</p> <p>36.7 PIEZA DE FIJACIÓN RÁPIDA 2 CATALOGO AXIS 200-300, PÁG. 6 TRADUCCION SIMPLE CATALOGO AXIS 200-300 PAG. 1</p>					
	<p>36.8 APOYO LATERAL Y DORSAL 2 CATALOGO ACCESORIOS SCHAEERER, PÁG. 11</p> <p>36.9 TRABA PARA CUERPO 1 CATALOGO AXIS 200-300, PÁG. 6 TRADUCCION SIMPLE CATALOGO AXIS 200-300 PAG. 1</p> <p>36.10 TRABA PARA PIERNA 2 CATALOGO ACCESORIOS SCHAEERER, PÁG. 8 NORMAS Y CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS, IEC 601-2-50 O ANSI /AAM; PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. LA PRESENTE FICHA ES CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEBERÁN SER IGUALES O SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS.</p> <p>MARCA: SCHAEERER MODELO: AXIS 300 E PROCEDENCIA: SUIZA</p>					
3	<p>CLAVE 531.562.1010 "LAMPARA QUIRURGICA DOBLE LED. A. LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 13</p> <p>B. EQUIPO FIJO PARA ILUMINAR EL CAMPO QUIRÚRGICO DURANTE LA EXPLORACIÓN O MANIOBRAS QUIRÚRGICAS. EQUIPO NO INVASIVO, UTILIZADO EN EL QUIRÓFANO DE UNIDADES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 13</p> <p>C. DESCRIPCIÓN: INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 15</p> <p>1. EQUIPO FIJO PARA LA ILUMINACIÓN ESPECÍFICA DE UN SITIO QUIRÚRGICO DURANTE PERIODOS PROLONGADOS, QUE FACILITA AL CIRUJANO UNA VISUALIZACIÓN ÓPTIMA DE PEQUEÑOS OBJETOS DE BAJO CONTRASTE A DIVERSAS PROFUNDIDADES O A TRAVÉS DE INCISIONES, ADEMÁS DE ILUMINAR ADECUADAMENTE EL CAMPO QUIRÚRGICO INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 13, 15, 17</p> <p>2. MONTAJE DE COLUMNA FIJA AL TECHO, CON DOS BRAZOS ARTICULADOS PORTA LÁMPARA, CADA UNO CON GIRO ROTATORIO DE 360° AJUSTE VERTICAL MÍNIMO DE 90 CM A +45°- 50°. INSTRUCCIONES DE MONTAJE POLARIS 100/200, PÁG. 39, 40, 41, 42 INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 17</p>	EQUIPO	15	\$245,010.00	\$3,675,150.00	
	<p>3. EQUIPO CON REFLECTORES DE LENTES INDIVIDUALES PARA PROPORCIONAR UNA OPTIMA SALIDA LUMINICA Y UN CONTROL DE SOMBRAS MAS EFICAZ CATALOGO POLARIS 100/200, PÁG. 1</p> <p>4. EQUIPO FABRICADO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 47</p>					





PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

Aut.

	<p>4.A. ANILLO DE CRISTAL INFERIOR DE ALUMINIO INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 47</p> <p>4.B. JUNTAS DE SILICONA INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 47</p> <p>4.C. CRISTAL INFERIOR DE POLICARBONATO INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 47</p> <p>4.D. SOPORTE CARDAN DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLVO INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 47</p> <p>4.E. CARCASA DEL PANEL DE CONTROL DE POLIAMIDA INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 47</p> <p>5. INTEGRADO POR DOS BRAZOS CON EXTENSION L1/L2 700/850 MM INSTRUCCIONES DE MONTAJE POLARIS 100/200, PÁG. 39, 40</p> <p>6. INTEGRADA POR DOS LÁMPARAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 17, 81</p> <p>6.A. DIAMETRO DEL CABEZAL 620 MM INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 81</p> <p>6.B. ALTURA DEL CABEZAL 80 MM INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 81</p> <p>6.C. PESO DEL CABEZAL 13 KG INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 81</p> <p>7. CABEZALES CERRADOS CON SUPERFICIE EXTERNA LISA SIN BORDES NI TORNILLOS PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CATÁLOGO POLARIS 100/200, PÁG. 2</p> <p>8. MANGO DE ENSAMBLE RÁPIDO Y NO ROSCABLE, DESMONTABLE, ESTERILIZABLE, DE PLÁSTICO INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 47, 49, 52</p> <p>9. FUENTE DE LUZ PARA AMBOS CABEZALES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 15</p> <p>9.A. BOMBILLAS BLANCAS DE LED INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 15</p>					
	<p>9.B. VIDA UTIL DE LOS LEDS DE 30,000 HORAS INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 80</p> <p>10. PANEL DE CONTROL DIGITAL EN CABEZAL PARA CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LA LAMPARA, AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA, ENCENDIDO Y APAGADO DEL MODO DE LUZ AMBIENTE INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 20</p> <p>10.A. INDICADOR DE ESTADO ILUMINADO PERMANENTEMENTE DURANTE EL MODO STAND BY Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 20, 36</p> <p>10.B. INDICADOR EN NARANJA PARA VER FALLO-CAUSA-SOLUCION INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG.36</p> <p>10.C. AUMENTO DE LA INTENSIDAD LUMINOSA EN 7 ETAPAS INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 40</p> <p>11. UN CABEZAL CON INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGENEA DE 120,000 LUXES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 13, 79</p> <p>11.A. ARREGLO DE 48 BOMBILLAS BLANCAS LED EN UN ARREGLO DE 8 REGLETAS INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 13, 15, 80</p> <p>11.B. AJUSTE DE LA ILUMINANCIA 40,000LUX A 120,000 LUXES INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 79</p> <p>11.C. MODO DE LUZ AMBIENTE DE 300 LUX INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 80</p> <p>11.D. TEMPERATURA DE COLOR DE 5.600 GRADOS KELVIN INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 79</p> <p>11.E. ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR RA DE 95</p>					<p><i>Handwritten signature</i></p>

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark




PODER EJECUTIVO
TLAXCALA



Guib

	<p>CATÁLOGO POLARIS 100/200, PÁG. 3, 4 11.F. INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR R9 DE 93 CATÁLOGO POLARIS 100/200, PÁG. 3, 4 11.G. DIÁMETRO DE CAMPO DE LUZ DE 20 CM CATÁLOGO POLARIS 100/200, PÁG. 2, 4 INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 79 11.H. PROFUNDIDAD DE ILUMINACION 1.3 M CATÁLOGO POLARIS 100/200, PÁG. 2 INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 79</p>					
	<p>11.I. IRRADIANCIA CENTRAL DE 420 WATTS/ METROS² INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 79 11.J. RELACION EE/EC 3.5 W/M²XLUX INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 79 12. UN CABEZAL CON INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGENEA DE 160,000 LUXES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 13, 79 12.A. ARREGLO DE 66 BOMBILLAS BLANCAS LED EN UN ARREGLO DE 11 REGLÉTS INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 13, 80 12.B. AJUSTE DE LA ILUMINANCIA 40,000LUX A 160,000 LUXES INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 79 12.C. MODO DE LUZ AMBIENTE DE 300 LUX INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 80 12.D. TEMPERATURA DE COLOR DE 5.600 GRADOS KELVIN INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 79 12.E. INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR RA DE 95 CATÁLOGO POLARIS 100/200, PÁG. 3, 4 12.F. INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR R9 DE 93 CATÁLOGO POLARIS 100/200, PÁG. 3, 4 12.G. DIÁMETRO DE CAMPO DE LUZ DE 20 CM CATÁLOGO POLARIS 100/200, PÁG. 2, 4 INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 79 12.H. PROFUNDIDAD DE ILUMINACION 1.3 M CATÁLOGO POLARIS 100/200, PÁG. 2 INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 79 12.I. IRRADIANCIA CENTRAL DE 560 WATTS/ METROS² INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 79 12.J. RELACION EE/EC 3.5 W/M²XLUX INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 79 13. SUMINISTRO DE ENERGIA PRINCIPAL DEL EQUIPO 120 V 60 HZ INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 80 14. CORRIENTE DE SALIDA DEL EQUIPO P_{MAX} IGUAL A 120 W I_{MAX} IGUAL A 5A INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 80 15. CLASIFICACION IP DE LA LAMPARA IP 42 INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 82</p>					
	<p>16. SISTEMA DE GESTION TERMICA INTEGRADO PARA DISIPAR EL CALOR PRODUCIDO POR LOS LED CATÁLOGO POLARIS 100/200, PÁG. 1 17. CON SISTEMA DE BATERIA INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 30 MINUTOS ANEXO 1 UPS D. REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 85 E. ACCESORIOS: 2 MANGOS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLES INSTRUCCIONES DE USO POLARIS 100/200, PÁG. 85, 49, 52 OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS POR PERSONAL CERTIFICADO DE FÁBRICA CURSOS DE OPERACIÓN Y DE SERVICIO PROGRAMADOS PARA CADA TURNO DEL PERSONAL MANUAL DE USUARIO ORIGINAL. NORMAS Y CERTIFICADOS: PARA</p>					





PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

GET-LPN-070/2016-4

17

	<p>PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS, IEC 601-2-50 O ANSI /AAMI; PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. LA PRESENTE FICHA ES CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEBERÁN SER IGUALES O SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS. MARCA: DRÄGER MODELO: POLARIS 100/200 PROCEDENCIA: ALEMANIA</p>				
4	<p>CLAVE 531.497.2083 "INCUBADORA DE CUIDADOS INTENSIVOS. A. DESCRIPCIÓN: EQUIPO ELECTROMÉDICO CON RUEDAS, QUE PROPORCIONA CONDICIONES ÓPTIMAS DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y EQUIPO OXIGENACIÓN. INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 22 1.- CONTROL: INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG.42 1.1.- CONTROLADA POR MICROPROCESADOR CON SISTEMA DE AUTO PRUEBA INICIAL Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 65, 103 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ISOLETTE 8000, PÁG. 20 1.2.- CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DEL AIRE DE 20°C A 37°C. CON SOBREGIRO DE TEMPERATURA DE MÁS DE 37.0 HASTA 39.0°C INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 157 CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 11 1.3.- CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE DE 34 °C HASTA 37.0 °C. CON SOBREGIRO DE TEMPERATURA DE MÁS DE 37.0 HASTA 38 °C INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 157 CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 11 1.4.- RESOLUCIÓN DE 0.1°C. INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 79 1.5.- SISTEMA DE SERVOCONTROL DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO QUE CUBRA EL RANGO DE 21% A 65% CON INCREMENTOS DE 1% INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 159 1.6.- SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN CON SERVOCONTROL DE LA HUMEDAD RELATIVA CON 30% A 95% CON INCREMENTOS DE 1% INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 159 CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 12 1.7.- CON SISTEMA DE MANEJO DE CONDENSACIÓN DE HUMEDAD (RESERVORIO PARA AGUA CONDENSADA) CON EL FIN DE EVITAR ACUMULACIONES DE AGUA EN EL INTERIOR DE LA INCUBADORA. INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 30 1.8. CON CÁMARA EVAPORADORA INTEGRADA AL RESERVORIO DE AGUA INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 30 y 56 2.- MONITOREO DE PARÁMETROS: INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 43</p>	13	\$428,250.00	\$5,567,250.00	
	<p>2.1.- DESPLIEGUE EN PANTALLA DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG.</p>				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA



GET-LPN-070/2016-4

18



Quint

<p>43</p> <p>2.2.- TEMPERATURA DE AIRE, MEDIDA Y PROGRAMADA INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 43</p> <p>2.3.- TEMPERATURA DE PIEL DE PACIENTE, MEDIDA Y PROGRAMADA INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG.43</p> <p>2.4.- CON MONITOREO SIMULTÁNEO DE DOS TEMPERATURAS DE LA PIEL DEL PACIENTE (CENTRAL Y PERIFÉRICA) INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 81</p> <p>CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 11</p> <p>2.5.- HUMEDAD RELATIVA, MEDIDA Y PROGRAMADA INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 43</p> <p>2.6.- CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO, MEDIDA Y PROGRAMADA INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 43</p> <p>2.7.- INDICADOR DEL MODO DE CONTROL DE TEMPERATURA INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 43, 78, 80 y 85.</p> <p>2.8.- DESPLIEGUE DE TENDENCIAS GRÁFICAS DE 24 HORAS, DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 11</p> <p>INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 106</p> <p>2.8.1- TEMPERATURA AIRE, DOS TEMPERATURA PACIENTE, HUMEDAD RELATIVA Y CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO Y % DE POTENCIA DEL CALEFACTOR INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 106</p> <p>2.8.2.- TENDENCIAS DE 7 DÍAS PARA SEGUIMIENTO DEL PESO DEL PACIENTE INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 106 CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 11</p> <p>3.- ALARMAS: INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 103</p> <p>3.1.- CON SISTEMA DE ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES PRIORIZADAS, DE TONOS Y CON MEDIOS PARA PERMITIR AL USUARIO DIFERENCIAR LOS NIVELES Y TIPOS DE ALARMA; CON SILENCIADOR TEMPORAL; CON MENSAJES DE ALARMA EN PANTALLA; DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 44, 102, 103</p>						
	<p>3.2.- TEMPERATURA BAJA DEL AIRE Y TEMPERATURA ALTA DEL AIRE INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 117</p> <p>3.3.- TEMPERATURA BAJA DE PIEL DE PACIENTE Y TEMPERATURA ALTA DE PIEL DE PACIENTE INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 118</p> <p>3.4.- FALTA DE AGUA Y DESVIACIÓN EN EL RANGO DE HUMEDAD INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 119, 120</p> <p>3.5.- FALLA DEL MÓDULO DE CONTROL DE OXÍGENO INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 122</p> <p>3.6.- CONCENTRACIÓN ALTA DE OXÍGENO Y CONCENTRACIÓN BAJA DE OXÍGENO INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 121, 122</p> <p>3.7.- FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 114</p> <p>3.8.- FALLA DEL SISTEMA INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 112</p> <p>3.9.- FALLA DEL SENSOR DE PIEL INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 116</p> <p>3.10.- FALLA DE LA CIRCULACIÓN Y FLUJO DE AIRE INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 113, 117</p> <p>3.11.- CON FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 31</p> <p>4.- PANTALLA: INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 29</p> <p>CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 11</p> <p>4.1.- LCD INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 29</p> <p>CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 11</p>					

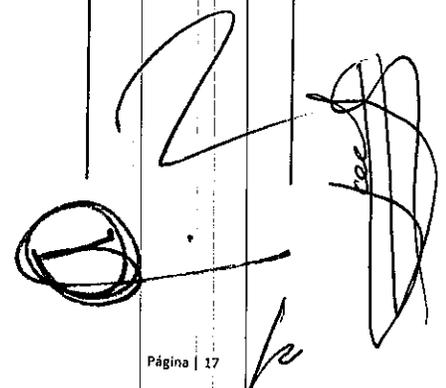



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA



Quint

<p>5.- GABINETE: INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 24 5.1.- CON LOS MEDIOS NECESARIOS PARA INCORPORAR UN SOPORTE PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 24 5.2.- BASE RODABLE CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS, CON AJUSTE DE ALTURA VARIABLE DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO A TRAVÉS DE PEDALES EN AMBOS LADOS DE LA INCUBADORA. INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 24, 25, 73 5.3.- CAPACETE TRANSPARENTE CON DOBLE PARED CON CIRCULACIÓN DE AIRE ENTRE EL CAPACETE Y LA DOBLE PARED. INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 24, 31 134 CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 5</p>				
<p>5.4.- CON DOS PUERTAS DE ACCESO CON CORTINA DE AIRE. CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 5, 11 INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 31 5.5.- QUE PERMITA EL USO DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA. INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 18 5.6.- CAPACETE DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA. INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 129, 130 5.7.- CON SEIS PORTILLOS DE ACCESO AL PACIENTE QUE NO UTILICEN MANGAS. CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 9, 11 5.8.- CON DIEZ ACCESOS PARA TUBOS AL INTERIOR DEL CAPACETE. CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 11 5.9.- BASE DESLIZABLE DE COLCHÓN RADIOTRANSARENTE INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 70, 170 CATALOGO SOFTBED, PÁG. 1 5.10.- CON CHAROLA INTEGRADA AL EQUIPO PARA TOMA DE RAYOS X INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 72, 94, 5.11.-CON AJUSTE CONTINUO DE INCLINACIÓN PARA PROPORCIONAR AL NEONATO POSICIONES DE TRENDELEMBURG Y CONTRA-TRENDELEMBURG, CON UN ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE 12 GRADOS. INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 156 5.11 BIS.- FILTRO DE AIRE INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 71, 170 5.12.- NIVEL DE RUIDO EN EL INTERIOR DEL CAPACETE MENOR A 47 DBA Y MENOR A 49DBA CON OXÍGENO SERVOCONTROLADO. INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 157 CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 11, 12 5.13.- VELOCIDAD DEL AIRE SOBRE EL COLCHÓN MENOR A 10 CM/SEG INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 157 5.14.- CON PUERTO DE COMUNICACIÓN RS232 CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 11 5.15.- CON AL MENOS UN CAJÓN O PUERTA DE GABINETE QUE NO TENGA TOPE PARA EVITAR AZOTES. INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 24 CATALOGO ISOLETTE 8000, PÁG. 9 5.16.- CON FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 31 6.- HUMIDIFICADOR: INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 30 6.1.- INTERCONSTRUIDO, CON DEPÓSITO DE AGUA, ESTERILIZABLE Y REMOVIBLE. INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 30, 56, 136</p>				
<p>6.2.- QUE PERMITA LA ELIMINACIÓN DE AGENTES PATÓGENOS POR EBULLICIÓN INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 30 7.- BÁSCULA: INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 160.</p>				

[Handwritten signatures and initials]



**PODER EJECUTIVO
TLAXCALA**

GET-LPN-070/2016-4

20

<p>7.1.- ELECTRÓNICA NEONATAL INTERCONSTRUIDA INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 31 7.2.- QUE MIDA HASTA 7 KG CON UNA RESOLUCIÓN DE 1 GR ACCESORIOS INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 160 B. OPCIONALES: INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 168 8.- CHAROLA PARA MONITOR. INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 170 9.- SOPORTE PARA SOLUCIONES CONSUMIBLES: INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 170 11.- 2 SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL REUTILIZABLE INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 168 12.- 50 PARCHES REFLEJANTES PARA FIJAR EL SENSOR DE TEMPERATURA. INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 168 C. INSTALACIÓN: INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 156 C.1.- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN EL RANGO DE 110 A 127V/60 HZ INSTRUCCIONES DE USO ISOLETTE 8000, PÁG. 156 OPERACIÓN: POR PERSONAL CALIFICADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL ESPECIALIZADO. NORMAS - CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES NORMAS: FDA, CE O JIS. PARA PRODUCTO NACIONAL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. MARCA: DRÄGER MODELO: ISOLETTE 8000 PROCEDENCIA: E.E.U.U.</p>				
<p>IMPORTE ADJUDICADO CON LETRA</p>			<p>SUBTOTAL</p>	<p>\$39,306,560.00</p>
<p>(CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 60/100 M.N.)</p>			<p>IVA</p>	<p>\$6,289,049.60</p>
			<p>TOTAL</p>	<p>\$45,595,609.60</p>

Acc...

ANEXO 1C					
<p>2</p>	<p>CLAVE: S/C "CAMA DE HOSPITALIZACION GENERAL. UNIDAD ELECTROMECÁNICA RODABLE QUE FACILITA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE. 1. CAMA ELECTRICA RODABLE DE MULTIPLES POSICIONES CON SISTEMA DE ELEVACION POR MEDIO DE ACTUADORES ELECTRICOS HERMETICAMENTE SELLADOS, LIBRES DE CORROSION, CON UNA ALTA DINAMICA DE CARGA, FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO Y BAJO CONSUMO DE CORRIENTE CATALOGO DE PRODUCTO (CAMA) (PORTADA) 2. QUE OPERE CON CORRIENTE ALTERNA 120 V/60 HZ MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 52 3. QUE CUENTE CON BATERÍA DE RESPALDO INTERCONSTRUIDA (NO INTEGRADA, NO UPS) QUE EN CASO DE FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERMITA REALIZAR TODOS LOS MOVIMIENTOS CON INDICADOR LUMINOSO EN EL PANEL DE CONTROL. MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 16 4. BARANDALES DE PE ELEMENTOS DE MOLDEADO DE RESINA</p>	<p>EQUIPO</p>	<p>500</p>	<p>\$71,531.83</p>	<p>\$35,765,915.00</p>



**PODER EJECUTIVO
TLAXCALA**

GET-LPN-070/2016-4

21

005

<p>MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 52 4.1 CONTRUIDOS EN UNA SOLA PIEZA.</p> <p>5. PANEL SUPERVISOR CON TECLAS DE MEMBRANA CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE GOBIERNE TODAS LAS FUNCIONES DE LA CAMA; Y CANDADOS QUE SEGURIDAD PARA BLOQUEAR LAS FUNCIONES POR ZONAS Y DE FORMA TOTAL PARA EL PACIENTE. MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 20-26</p> <p>6. SISTEMA DE TECLAS DE MEMBRANA CON LAS SIGUIENTES POSICIONES PRE-ASIGNADAS: MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 20-26</p> <p>6.1 POSICIÓN DE RCP POSICIONANDO LAS CUATRO (4) SECCIONES DE LA PLATAFORMA EN POSICIÓN HORIZONTAL.</p> <p>6.2 ANTITRENDELEMBURG</p> <p>6.3 POSICION DE EXAMINACION</p> <p>6.4 SILLA CARDIACA</p> <p>7. TRENDELEMBURG REVERSO CATALOGO DE PRODUCTO (CAMA)</p> <p>8. 4 (CUATRO) INDICADORES DE ANGULACION (UNO EN CADA BARANDAL) MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 34</p> <p>9. QUE PERMITA DAR POSICIONES: MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 34</p>				
---	--	--	--	--



**PODER EJECUTIVO
TLAXCALA**

GET-LPN-070/2016-4

22

[Handwritten signature]

<p>9.1 FOWLER DE 65° O MAYOR 9.2 ANGULACIÓN DE RODILLAS DE 35 ° O MAYOR 9.3 PANTORRILAS 21° O MAYOR 9.4 TRENDELEMBURG 16° O MAYOR 9.5 ANTITRENDEMBURG 16° O MAYOR 10. CON SISTEMA LIBERADOR DE EMERGENCIA DE RESPALDO DE ESPALDA POR MEDIO DE ASA O MANGO INDEPENDIENTE QUE EN CASO DE FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERMITA LLEVAR A LA POSICIÓN PARA RCP DE FORMA MECÁNICA Y SEGURA. MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 27 11. SUPERFICIE RÍGIDA CON PANELES DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA A GOLPES, RECUBIERTOS DE PINTURA EN POLVO, DESMONTABLES PARA SU CORRECTA LIMPIEZA. MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 52 12. CON MECANISMO QUE REDUZCA LA PRESIÓN EN ÁREA LUMBAR Y EXTIENDA EL ESPACIO DE LA PELVIS PARA DISMINUIR EL EFECTO DE FORMACIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN. CATALOGO DE PRODUCTO (CAMA) 13. FRENADO CENTRALIZADO PARA LAS CUÁTRRO RUEDAS CON PEDAL EN AMBOS LADOS DE CAMA EN AL MENOS 2 RUEDAS. MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 29 14. RUEDAS DE 150 MM, ANTIESTATICAS MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 52 15. BARANDALES EN DOS SECCIONES CON CONTROL LUMINO INTEGRADO AL BARANDAL. CATALOGO DE PRODUCTO (CAMA) 16. PIECERA Y CABECERA DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO DESMONTABLES CON SEGURO QUE EVITE LAS MOVILIZACIONES ACCIDENTALES. MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 14 17. DIMENSIONES: CATALOGO DE PRODUCTO (CAMA) 17.1 EXTERNAS 105 CM DE ANCHO X 220 CM DE LARGO. 17.2 SUPERFICIE DEL PACIENTE 91 CM DE ANCHO X 200 CM DE LARGO. 17.3 EXTENSION DE LA PLATAFORMA 35 CM. 18. CAPACIDAD MÁXIMA PARA LEVANTAR CARGA DE 245 KG CATALOGO DE PRODUCTO (CAMA) 19. ALTURA AJUSTABLE DE 35 - 68 CM CATALOGO DE PRODUCTO (CAMA) 20. ACCESORIOS: DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 37</p>					
--	--	--	--	--	--

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**PODER EJECUTIVO
TLAXCALA**

GET-LPN-070/2016-4


33



Aut



	<p>20.1 COLCHÓN DE LA MISMA MARCA DE LA CAMA, HIGIÉNICO FLEXIBLE DE 14 CM DE ESPESOR COMO MÍNIMO, CON TAMAÑO DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DE LA CAMA. CATALOGO DE PRODUCTO (COLCHON) 20.2 MATERIAL DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD CATALOGO DE PRODUCTO (COLCHON) 20.3 NO ALERGÉNICO. RECUBRIMIENTO DE MATERIAL LAVABLE Y ANTIINFLAMABLE ANTIESTÁTICO. CATALOGO DE PRODUCTO (COLCHON) 21. POSTE METÁLICO CROMADOS PARA SOLUCIONES INTRAVENOSAS (1 PIEZA) MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 39 22. CON PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS DE LA CAMA FABRICADO DE PVC. CATALOGO DE PRODUCTO (CAMA) 23. DOS GANCHOS PARA SOSTENER BOLSAS URINARIAS O DE DRENAJE. ACCESORIOS OPCIONALES MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 33 24. GANCHOS/SOPORTES PARA LA GUARDA DE LOS POSTES. MANUAL DE INSTRUCCIONES PÁGINA 39 25. INSTALACIÓN: 25.1. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO A SU MANUAL DE OPERACIÓN. 25.2. SE ENTREGA MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL, Y DE SERVICIO EN ESPAÑOL O INGLÉS. 26. OPERACIÓN: PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO A SU MANUAL DE OPERACIÓN. 27. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO Y CERTIFICADO POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO. 28. CAPACITACIÓN SOBRE USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, AL PERSONAL USUARIO QUE EL INSTITUTO DESIGNE Y AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, DE BIOMÉDICA QUE EL INSTITUTO DESIGNE. NORMAS Y CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS, IEC 601-2-50 O ANSI /AAMI; PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS.</p>				
	<p>CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. LA PRESENTE FICHA ES CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEBERÁN SER IGUALES O SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS." MARCA: PARAMOUNT BED MODELO: QUALITAS BETA INTEGRADA PA-6435 PROCEDENCIA: JAPON</p>				
<p>3</p>	<p>CLAVE. 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMÉTRICO NEONATAL PEDIÁTRICO- ADULTO. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 16 DEFINICIÓN: EQUIPO ELECTROMECÁNICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR, DE SOPORTE DE VIDA PARA APOYO VENTILATORIO EN PACIENTES ADULTOS PEDIÁTRICOS Y NEONATALES QUE TIENEN COMPROMETIDA LA FUNCIÓN</p>	<p>EQUIPO</p>	<p>40</p>	<p>\$789,890.00</p>	<p>\$31,595,600.00</p>

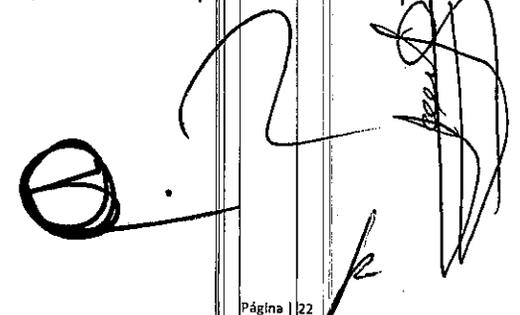




**PODER EJECUTIVO
TLAXCALA**

GET-LPN-070/2016-4

04

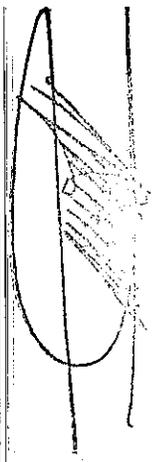

	<p>RESPIRATORIA. CON PANTALLA A COLOR QUE MUESTRE GRÁFICAS, DATOS NUMÉRICOS, ALARMAS PRIORIZADAS Y LOS DIFERENTES MODOS VENTILATORIOS SELECCIONADOS PARA UN ADECUADO TRATAMIENTO. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 16, 25 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVITA V300, PÁG. 69 DATASHEET EVITA V300, PÁG. 1, 4 DESCRIPCIÓN: INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 16 1. CONTROLES: INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 41, 250 2. VOLUMEN CORRIENTE (ML). LÍMITE INFERIOR 2 LÍMITE SUPERIOR 3,000. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 250</p>				
	<p>2.1. FLUJO INSPIRATORIO (L/MIN). LÍMITE INFERIOR 2 LÍMITE SUPERIOR 120 INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 251 2.2. PRESIÓN INSPIRATORIA (CM H2O). LÍMITE INFERIOR 1 LÍMITE SUPERIOR 95 INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 251 2.3. FRECUENCIA RESPIRATORIA (RPM). LÍMITE INFERIOR 0,5 LÍMITE SUPERIOR 150 INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 250 2.4. TIEMPO INSPIRATORIO (SEG). LÍMITE INFERIOR 0,1 LÍMITE SUPERIOR 10 INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 250 2.5. PAUSA INSPIRATORIA. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 103 2.6. ESPIRACIÓN MANTENIDA. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 104 2.7. FIO2 %. LÍMITE INFERIOR 21 LÍMITE SUPERIOR 100 INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 251 2.8. RESPIRACIÓN MANUAL. SI INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 103 2.9. PEEP/CPAP, CM H2O. LÍMITE INFERIOR 0. LÍMITE SUPERIOR 50 INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 251 2.10. RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA ASISTIDA MEDIANTE PRESIÓN SOPORTE LÍMITE SUPERIOR 95 INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 251 2.11. SALIDA PARA NEBULIZADOR SINCRÓNICO A LA FASE INSPIRATORIA CON CONTROL DE TIEMPO DE 5, 10, 15 Y 30 MINUTOS. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 21, 253 2.12. MECANISMO DE TRIGGER AUTOMÁTICO POR PRESIÓN; Y DE FLUJO CON RANGO DE CONTROL (L/MIN) LÍMITE INFERIOR 0,2. LÍMITE SUPERIOR 15 INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 251 ANEXO 3 CARTA TRIGGER 2.13. FLUJO BASE DE 6 L/MIN. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 253 2.14. INCREMENTO DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 251 2.15. 100 % O2 DURANTE 3 MINUTOS. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 104 3. MODOS VENTILATORIOS: INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 282 3.1. VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR VOLUMEN. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 284, 286</p>				
	<p>3.2. VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR PRESIÓN. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 293, 295 3.3. VENTILACIÓN PRESIÓN SOPORTE (PSV) EN TODOS LOS MODOS VENTILATORIOS. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 296</p>				

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark


Handwritten mark



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA




GET-LPN-070/2016-4

05

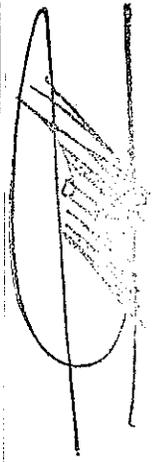

Acuña

<p>3.4. CPAP CON CAPACIDAD DE RESPIRACIONES ESPONTÁNEAS Y PRESIÓN DE SOPORTE. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 299</p> <p>3.5. RESPALDO EN CASO DE APNEA DE ACUERDO AL MODO VENTILATORIO, POR VOLUMEN O PRESIÓN. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 304</p> <p>3.6. VENTILACIÓN NO INVASIVA EN TODOS LOS MODOS VENTILATORIOS INCLUYENDO POR VOLUMEN PARA TODOS, CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE FUGAS. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 96, 324</p> <p>3.7. RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA EN DOS NIVELES DE PRESIÓN (BIPAP) Y CAPACIDAD DE INTEGRAR A FUTURO VENTILACIÓN CON LIBERACIÓN DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS (APRV). INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 291, 298</p> <p>3.8. CON GARANTÍA DE VOLUMEN PARA CPAP. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 300</p> <p>3.9. VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN EN NEONATOS (CICLADO POR TIEMPO Y LIMITADO EN PRESIÓN). INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 253, 290</p> <p>3.10. VENTILACIÓN CON GARANTÍA DE VOLUMEN EN NEONATOS INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 311</p> <p>3.11. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE VENTILACIÓN INICIALES MEDIANTE PESO Y EDAD DEL PACIENTE. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 71</p> <p>3.12. CON VENTILACIÓN CONTROLADA POR VOLUMEN MINUTO MANDATORIO INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 288</p> <p>3.13. CAPACIDAD A FUTURO DE PRESIÓN SOPORTE VARIABLE Y PROPORCIONAL. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 302</p> <p>4. PARÁMETROS MONITORIZADOS: INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 256</p> <p>4.1. PRESIÓN INSPIRATORIA PICO INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 256</p>				
<p>4.2. PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AÉREAS. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 256</p> <p>4.3. PRESIÓN DE PLATEAU. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 256</p> <p>4.4. PEEP INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 256</p> <p>4.5. FRECUENCIA RESPIRATORIA TOTAL Y ESPONTÁNEA. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 259</p> <p>4.6. VOLUMEN MINUTO TOTAL Y ESPONTANEO. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 257</p> <p>4.7. TIEMPO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 259</p> <p>4.8. RELACIÓN I: E. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 259</p> <p>4.9. VOLUMEN CORRIENTE EXHALADO. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 257</p> <p>4.10. FIO2 INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 256</p> <p>4.11. INDICADOR DE BATERÍA DE RESPALDO EN USO. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 37</p> <p>4.12. INDICADOR DE HORAS DE USO EN PANTALLA. ANEXO 2 HORAS DE USO</p> <p>4.13. CÁLCULO DE COMPLIANCE. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 261</p> <p>4.14. CÁLCULO DE RESISTENCIA. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 261</p> <p>4.15. ÍNDICE DE RESPIRACIÓN RÁPIDA Y SUPERFICIAL (RSB). INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 261</p> <p>4.16. CÁLCULO DE FUERZA INSPIRATORIA NEGATIVA (NIF) INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 261</p>				






PODER EJECUTIVO
TLAXCALA



GET-LPN/070/2016-4

36

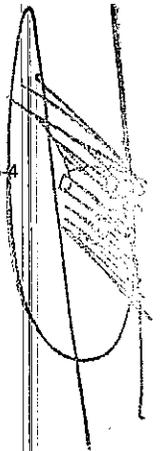

Aut...


	<p>4.17. BUCLE PRESIÓN TRAQUEAL VS. VOLUMEN. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 312</p> <p>4.18. DESPLIEGUE SIMULTANEO DE TRES CURVAS DE VENTILACIÓN: INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 98, 262</p> <p>4.18.1. VOLUMEN-TIEMPO INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 262</p> <p>4.18.2. FLUJO-TIEMPO INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 262</p> <p>4.18.3. PRESIÓN-TIEMPO INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 262</p> <p>4.19. DESPLIEGUE DE DOS BUCLES. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 99</p> <p>4.20. CON MONITORIZACIÓN DE CO2 EN EL FLUJO PRINCIPAL PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 151, 327</p>				
	<p>4.21. DESPLIEGUE DE CURVAS DE PRESIÓN TRAQUEAL. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 312</p> <p>4.22. CON ALMACENAMIENTOS DE EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS DE 7 DÍAS. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 136</p> <p>4.23. PORCENTAJE Y VOLUMEN DE FUGAS INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 261</p> <p>4.24. MEDICIÓN DE PEEP INTRINSECA INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 319</p> <p>4.25. CÁLCULO DEL ÍNDICE P0.1 O P100. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 261</p> <p>4.26. CONTROL DEL PEEP INTERMITENTE DE 1 A 20 CICLOS. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 253</p> <p>4.27. CAPACIDAD A FUTURO DE REALIZAR DIAGNÓSTICOS DE FALLA DEL EQUIPO A TRAVÉS DE UN SISTEMA REMOTO EN SITIO. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 241</p> <p>4.28. CAPACIDAD A FUTURO DE UN PROTOCOLO BASADO EN EL CONOCIMIENTO DE LA MECÁNICA RESPIRATORIA DEL PACIENTE PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA RETIRADA DE VENTILACIÓN. CATALOGO SMART CARE, PÁG. 2</p> <p>4.29. CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN GRÁFICA DEL ESTADO PULMONAR DEL PACIENTE, MUESTREO DE LA RESISTENCIA Y COMPLIANCIA DEL PACIENTE. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 321</p> <p>5. ALARMAS: INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 128</p> <p>5.1. AUDIBLES, VISUALES Y PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 128</p> <p>5.1.1. PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 212</p> <p>5.1.2. PEEP BAJO Y DESCONEXIÓN DEL PACIENTE. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 191, 211</p> <p>5.1.3. APNEA. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 188</p> <p>5.1.4. VOLUMEN MINUTO ALTO Y BAJO. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 218, 219</p> <p>5.1.5. VOLUMEN CORRIENTE. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 220, 221</p> <p>5.1.6. FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 203</p> <p>5.1.7. FIO2 ALTA Y BAJA. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 203</p>				
	<p>5.1.8. BAJA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 215</p> <p>5.1.9. FALLA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 188</p>				





**PODER EJECUTIVO
TLAXCALA**

07

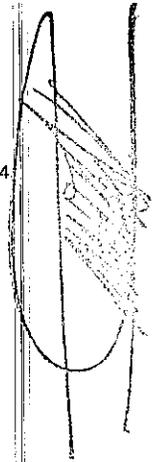

	<p>5.1.10. BATERÍA BAJA. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 189</p> <p>5.1.11. VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DE VENTILADOR. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 197</p> <p>5.1.12. SILENCIO DE ALARMA. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 132</p> <p>6. GENERALES: INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 329</p> <p>6.1. MEZCLADOR DE AIRE-OXIGENO INTERNO CON ANALIZADOR DE FIO2 INTERNO. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 329, 330</p> <p>6.2. VÁLVULA QUE PERMITA EL SUMINISTRO DE AIRE AMBIENTE PARA RESPIRACIONES ESPONTÁNEAS DEL PACIENTE EN CASO DE FALLO DEL SUMINISTRO DE AIRE. DATASHEET EVITA V300, PÁG. 3</p> <p>6.3. SENSOR DE FLUJO DISTAL DE TECNOLOGÍA DE HILOSCALIENTE PARA MEDICIÓN DE FLUJO EN PACIENTES ADULTOS/PEDIÁTRICOS Y A SU VEZ SENSOR DE FLUJO PROXIMAL ACTIVO DE TECNOLOGÍA DE HILOS CALIENTES PARA MEDICIÓN BIDIRECCIONAL DE FLUJO Y SENSIBILIDAD DE DISPARO EN PACIENTES NEONATALES CON DETECCIÓN DE FLUJO MÍNIMO DE 0.2 L/MIN. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 21, 61, 258, 327</p> <p>6.4. COMPENSACIÓN DE LA RESISTENCIA POR EL TUBO ENDOTRAQUEAL O DE VÍAS AÉREAS ARTIFICIALES TANTO EN LA FASE INSPIRATORIA COMO ESPIRATORIA PARA TUBOS DE 2.5 MM A 12 MM. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 252, 312</p> <p>6.5. COMPENSACIÓN DE FUGAS AUTOMÁTICO. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 324</p> <p>6.6. HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO CON SOPORTE AL VENTILADOR. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 23 LISTA DE ACCESORIOS EVITA V300, PÁG. 47</p>				
	<p>6.7. PANTALLA A COLOR DE 15,4" CON TECNOLOGÍA TOUCHSCREEN. CON CONECTORES RS232 (2) ASÍ COMO PUERTOS USB (3) Y PUERTO LAN. DATASHEET EVITA V300, PÁG. 4</p> <p>6.8. TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 182</p> <p>6.9. PERILLA SELECTORA PARA AJUSTE Y CONFIRMACIÓN DE VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 36</p> <p>7. ACCESORIOS INCLUIDOS: LISTA DE ACCESORIOS EVITA V300, PÁG. 44</p> <p>7.1. BRAZO SOPORTE PARA CIRCUITO PACIENTE. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 60</p> <p>7.2. BASE RODABLE PARA EL EQUIPO. INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 23</p> <p>7.3. MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN CODIFICADAS PARA OXÍGENO Y PARA AIRE. LISTA DE ACCESORIOS EVITA V300, PÁG. 45</p> <p>7.4. REGULADORES DE PRESIÓN INTEGRADOS PARA EL SUMINISTRO DE GASES. ANEXO 1 REGULADORES</p> <p>7.5. CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO REUSABLE (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA). LISTA DE ACCESORIOS EVITA V300, PÁG. 47</p> <p>7.6. CIRCUITO DE PACIENTE PEDIÁTRICO REUSABLE (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA). LISTA DE ACCESORIOS EVITA V300, PÁG. 47</p> <p>7.7. CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN REUSABLE ADULTO/PEDIÁTRICA Y NEONATAL. LISTA DE ACCESORIOS EVITA V300, PÁG. 49</p>				

Carrillo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



**PODER EJECUTIVO
TLAXCALA**

GET-LPN-070/2016-4

38

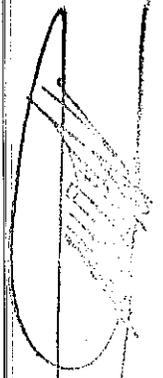

C. C. C.



	<p>8. ACCESORIOS LISTA DE ACCESORIOS EVITA V300, PÁG. 50 8.1. PULMÓN DE PRUEBA. LISTA DE ACCESORIOS EVITA V300, PÁG. 50</p> <p>9. CONSUMIBLES: LISTA DE ACCESORIOS EVITA V300, PÁG. 52 9.1. SENSOR DE FLUJO DISTAL TIPO ANEMOMETRÍA PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICOS Y SENSOR DE FLUJO PROXIMAL ACTIVO DE TECNOLOGÍA DE HILOS CALIENTES PARA MEDICIÓN BIDIRECCIONAL E FLUJO Y SENSIBILIDAD DE DISPARO EN PACIENTES NEONATALES CON DETECCIÓN DE FLUJO MÍNIMO DE 0.2 L/MIN INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 21, 61, 258, 327.</p>				
	<p>9.2. MASCARILLAS LISTA DE ACCESORIOS EVITA V300, PÁG. 53 9.3. FILTROS LISTA DE ACCESORIOS EVITA V300, PÁG. 56 10. INSTALACIÓN: INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 26</p> <p>10.1. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 120 V / 60 HZ +/- 10% INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 26 10.2. NEUMÁTICA: INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 26 10.2.1. OXÍGENO INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 26 10.2.2. AIRE INSTRUCCIONES DE USO EVITA V300, PÁG. 26</p> <p>NORMAS-CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS E ISO 13485. PARA PRODUCTO EXTRANJERO: QUE CUMPLA CON ISO 13485 Y ALGUNO DE LOS SIGUIENTES: FDA, CE O JIS. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. LA PRESENTE FICHA ES EN CONGRUENCIA AL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA, Y EN ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LOS HOSPITALES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEBERÁN SER IGUALES O SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTENIDO DE LAS MISMAS." MARCA: DRÄGER MODELO: EVITA 300 PROCEDENCIA: ALEMANIA</p>				
<p>4</p>	<p>\$31.252.0033 "CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA SERVICIO(S): UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES, UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS NEONATALES. A. DEFINICIÓN: INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 6 A.1 EQUIPO ELECTROMÉDICO CON RUEDAS, QUE PERMITE CONTROLAR MANUALMENTE Y POR SERVOCONTROL, EL AMBIENTE TÉRMICO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO EN UN MEDIO ABIERTO. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 6, 7, 61 B. DESCRIPCIÓN: INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 6 1.- CUNA TÉRMICA CONTROLADA POR MICROCONTROLADOR. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA BABYTHERM 8004, PÁG. 21 2.- CON MODOS DE OPERACIÓN: MANUAL CON SUPRESIÓN DE ALARMAS POR 15 MIN Y SERVOCONTROLADO. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 23, 24, 25, 74 3.- CON CONTROL MANUAL DE LA POTENCIA DEL</p>	<p>EQUIPO</p>	<p>30</p>	<p>\$467,799.00</p>	<p>\$14,033,970.00</p>



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA


Aut. E

	<p>CALEFACTOR DE 0 A 100%. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 8</p> <p>4.- CON PUERTO DE COMUNICACIÓN RS2323 QUE DÉ POSIBILIDAD A FUTURO DE COMUNICACIÓN CON MONITORES DE LA MISMA MARCA QUE LA CUNA PARA LLEVAR A CABO UN ANÁLISIS GRÁFICO DE LAS TEMPERATURAS CENTRAL Y PERIFÉRICA PARA EVALUAR MEJOR EL DESEMPEÑO TÉRMICO DEL NIÑO. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 65, 74</p> <p>5.- DESPLIEGUES DE: INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 8</p> <p>5.1. TEMPERATURA DEL PACIENTE CENTRAL Y PERIFÉRICA DE MANERA SIMULTÁNEA. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 8</p> <p>5.2. TEMPERATURA DE CONTROL. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 8</p> <p>5.3. POTENCIA DEL CALEFACTOR. EN SEGMENTOS DE 10%. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 8</p>				
	<p>6.- CON CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO, SERVOCONTROLADO O CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL PACIENTE DENTRO DEL RANGO DE 36 A 37.5°C. RESOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA 0.1°C. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 25, 68</p> <p>7.- FUNCIÓN DE AUTOPRUEBA O AUTODIAGNÓSTICO. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 19</p> <p>8.- ALARMAS AUDITIVAS Y VISUALES, PRIORIZADAS DE: INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 75</p> <p>8.1.- TEMPERATURA DEL PACIENTE (ALTA Y BAJA) INSTRUCCIONES USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 56</p> <p>8.2.- FALLA EN EL SENSOR O SONDA DE LA TEMPERATURA DEL PACIENTE. INSTRUCCIONES USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 56</p> <p>8.3.- FALLA DEL SISTEMA. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 55</p> <p>8.4.- FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA O POTENCIA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 55</p> <p>8.5.- VERIFICACIÓN DE PACIENTE O VIGILAR PACIENTE EN MODO MANUAL. ALARMA CADA 15 MINUTOS. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 24</p> <p>8.6.- SILENCIADOR TEMPORAL DE ALARMAS. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 8</p> <p>9.- CON AJUSTE POR CONTROL DE MEMBRANA, PARA EVITAR CAMBIOS INVOLUNTARIOS EN LA PROGRAMACIÓN. INSTRUCCIONES USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 8</p> <p>10.- CON ELEMENTO CALEFACTOR RADIANTE CERÁMICO. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 61, 62, 74</p> <p>11.- CUNA LIMITADA EN LOS CUATRO LADOS POR PANELES TRANSPARENTES DE AL MENOS 23 CM. CON PASACABLES. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PÁG. 13 ANEXO 1 BABYTHERM PASA CABLES PAG. 1</p>				
	<p>12.- CON POSIBILIDAD DE DAR POSICIÓN DE TRENDELEBURG Y CONTRATRENDELEBURG O TRENDELEBURG INVERSO, O INCLINACIÓN DE LA CUNA, CON UN ÁNGULO DE -15 A 20 GRADOS DE INCLINACIÓN COMO MÍNIMO DE MANERA CONTINUA. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 14</p> <p>13.- ALTURA VARIABLE, CON CONTROL MEDIANTE PEDALES A AMBOS LADOS DE LA CUNA. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 19</p> <p>14.- RODABLE, CON SISTEMA DE FRENO EN DOS RUEDAS</p>				

Aut. E
[Signature]
[Signature]
[Signature]



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

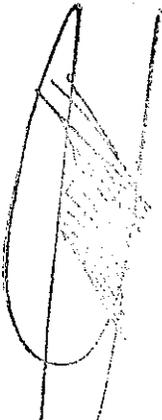

Autent

	<p>COMO MÍNIMO. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 7, 61</p> <p>15.- CON AL MENOS DOS CAJONES. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 61</p> <p>16.- CHAROLA PORTACHASIS O PORTA CARTUCHO DE RAYOS X INTERCONSTRUIDA A LA BASE DEL COLCHÓN. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 12</p> <p>17.- ELEMENTO CALEFACTOR ABATIBLE 90º A LOS LADOS, QUE PERMITA EL ACCESO DEL EQUIPO DE RAYOS X SIN INTERRUMPIR EL CALENTAMIENTO. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 49</p> <p>18.- LÁMPARA O LUZ DE EXAMINACIÓN, EXPLORACIÓN U OBSERVACIÓN EN DOS NIVELES. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 74</p> <p>19.- COLCHÓN RADIOTRASPARENTE CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 53 CATÁLOGO SORTIDO PAG. 1</p> <p>20.- REGLETA DE TOMA CORRIENTE UNIDO A RIEL INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 17</p> <p>21.- REPISA PARA MONITOR E INSTRUMENTAL. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 11</p> <p>22.- MONITOR DE SIGNOS VITALES, DE LA MISMA MARCA QUE LA CUNA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY GAMMA- GAMMA XL, PÁG. 1-8</p> <p>23.- CON PANTALLA DE 8,4", TIPO TFT A COLOR. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY GAMMA-GAMMA XL, PÁG. 1-8, D-4 DATASHEET GAMMA XL, PÁG. 4</p> <p>24.- CON AL MENOS 4 CANALES PARA EL DESPLIEGUE DE PARÁMETROS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY GAMMA- GAMMA XL, PÁG. 2-10 DATASHEET GAMMA XL, PÁG. 4</p>					
	<p>25.- CON MONITOREO DE ECG, SPO2, TEMPATURA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY GAMMA-GAMMA XL, PÁG. 1-8</p> <p>26.- CON MEDICIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY GAMMA-GAMMA XL, PÁG. 1-8, 15-2</p> <p>27.- BATERÍA INTERNA DE 210 MINUTOS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY GAMMA-GAMMA XL, PÁG. 2-3</p> <p>28.- CON TECLADO DE MEMBRANA Y BOTÓN ROTATORIO PARA LA SELECCIÓN DE PARÁMETROS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY GAMMA-GAMMA XL, PÁG. 1-17, 1-18</p> <p>C. ACCESORIOS: INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG.78</p> <p>C.1 LÁMPARA DE FOTOTERAPIA INTERCONSTRUIDA A LOS LADOS DEL CALEFACTOR (NO RODABLE). EN EL RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 400 A 500 NANÓMETROS. CON CONTADOR DE HORAS DE USO. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 41, 62, 74</p> <p>C.2 BÁSCULA INTEGRADA O INTERCONSTRUIDA CON EL DESPLIEGUE DEL PESO SIN TENER QUE INTERRUMPIR EL CALOR RADIANTE. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 66</p> <p>C.3 SOPORTE PARA LÍQUIDOS Y SOLUCIONES. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 6</p> <p>C.4 CRONOMETRO DE APGAR. ANEXO 2- CRONÓMETRO APGAR PAG 1, 2.</p> <p>D. CONSUMIBLES: INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 78</p> <p>D.1.- 50 PARCHES REFLEJANTES PARA FIJAR EL SENSOR DE TEMPERATURA. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG.78</p>					






PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

GET-LPN-070/2016-4


31

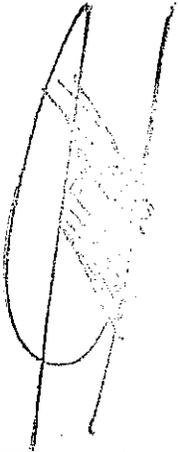

Ciudad



	D.2.- CINCO SENSORES DESECHABLES DE TEMPERATURA DE PIEL CENTRAL Y CINCO SENSORES DE PIEL PERIFÉRICA. INSTRUCCIONES DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 78 D.3.- CABLE DE ECG DE 3 PUNTAS CON ELECTRODOS DESECHABLES. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY GAMMA- GAMMA XL, PÁG. A-2, A-3, A-4				
	D.4.- SENSOR DE TEMPERATURA REUSABLE. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY GAMMA-GAMMA XL, PÁG. A-10 D.5.- SENSOR DE SPO2 MULTISITIO REUSABLE Y CABLE TRONCAL. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY GAMMA- GAMMA XL, PÁG. A-6 D.6.- BRAZALETES DESECHABLES PARA PANI EN DOS MEDIDAS DIFERENTES. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY GAMMA- GAMMA XL, PÁG. A-12 D.7.- MANGUERA REUTILIZABLE PARA PANI. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY GAMMA-GAMMA XL, PÁG. A-12 E. REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY GAMMA-GAMMA XL, PÁG. A-1 F. INSTALACIÓN: 110V, 60 HZ. ±10%. INSTRUCCIONES DE MANUAL DE USO BABYTHERM 8004-8010 PAG. 69 INSTRUCCIONES DE USO INFINITY GAMMA-GAMMA XL, PÁG. D-5 OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL ESPECIALIZADO NORMAS Y CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS. IEC 601-2-50 O ANSI/AAMI; PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON COPIA DE CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE QUE LO ACREDITA. MARCA: DRÁGER MODELO: BABYTHERM 8004 + GAMMA XL PROCEDENCIA: ALEMANIA/E.E.U.U.				
5	531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD. CONJUNTO DE EQUIPOS MÉDICOS UTILIZADOS EN PROCEDIMIENTOS QUE REQUIEREN DE APOYO ANESTÉSICO EN PACIENTES NEONATAL, PEDIÁTRICO, ADULTO Y ADULTO OBESO; CON EL OBJETIVO DE SUMINISTRAR Y MONITORIZAR DE FORMA CONTINUA O INTERMITENTE LA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, GASES MEDICINALES Y/O AGENTES ANESTÉSICOS. INCLUYE MONITORIZACIÓN DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS INVASIVOS DE FORMA SIMULTÁNEA. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 16, 105 DESCRIPCIÓN INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 20 1.- GABINETE: INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 20 1.1.- MONTAJE PARA DOS VAPORIZADORES O DOSIFICADORES ELECTRÓNICOS. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 79 12.- VENTILADOR INTERCONSTRUIDO DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE ANESTESIA CONTROLADO ELECTRÓNICAMENTE, DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO CON CAPACIDAD DE VENTILAR AUTOMÁTICAMENTE CON AIRE AMBIENTAL EN CASO DE FALLO TOTAL DE GASES MEDICINALES (O2 O AIRE) INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 230, 250 BROCHURE PRIMUS IE, PÁG. 3 1.3.- CON TRES CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE,	EQUIPO	10	\$1,663,000.00	\$16,630,000.00





PODER EJECUTIVO
TLAXCALA



Cuic


	<p>PÁG. 70</p> <p>1.4.- CAPACIDAD DE INCORPORAR YUGOS ELECTRÓNICOS PARA CILINDROS DE O2 Y N2O. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 22, 60</p> <p>1.5.- CAJÓN CON LLAVE DE SEGURIDAD INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 20 BROCHURE PRIMUS IE, PÁG. 5</p> <p>1.6.- MESA DE TRABAJO RETRÁCTIL. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 20, 233</p> <p>1.7.- MONTAJE EN MÁQUINA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES. BROCHURE PRIMUS IE, PÁG. 5</p> <p>1.8.- CUATRO RUEDAS, SISTEMA DE FRENO CENTRAL. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 20</p>			
	<p>1.9.- MANÓMETROS DIGITALES, CODIFICADOS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES (O2-VERDE, N2O-AZUL, AIRE- AMARILLO). ANEXO 2 MANÓMETROS CODIFICADOS, PÁG. 1, 3</p> <p>1.9.1. TRES PARA TOMA MURAL (O2, N2O, AIRE). ANEXO 2 MANÓMETROS CODIFICADOS, PÁG. 1, 3</p> <p>1.9.2. DOS PARA CILINDROS (O2, N2O). ANEXO 2 MANÓMETROS CODIFICADOS, PÁG. 1, 3</p> <p>1.10. BATERÍA DE RESPALDO INTERNA CON CAPACIDAD DE 90 MIN. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 265</p> <p>1.11. CON ILUMINACIÓN INTERCONSTRUIDA PARA EL ÁREA DE TRABAJO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 20</p> <p>2.- VAPORIZADOR O DOSIFICADOR ELECTRÓNICO DE LA MISMA MARCA QUE LA UNIDAD DE ANESTESIA INSTRUCCIONES DE USO VAPOR 2000, PÁG. 1 BROCHURE VAPOR 200 Y D-VAPOR, PÁG. 1</p> <p>2.1. SUMINISTRAR DOS VAPORIZADORES DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE ANESTESIA (SEVOFLURANE Y DESFLURANE). BROCHURE VAPOR 200 Y D-VAPOR, PÁG. 1</p> <p>2.2. CON COMPENSACIÓN EN FLUJO, PRESIÓN Y TEMPERATURA. INSTRUCCIONES DE USO VAPOR 2000, PÁG. 113 y 118</p> <p>2.3. INDICADOR VISUAL DEL NIVEL DE LLENADO DE AGENTE ANESTÉSICO. CAPACIDAD DE VOLUMEN DE RELLENO DE 300 A 360 ML. INSTRUCCIONES DE USO VAPOR 2000, PÁG. 16, 108</p> <p>3.- SUMINISTRO DE GAS FRESCO: INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 95</p> <p>3.1. FLUJÓMETRO VIRTUAL, CON REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y NUMÉRICA: CON SISTEMA DE CONFIRMACIÓN PARA EVITAR CAMBIOS ACCIDENTALES EN LAS MEZCLAS DE GASES. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 23, 96</p> <p>3.1.1. CONTROL DE AJUSTE EN PANTALLA DEL FLUJO TOTAL DEL GAS FRESCO Y DESPLIEGUE DE LA FRACCIÓN INSPIRADA DE OXÍGENO (FIO2). INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 95, 144</p>			
	<p>3.1.2. DESPLIEGUE EN PANTALLA DEL FLUJÓMETRO VIRTUAL PARA CADA GAS MEDICINAL CODIFICADO DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: O2-VERDE, AIRE- AMARILLO, N2O-AZUL. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 145 ANEXO 2 FLUJÓMETROS CODIFICADOS</p> <p>3.2. CON MEZCLADOR ELECTRÓNICO. ACTIVADO MEDIANTE BOTONES PARA LA DOSIFICACIÓN DE GAS FRESCO: AJUSTE DE LA CONCENTRACIÓN DE O2 Y DEL FLUJO DE GAS FRESCO. CON CAPACIDAD DE REPRESENTAR EL APROVECHAMIENTO DE GAS FRESCO CON GRÁFICO DE BARRAS EN TRES RANGOS (DEMASIADO, EFICIENTE Y BAJO). INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 96, 145, 152</p> <p>3.3. GUARDA HIPOXICA MÍNIMA DE 25%. DESPLIEGUE DEL CONSUMO DE GAS FRESCO (DE AGENTES ANESTÉSICOS)</p>			





PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

GET-LPN-070/2016-4

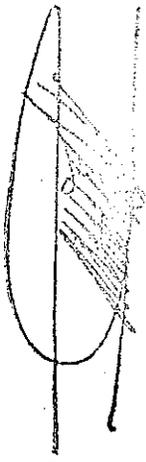

33

	<p>COMO DE GASES MEDICINALES) POR EL PACIENTE Y POR EL EQUIPO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 97, 262</p> <p>3.4.- FLUSH DE OXIGENO DIRECTO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 101</p> <p>3.5.- CON INDICADOR DE CONSUMO DE GASES MEDICINALES EN LITROS (AIRE, O2 Y N2O) INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 262 BROCHURE PRIMUS/PRIMUS IE SOFTWARE 4, PÁG. 1</p> <p>4.- CIRCUITO DE PACIENTE: INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 20</p> <p>4.1. UN CÁNISTER INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 231.</p> <p>4.1.1. CON CAPACIDAD DE 1500 ML. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 231, 253</p> <p>4.1.2. REUSABLE Y ESTERILIZABLE. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 228, 231</p> <p>4.1.3. CON FILTRO DE POLVO, EN CASO DE REQUERIRSE. NO SE REQUIERE EN CASO DE USAR CAL SODADA MARCA DRÁGER</p> <p>4.1.4. CON SISTEMA QUE PERMITA EL CAMBIO DE CAL SODADA DURANTE LA VENTILACIÓN MECÁNICA SIN OCASIONAR FUGAS. ANEXO 3 ABSORBEDOR</p> <p>4.1.5. ALARMA PARA EL CONTROL DE CAMBIO PARA RECORDAR AL PERSONAL LOS INTERVALOS DE SUSTITUCIÓN DE LA CAL SODADA INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 121, 173, 198</p> <p>4.2. CON TRAMPA DE AGUA Y SISTEMA DE CALENTAMIENTO INTERCONSTRUIDO. BROCHURE PRIMUS IE, PÁG. 5 INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 216</p>				
	<p>4.3. SALIDA DE GAS FRESCO PARA CIRCUITO AUXILIAR. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 119</p> <p>4.4. CON SISTEMA DE CONMUTACIÓN ENTRE CIRCUITO CIRCULAR Y CIRCUITO AUXILIAR (TIPO BAIN). INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 119</p> <p>4.5. SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES PASIVO. ANEXO 4 FILTRO ANESTÉSICO</p> <p>4.6. TODOS LOS ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL GAS ESPIRADO POR EL PACIENTE DEBERÁN SER ESTERILIZABLES Y LIBRES DE LÁTEX. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 228, 269</p> <p>4.7. VÁLVULA AJUSTABLE DE PRESIÓN (APL). INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 99</p> <p>4.8. VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 99</p> <p>4.9. VÁLVULA DE CONMUTACIÓN BOLSA-VENTILADOR. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 100</p> <p>4.10. BRAZO AJUSTABLE PARA BOLSA DE VENTILACIÓN MANUAL. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 69</p> <p>5.- VENTILADOR MICROPROCESADO E INTERCONSTRUIDO DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA: CONTROLADO ELECTRÓNICAMENTE, DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 250 BROCHURE PRIMUS IE, PÁG. 3</p> <p>5.1. TECLADO SENSIBLE DE MEMBRANA Y PERILLA SELECTORA. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 36</p> <p>5.2. DESPLIEGUE DE MENSAJES Y PARÁMETROS EN ESPAÑOL. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 124, 160, 167</p> <p>5.3. PANTALLA: INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 268</p> <p>5.3.1. TIPO TFT INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 268</p> <p>5.3.2. TAMAÑO DE 12". INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 268</p>				<p>Handwritten signature</p>



**PODER EJECUTIVO
TLAXCALA**

GET-LPN-070/2016-4

34



	<p>5.3.3. POLICROMÁTICA. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 268 5.3.4. CONFIGURABLE POR EL USUARIO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 170</p>			
	<p>5.3.5. DESPLIEGUE DE PARÁMETROS EN FORMA NUMÉRICA. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 23 5.3.6. DESPLIEGUE DE TRES CURVAS SIMULTÁNEAS. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 23 5.4.- MODOS DE VENTILACIÓN INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 16 5.4.1. CONTROLADO POR VOLUMEN INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 102 5.4.2. CONTROLADO POR PRESIÓN. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 110 5.4.3. SIMV (VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA). INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 102, 110 5.4.4. PRESIÓN SOPORTE. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 114 5.4.5. VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN CON VOLUMEN CORRIENTE Y FRECUENCIA GARANTIZADA (AUTO FLOW). INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 106 5.5. CONTROLES Y AJUSTE DE: INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 39, 250 5.5.1. VOLUMEN CORRIENTE EN EL RANGO DE 5 A 1400 ML. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 251 5.5.2. PRESIÓN LÍMITE EN EL RANGO DE 10 A 70 CMH2O. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 250 5.5.3. PRESIÓN INSPIRATORIA EN EL RANGO DE 5 A 70 CMH2O. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 250 5.5.4. FRECUENCIA RESPIRATORIA EN EL RANGO DE 3 A 100 RESPIRACIONES POR MINUTO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 251 5.5.5. PEEP ELECTRÓNICO EN EL RANGO DE 0 A 20 CMH2O. RESOLUCIÓN DE AJUSTE DE 1 CM H2O INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 252, 255 5.5.6. RELACIÓN I:E Y RELACIÓN I:E INVERSA. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 251 5.5.7. PAUSA INSPIRATORIA. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 251 5.5.8. SENSIBILIDAD POR FLUJO INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 103, 252 BROCHURE PRIMUS IE, PÁG.4 5.5.9. PRESIÓN SOPORTE. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 252</p>			
	<p>5.5.10. AJUSTE DE PARÁMETROS DE VENTILACIÓN EN FUNCIÓN DEL PESO IDEAL Y DE LA EDAD DEL PACIENTE INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 68, 94 5.6. DESPLIEGUE NUMÉRICO EN PANTALLA DEL VENTILADOR: INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 23 5.6.1. FRACCIÓN INSPIRADA Y ESPIRADA DE OXÍGENO (FIO2) POR TECNOLOGÍA PARAMAGNÉTICA. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 260 5.6.2. VOLUMEN CORRIENTE. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 144 5.6.3. VOLUMEN MINUTO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 144 5.6.4. PRESIÓN MEDIA. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 144 5.6.5. PRESIÓN PICO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 144 5.6.6. PEEP. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 144 5.6.7. FRECUENCIA RESPIRATORIA INSTRUCCIONES DE USO</p>			

Quint



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

GET-LPN-070/2016-4

95

Handwritten signature on the right margin.

	<p>PRIMUS IE, PÁG. 145</p> <p>5.6.8. COMPLIANCE. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 145</p> <p>5.6.9. MAC (CONCENTRACIÓN ALVEOLAR MÍNIMA). INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 148</p> <p>5.6.10. PRESIÓN DE MESETA. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 144</p> <p>5.7. DESPLIEGUE DE CURVAS EN PANTALLA DEL VENTILADOR: INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 23</p> <p>5.7.1. CURVA DE FLUJO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 144</p> <p>5.7.2. CURVA DE PRESIÓN. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 144</p> <p>5.7.3. DESPLIEGUE DE LAZOS: PRESIÓN / VOLUMEN Y FLUJO / VOLUMEN, CON ALMACENAMIENTO DE REFERENCIA DE AL MENOS UN LAZO. EN MÁQUINA DE ANESTESIA Y EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 146, 153</p> <p>INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 29-6</p>				
	<p>5.7.4. CON CAPACIDAD PARA LA TRANSFERENCIA DE DATOS ENTRE EL VENTILADOR Y UN DISPOSITIVO EXTERNO MÉDICO O NO MÉDICO (POR EJEMPLO, MONITORES HEMODINÁMICOS, SISTEMAS DE GESTIÓN DE DATOS U ORDENADORES CON WINDOWS) A TRAVÉS DE LA INTERFAZ RS-232. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 24, 28</p> <p>5.8. SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES PRIORIZADAS EN TRES NIVELES (DESPLIEGUE Y AJUSTE EN PANTALLA DEL VENTILADOR): INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 128, 129, 137</p> <p>5.8.1. FIO2 (ALTA Y BAJA). INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 206</p> <p>5.8.2. VOLUMEN MINUTO INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 212</p> <p>5.8.3. PRESIÓN DE VÍAS AÉREAS (ALTA Y BAJA). INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 207</p> <p>5.8.4. APNEA. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 195</p> <p>5.8.5. PRESIÓN BAJA DE SUMINISTRO DE GAS. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 209, 210</p> <p>5.8.6. FALLA EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 200</p> <p>5.8.7. FALLA EN MEDICIÓN O2, PARA TECNOLOGÍA PARAMAGNÉTICA. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 203</p> <p>5.8.8. FUGA EN CIRCUITO DE PACIENTE. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 204</p> <p>5.8.9. FALLA EN SENSOR DE PRESIÓN. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 200</p> <p>5.8.10. FALLA EN EL SENSOR DE FLUJO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 202</p> <p>5.9. INHABILITACIÓN DE ALARMAS PARA EL MODO BYPASS CARDIACO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 135</p> <p>5.10. CONMUTACIÓN A VENTILACIÓN MANUAL. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 100</p> <p>5.11. COMPENSACIÓN DE VOLUMEN O DESACOPLO DE GAS FRESCO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 250</p> <p>5.12. INDICADOR DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, AC O DC. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 23</p>				
	<p>5.13. INDICADOR BATERÍA BAJA. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 186</p> <p>6.- SISTEMA DE COMPROBACIÓN QUE VERIFIQUE EL FUNCIONAMIENTO NEUMÁTICO Y ELECTRÓNICO DE LA UNIDAD DE ANESTESIA. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE,</p>				



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

Quis

	<p>PÁG. 84, 88</p> <p>7.- MONITOR DE SIGNOS VITALES: INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 4</p> <p>7.1. MONITOR MODULAR. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-2</p> <p>7.2. TECLADO DE MEMBRANA Y PERILLA SELECTORA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 1-6, 1-21</p> <p>7.3. PANTALLA POLICROMÁTICA CON TECNOLOGÍA TFT DE 15". INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 1-20, B-19</p> <p>7.4. SALIDA ANALÓGICA DE ECG Y SINCRONÍA PARA DESFIBRILACIÓN. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 1-8</p> <p>7.5. DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS DE 8 CURVAS SIMULTÁNEAS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 1-20</p> <p>7.6. DESPLIEGUE DE MENSAJES Y PARÁMETROS EN ESPAÑOL. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-9</p> <p>7.7. TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS PARA TODOS LOS PARÁMETROS DE 24 HORAS COMO MÍNIMO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 6-2, B-14</p> <p>7.8. BATERÍA DE RESPALDO INTERNA CON CAPACIDAD DE 240 MIN. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 1-18</p> <p>7.9. MONITOREO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DESPLEGADOS EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES O EN EL VENTILADOR. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 1-20</p> <p>7.10. ECG INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-2</p> <p>7.10.1. DESPLIEGUE NUMÉRICO DE FRECUENCIA CARDIACA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-17</p> <p>7.10.2. AL MENOS 7 DERIVACIONES SELECCIONABLES POR EL USUARIO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-16</p>				
	<p>7.10.3. DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL TRES CURVAS A ELEGIR DE ENTRE 7 DERIVACIONES DE ECG. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-16, 8-20</p> <p>7.10.4. ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 10-4</p> <p>7.10.5. ANÁLISIS DE ARRITMIAS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 9-2</p> <p>7.10.6. CONTROL DE ACTIVACIÓN DE FILTROS EN LA SEÑAL. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-22</p> <p>7.10.7. DETECCIÓN DE MARCAPASOS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-5</p> <p>7.13.1-BIS.-DESPLIEGUE NUMÉRICO DE AMBAS TEMPERATURAS DE MANERA SIMULTÁNEA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 28-5</p> <p>7.14-BIS.- PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 13-2</p> <p>7.14.1-BIS.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE PRESIÓN NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA). INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 13-2</p> <p>7.14.2-BIS.- AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA PRESIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTE SELECCIONADO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 13-7</p> <p>7.14.3-BIS.- MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 13-8, 13-9</p> <p>7.15-BIS.- RESPIRACIÓN INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 12-2</p> <p>7.15.1-BIS.- CURVA DE RESPIRACIÓN. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 12-5</p> <p>7.15.2-BIS.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE FRECUENCIA</p>				



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA

GET-LPN-070/2016-4

17



Quint

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


	<p>RESPIRATORIA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 12-5 7.10.8.- PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 8-7 7.11. CO2 INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 144 7.11.1. POR MEDIO DE SIDESTREAM (CORRIENTE LATERAL) INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 258</p>				
	<p>7.11.2. DESPLIEGUE DE CURVA Y VALORES NUMÉRICOS; INSPIRADO Y ESPIRADO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 144 7.12. SPO2 INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 18-2 7.12.1. CURVA DE PLETISMOGRAFÍA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 18-8 7.12.2. DESPLIEGUE NUMÉRICO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 18-8 7.13. TEMPERATURA EN MÍNIMO DOS CANALES INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 28-5 7.13.1. DESPLIEGUE NUMÉRICO DE ÁMBAS TEMPERATURAS DE MANERA SIMULTÁNEA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 28-5 7.14. PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 13-2 7.14.1. DESPLIEGUE NUMÉRICO DE PRESIÓN NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA). INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 13-2 7.14.2. AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA PRESIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTE SELECCIONADO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 13-7 7.14.3. MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 13-8, 13-9 7.15. RESPIRACIÓN INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 12-2 7.15.1. CURVA DE RESPIRACIÓN. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 12-5 7.15.2. DESPLIEGUE NUMÉRICO DE FRECUENCIA RESPIRATORIA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 12-5 7.16. PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 15-2 7.16.1. DOS CANALES DE PRESIÓN INVASIVA. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 15-10 7.16.2. ETIQUETADO DEL SITIO DE MEDICIÓN DE LOS TRANSDUCTORES. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 15-2</p>				
	<p>7.16.3. AJUSTE AUTOMÁTICO DE ESCALAS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 15-2, 15-14 7.17. ESPIROMETRÍA: INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 29-6, 29-14 7.17.1. CURVA DE FLUJO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 29-6 7.17.2. VOLUMEN MINUTO INSPIRADO Y/O ESPIRADO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 29-15 INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 257 7.17.3. VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO Y ESPIRADO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 29-15 INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 256, 257 7.17.4. DESPLIEGUE DE LAZOS: PRESIÓN / VOLUMEN Y FLUJO</p>				



PODER EJECUTIVO
TLAXCALA



Aut.



	<p>7.24. CON SILENCIADOR DE ALARMAS. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 5-7</p> <p>8.- RELAJACIÓN MUSCULAR: DESPLIEGUE EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 25-2</p> <p>8.1. DESPLIEGUE NUMÉRICO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 25-5</p> <p>8.2. MODOS DE ESTIMULACIÓN: TREN DE CUATRO, TETÁNICO Y ESTIMULO ÚNICO O SIMPLE. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 25-5, 25-6</p> <p>9.- FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ANESTESIA CON MODO BYPASS CARDIACO. INSTRUCCIONES DE USO PRIMUS IE, PÁG. 135</p> <p>10.- CAPACIDAD A FUTURO DE INTERFAZ CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE. DATASHEET GATEWAY, PÁG. 1</p> <p>11.- UNA MANGUERA DE SUMINISTRO POR CADA GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: (O2- VERDE, N2O-ÁZUL, AIRE-AMARILLO) CON CONECTOR PARA TOMA MURAL DE ACUERDO A LA INSTALACIÓN DE CADA UNIDAD MÉDICA. LISTA DE ACCESORIOS PRIMUS/PRIMUS IE, PÁG. 3</p> <p>ACCESORIOS: PARA ADULTO / PEDIÁTRICO: INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-2</p> <p>1. CIRCUITO DE PACIENTE REUSABLE ADULTO ESTERILIZABLE Y LIBRE DE LÁTEX CON TUBOS CORRUGADOS DE AL MENOS 1.5 M DE LONGITUD, PIEZA EN "Y" ACODADA. CIRCUITO DE PACIENTE NEONATAL REUSABLE ACCESSORY CATALOGUE 2015-2016, PÁG. 37, 38</p> <p>2. UN CIRCUITO DE REINHALACIÓN PARCIAL, TIPO BAIN, SEMICERRADO O EQUIVALENTE. ANEXO 1 CIRCUITO BAIN</p> <p>3. MASCARILLA TRANSPARENTE REUSABLE, ESTERILIZABLE Y LIBRE DE LÁTEX: UNA TAMAÑO ADULTO, UNA TAMAÑO PEDIÁTRICO. ACCESSORY CATALOGUE 2015-2016, PÁG. 73</p> <p>4. BOLSA PARA VENTILACIÓN REUSABLE, ESTERILIZABLE Y LIBRE DE LÁTEX: DE 500 ML, DE 1.5 LTS, DE 2.3 LTS Y 3 LTS. ACCESSORY CATALOGUE 2015-2016, PÁG. 53</p> <p>5. CAPACIDAD DE USAR ACCESORIOS DE RADIOFRECUENCIA, TRAMPA DE AGUA, SENSORES DE FLUJO. ACCESORIOS INFINITY ID, PÁG. 8, 9 y 10</p>				
	<p>6. UN CABLE TRONCAL, UN SENSOR TIPO DEDAL Y UN SENSOR MULTISITIO, AMBOS REUSABLES, PARA OXIMETRÍA DE PULSO PORTATIL. ACCESSORY CATALOGUE 2015-2016, PÁG. 131, 140</p> <p>7. UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O DE SUPERFICIE) Y UN SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO O RECTAL. ACCESSORY CATALOGUE 2015-2016, PÁG. 144</p> <p>8. BRAZALETE REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, UNO ADULTO, UNO ADULTO OBESO Y UNO PEDIÁTRICO; UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES. PARA PACIENTE NEONATAL 20 BRAZALETES DESECHABLES PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA NEONATAL EN DOS MEDIDAS DIFERENTES, UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES. ACCESSORY CATALOGUE 2015-2016, PÁG. 145, 146, 148</p> <p>9. UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS DE CINCO PUNTAS. PARA PACIENTE NEONATAL UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE TRES PUNTAS. ACCESSORY CATALOGUE 2015-2016, PÁG. 115, 121</p> <p>10. PARA CO2 POR TÉCNICA MAINSTREAM: 20 SENSORES</p>				



**PODER EJECUTIVO
TLAXCALA**

[Handwritten signature]

	<p>REUSABLES Y CABLES, 40 ADAPTADORES DE VÍAS AÉREAS REUSABLE Y 40 ADAPTADORES DE VÍAS AÉREAS DESECHABLES. SE OFERTA SIDESTREAM</p> <p>11. PARA CO2 POR TÉCNICA SIDESTREAM: 12 TRAMPAS DE AGUA, 20 LÍNEAS DE MUESTRA. ACCESSORY CATALOGUE 2015-2016, PÁG. 168</p> <p>12. PARA CO2 POR TÉCNICA MICROSTREAM: 20 LÍNEAS DE MUESTRA Y ADAPTADORES ENDOTRAQUEALES. SE OFERTA SIDESTREAM</p> <p>13. PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN INVASIVA INCLUIR AL MENOS: 2 CABLES TRONCALES PARA TRANSDUCTOR Y 2 KITS DE TRANSDUCTOR DESECHABLE POR CADA CANAL. ACCESSORY CATALOGUE 2015-2016, PÁG. 155</p> <p>14. PARA RELAJACIÓN MUSCULAR: SENSOR ADULTO Y PEDIÁTRICO. Y ELECTRODOS PARA ESTIMULACIÓN NEUROMUSCULAR. ACCESSORY CATALOGUE 2015-2016, PÁG. 162</p> <p>162 INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. 25-2</p>				
	<p>15. PARA MONITORIZACIÓN DE LA PROFUNDIDAD HIPNÓTICA: CABLE TRONCAL Y SENSOR PARA PROFUNDIDAD HIPNÓTICA PARA USO PEDIÁTRICO Y ADULTO. INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-29</p> <p>CONSUMIBLES: ACCESSORY CATALOGUE 2015-2016, PÁG. 17, 69 INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-10</p> <p>C1. CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO DESECHABLE CON BOLSA Y MASCARILLA TRANSPARENTE, LIBRES DE LÁTEX. ACCESSORY CATALOGUE 2015-2016, PÁG. 17, 69</p> <p>C2. 100 ELECTRODOS PARA ECG ADULTO / PEDIÁTRICO Y 300 NEONATALES INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. C-10</p> <p>REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO</p> <p>INSTALACIÓN: ELÉCTRICA: 120 V +/- 10%, 60 HZ INSTRUCCIONES DE USO INFINITY SERIES, PÁG. B-12 NEUMÁTICA: AIRE, OXÍGENO Y N2O.</p> <p>OPERACIÓN: PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN.</p> <p>MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. MARCA: DRÄGER</p> <p>MODELO: PRIMUS IE + KAPPA PROCEDENCIA: ALEMANIA/E.E.U.U.</p>				
<p>IMPORTE ADJUDICADO CON LETRA</p>				<p>SUBTOTAL</p>	<p>\$98,025,485.00</p>
<p>(CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.)</p>				<p>IVA</p>	<p>\$15,684,077.60</p>
				<p>TOTAL</p>	<p>\$113,709,562.60</p>

[Handwritten signature]

<p>IMPORTE TOTAL ADJUDICADO CON LETRA:</p>	<p>SUB-TOTAL ANEXO 1A</p>	<p>\$ -</p>
	<p>SUB-TOTAL ANEXO 1B</p>	<p>\$ 45,595,609.60</p>
<p>(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.)</p>	<p>SUB-TOTAL ANEXO 1C</p>	<p>\$ 113,709,562.60</p>
	<p>SUB-TOTAL ANEXO 1E</p>	<p>\$ -</p>
	<p>GRAN TOTAL</p>	<p>\$ 159,305,172.20</p>

LAS FIRMAS QUE CONSTAN EN LA PRESENTE HOJA CORRESPONDEN AL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, QUE CELEBRAN "SALUD DE TLAXCALA", "EL EJECUTIVO DEL ESTADO" Y "EL PROVEEDOR", EL DÍA VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISEIS.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]